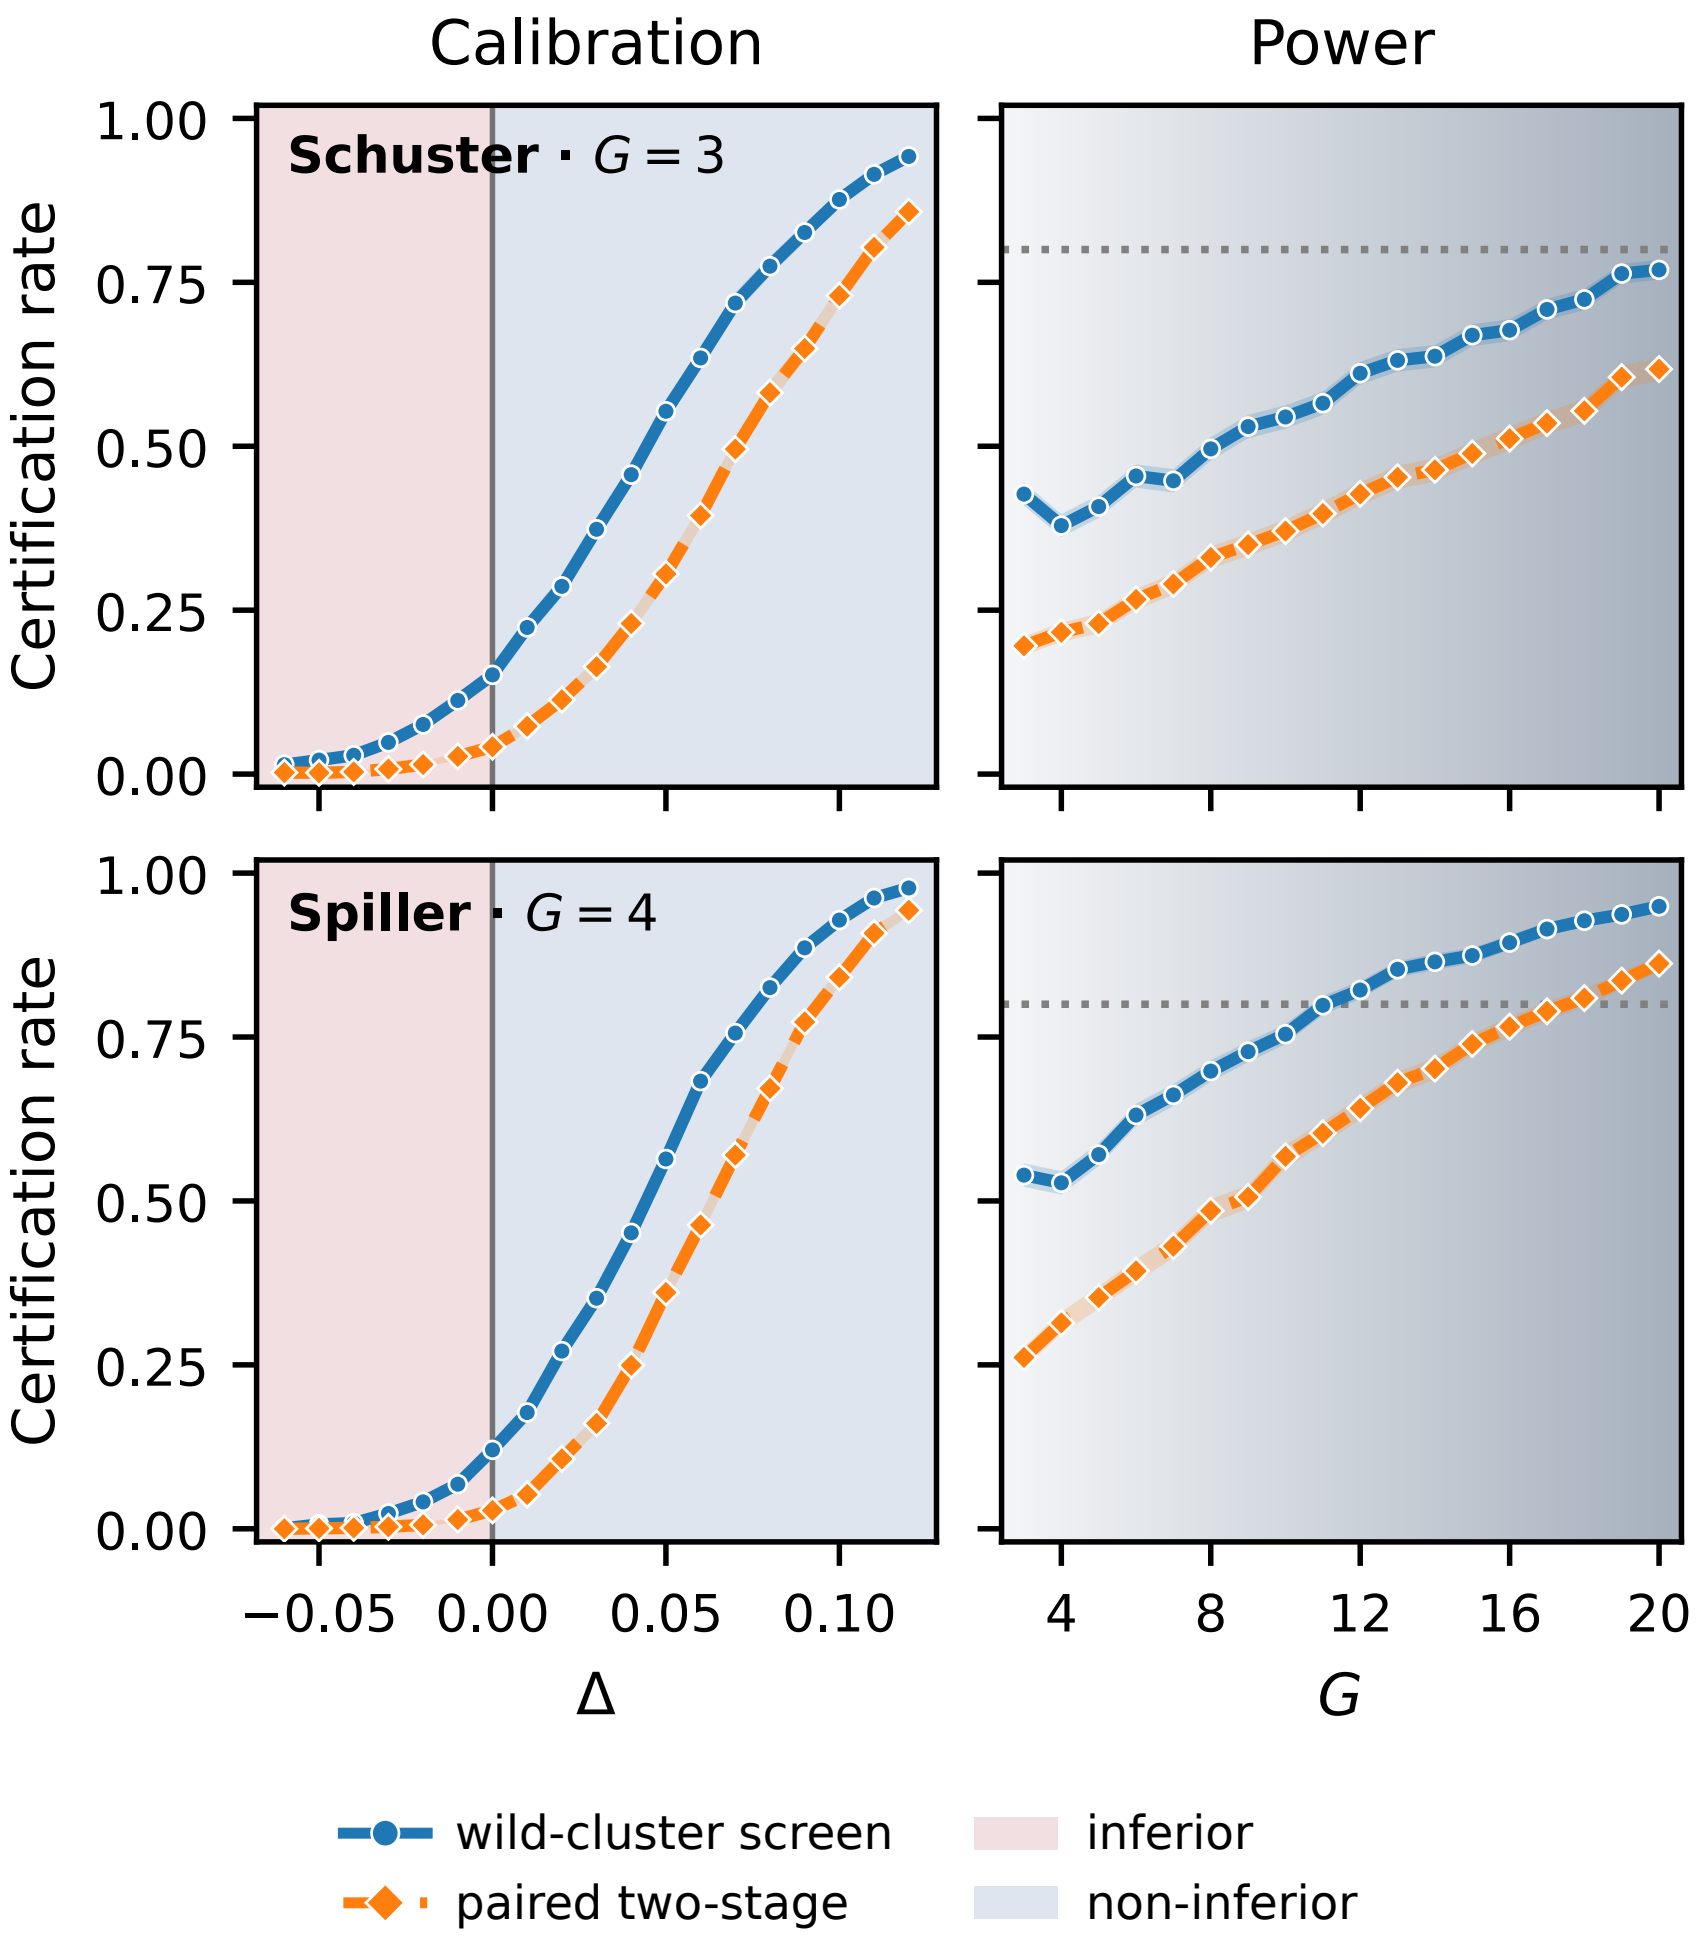
Calibration
Power
Schuster · $G = 3$
Spiller · $G = 4$
Certification rate
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.05
0.00
0.05
0.10
Δ
4
8
12
16
20
G
wild-cluster screen
paired two-stage
inferior
non-inferior