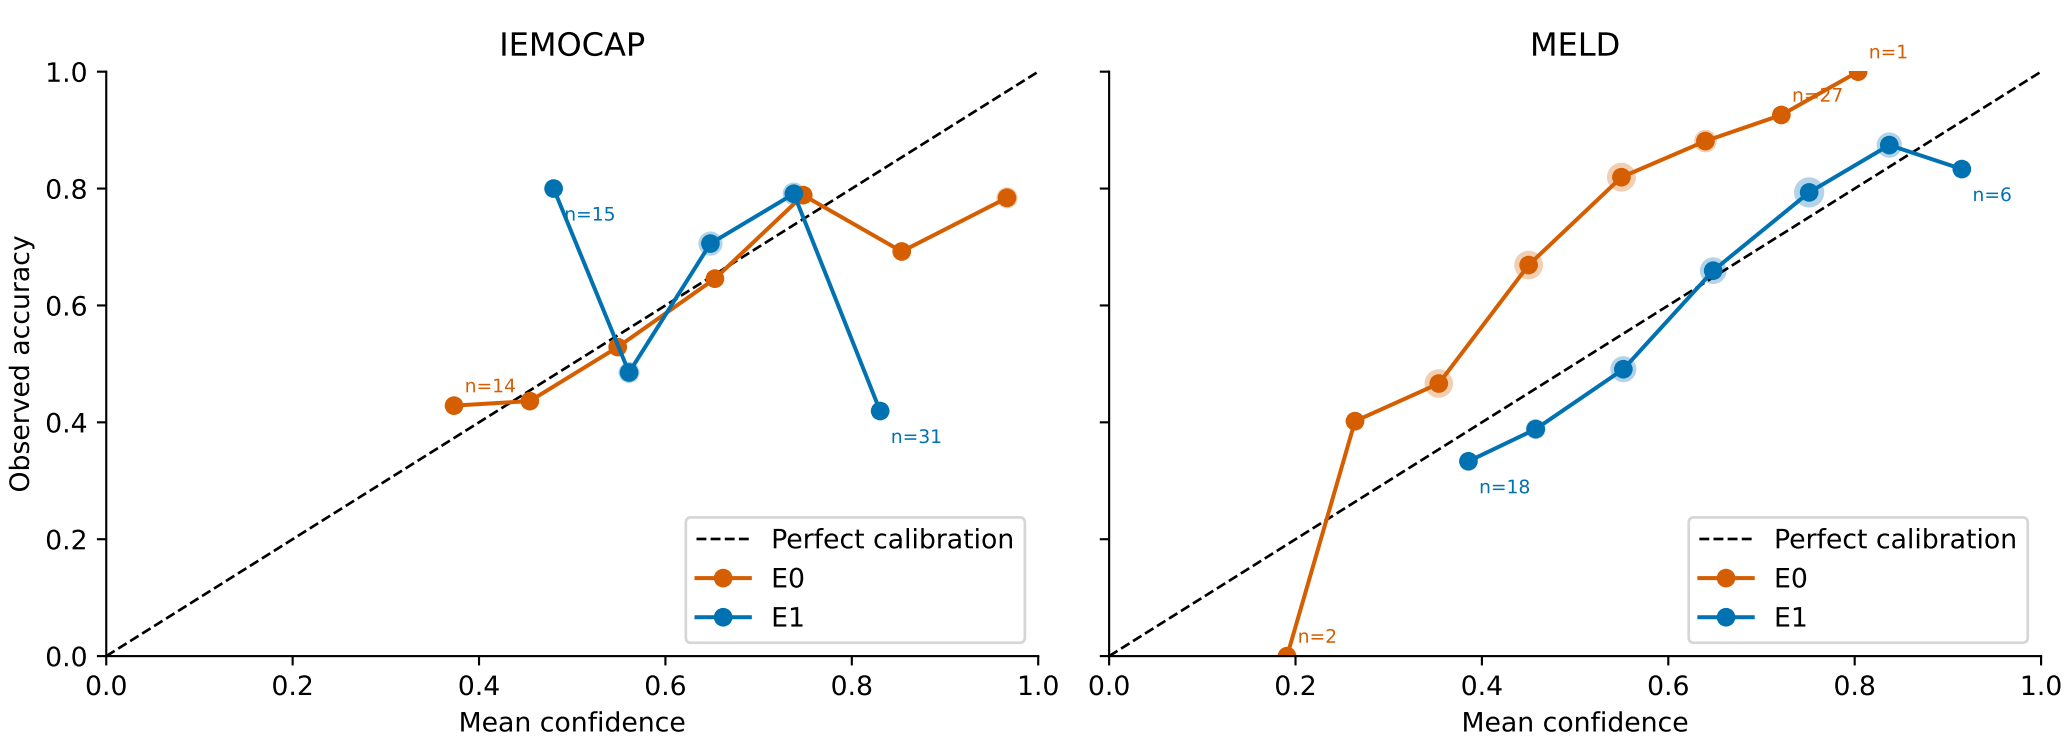
IEMOCAP
MELD
Observed accuracy
Mean confidence
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Perfect calibration
E0
E1
n=14
n=15
n=31
n=1
n=27
n=6
n=18
n=2