



דו"ח מעבדה

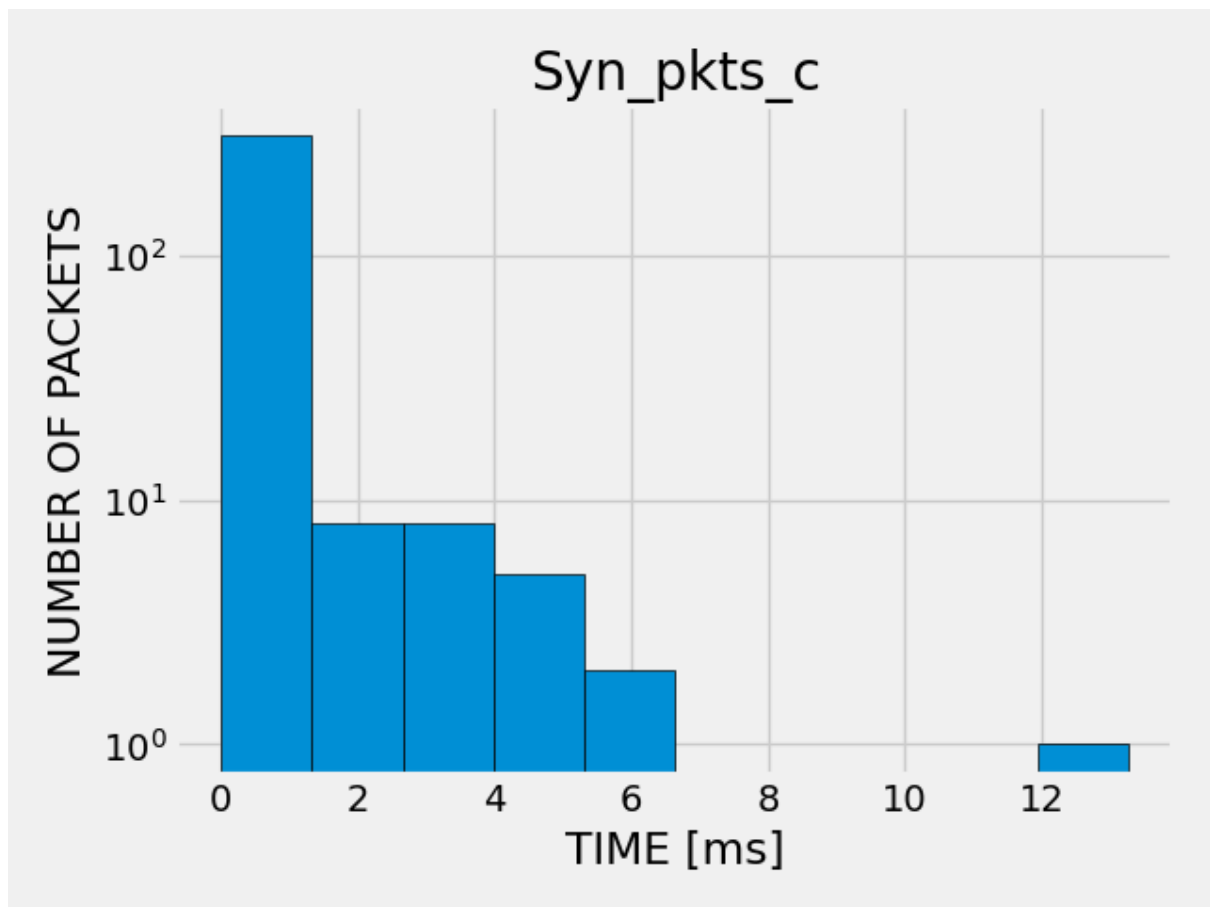


Average: 0.000050

Standard Deviation: 0.0011284268531959987

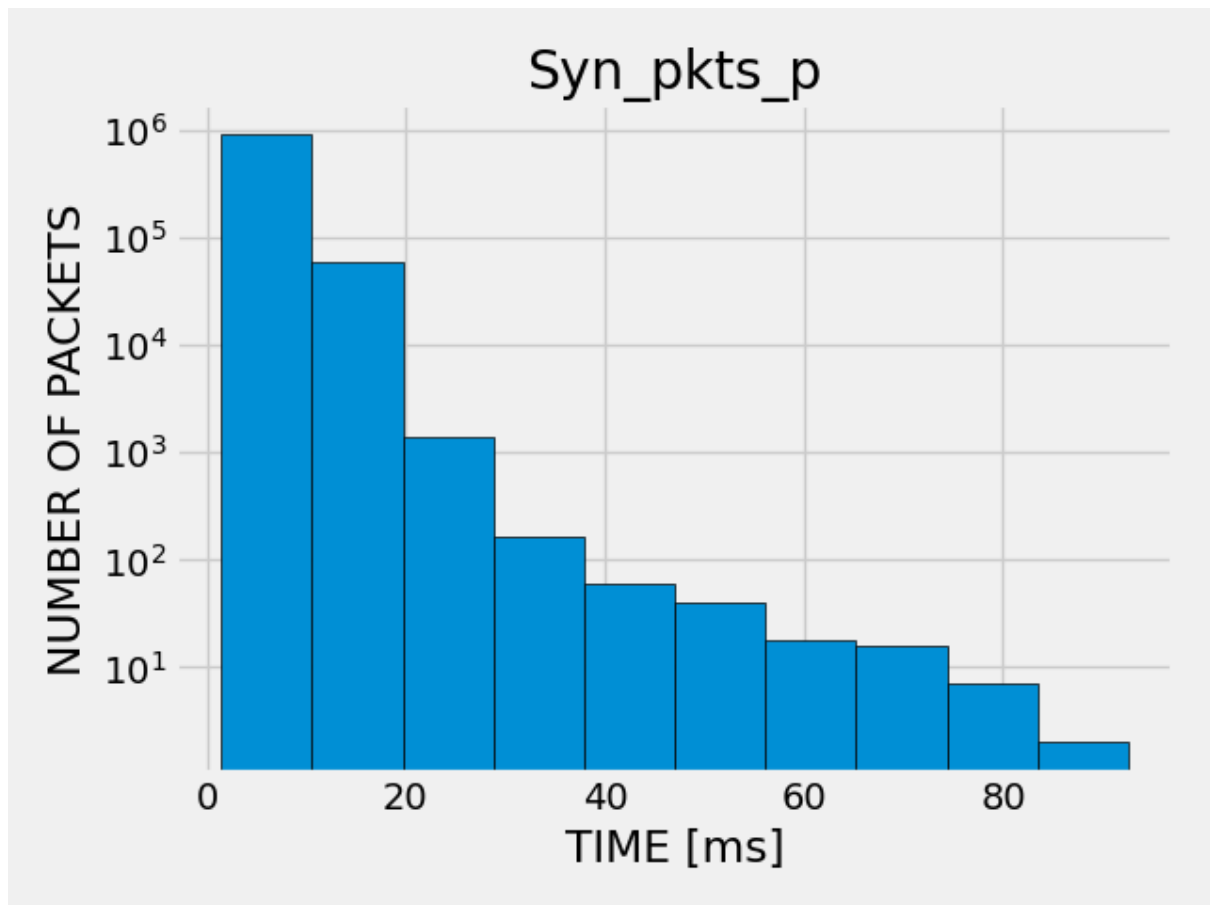


Average: 0.005541361834689799

Standard Deviation: 0.0028967662658418683

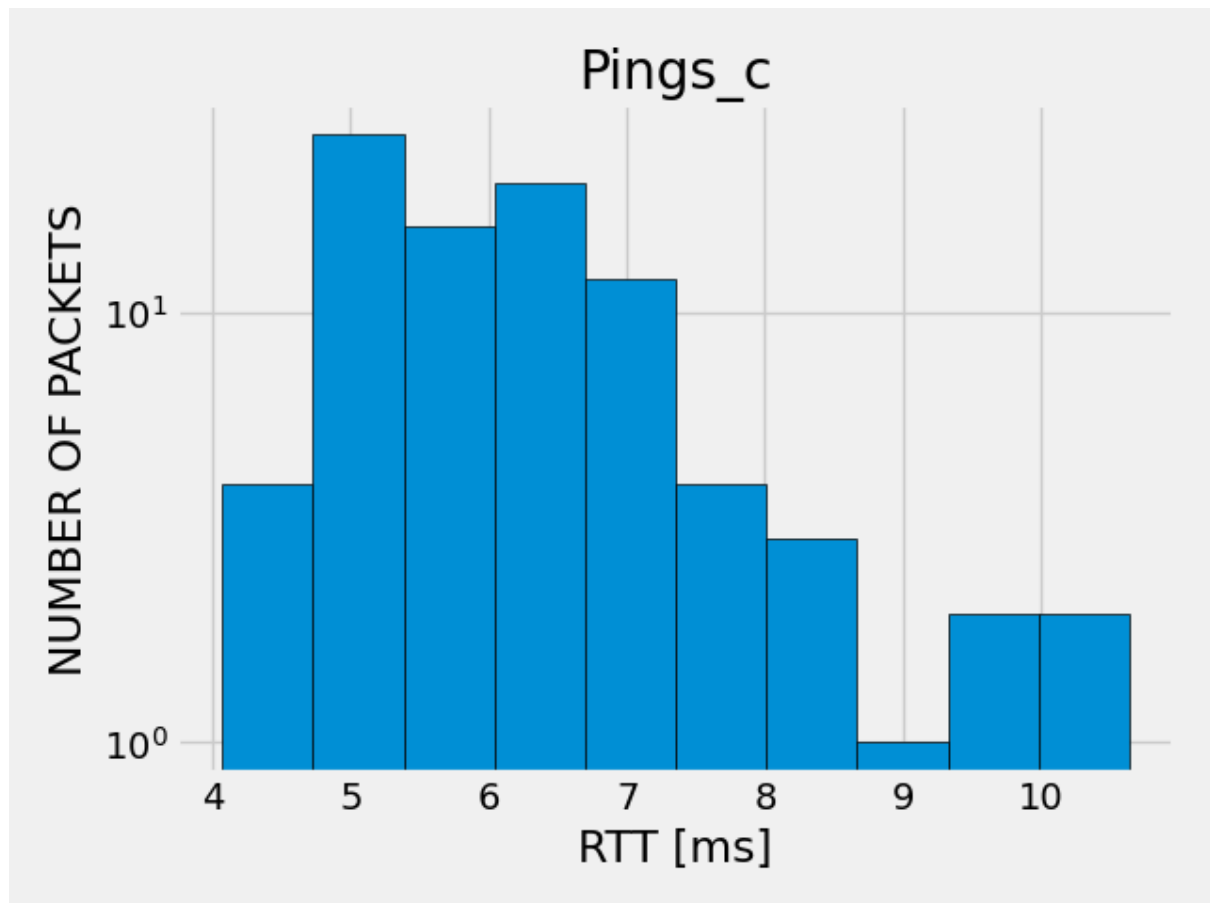

Average: 0.00618938014447647

Standard Deviation: 0.0013091228254178855

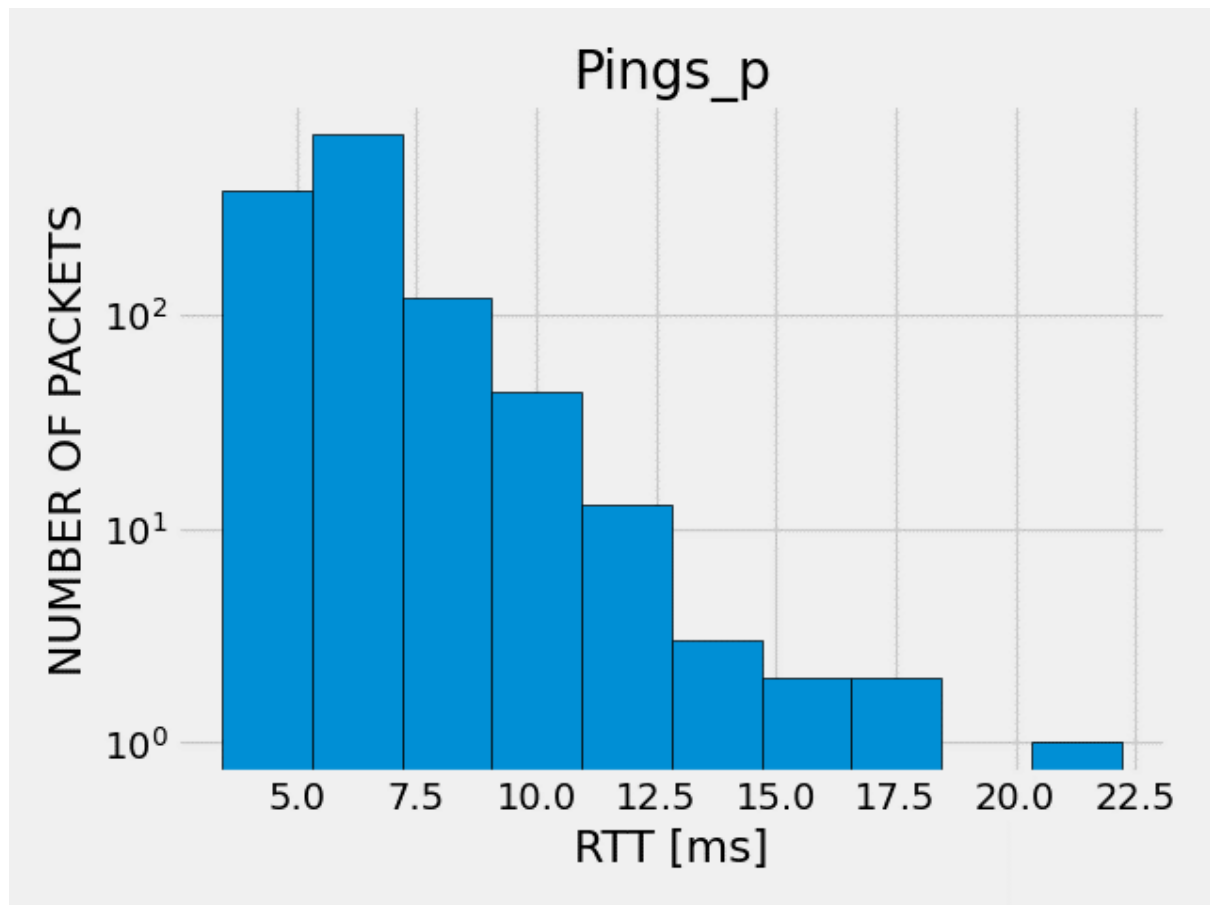

Average: 0.006122297271578879

Standard Deviation: 0.0015805131027244728