


Instrument AVB400

NMR@CHEM.OX

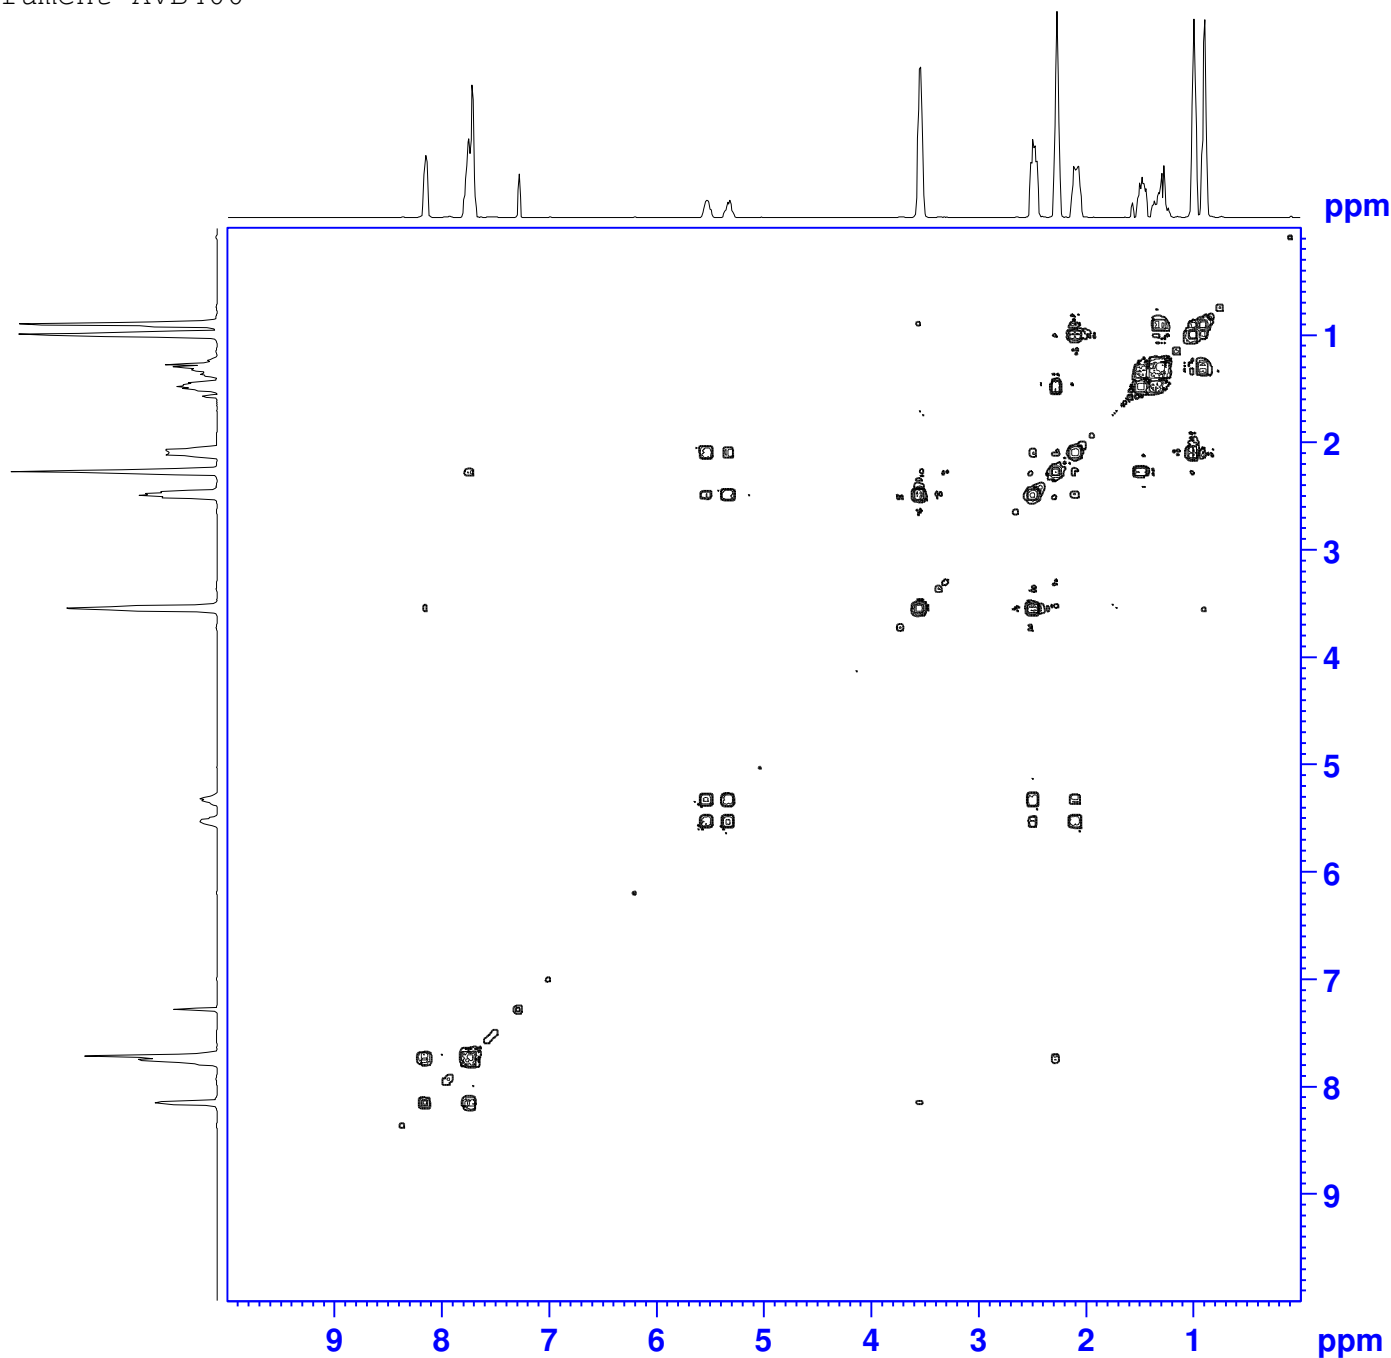

Current Data Parameters
NAME jy q34 p HCYSB
EXPNO 3
PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_ 20180217
Time 0.08 h
INSTRUM avb400
PROBHD Z116098_0219 (
PULPROG cosygpppgf
TD 2048
SOLVENT CDCl3
NS 1
DS 8
SWH 4000.000 Hz
FIDRES 3.906250 Hz
AQ 0.2560000 sec
RG 99.31
DW 125.000 usec
DE 6.50 usec
TE 298.0 K
D0 0.00000300 sec
D1 1.88039696 sec
D11 0.03000000 sec
D12 0.00002000 sec
D13 0.00000400 sec
D16 0.00020000 sec
IN0 0.00025000 sec
TDav 1
SF01 400.1320007 MHz
NUC1 1H
P0 10.00 usec
P1 10.00 usec
P17 2500.00 usec
PLW1 14.58800030 W
PLW10 1.62090003 W
GPNAM[1] SMSQ10.100
GPZ1 10.00 %
P16 1000.00 usec

F1 - Acquisition parameters
TD 128
SF01 400.132 MHz
FIDRES 62.500000 Hz
SW 9.997 ppm
FnMODE QF

F2 - Processing parameters
SI 1024
SF 400.1300000 MHz
WDW QSINE
SSB 0
LB 0 Hz
GB 0
PC 1.40

F1 - Processing parameters
SI 1024
MC2 QF
SF 400.1300000 MHz
WDW QSINE
SSB 0
LB 0 Hz
GB 0