




医疗床采样放大

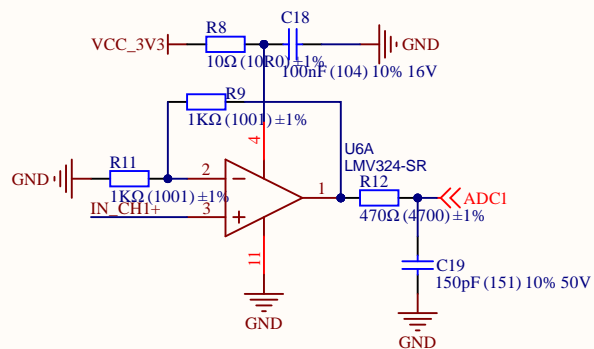


RC由采样频率决定，现在是2.27K低通

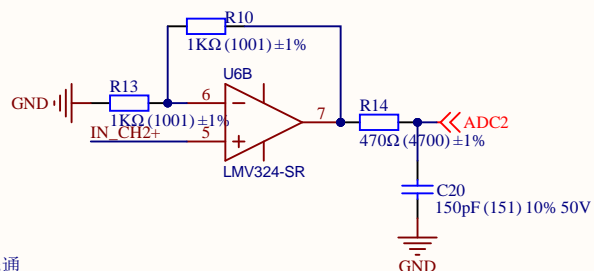

RC由采样频率决定




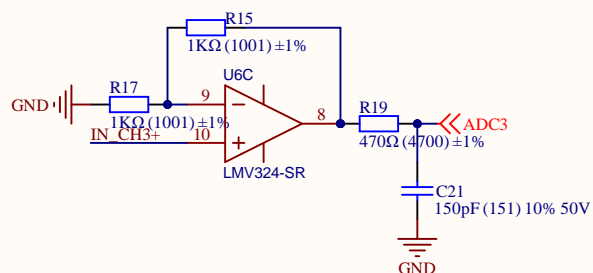


RC由采样频率决定

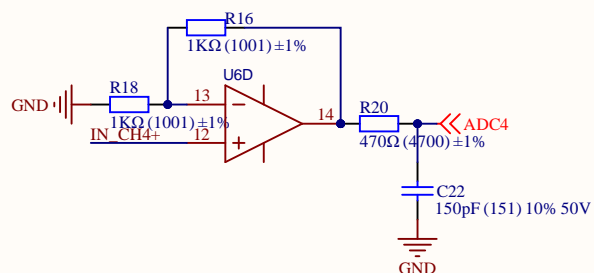


RC由采样频率决定


医疗床分压电阻选择

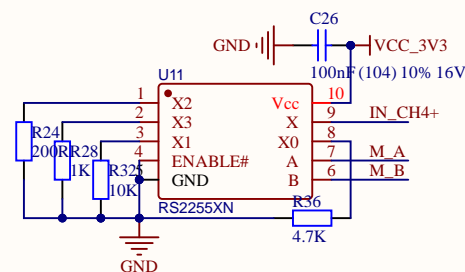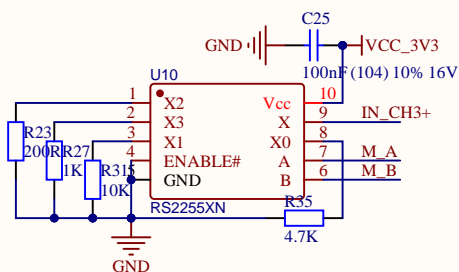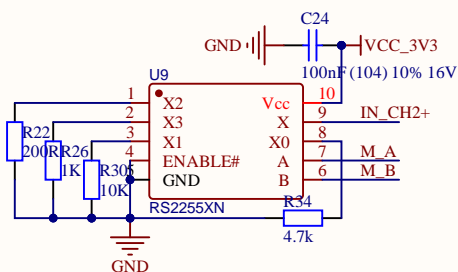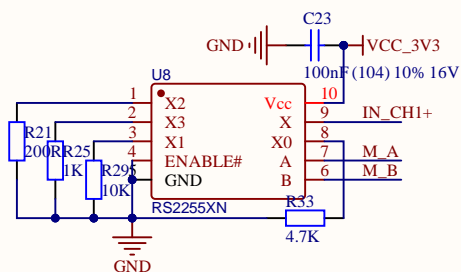


TYPE-C 5V @ 1A

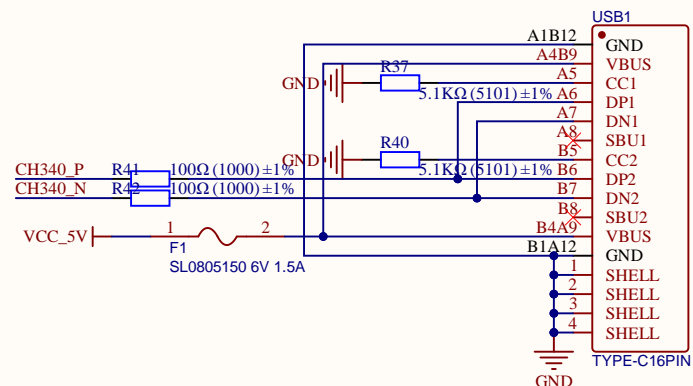

USB TO UART

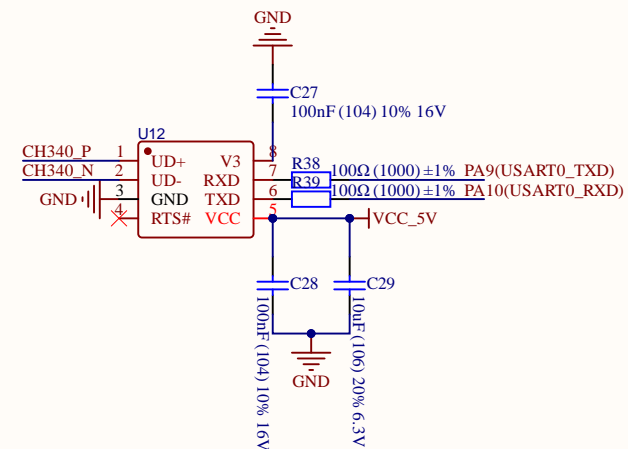


5V To 3.3V@1A

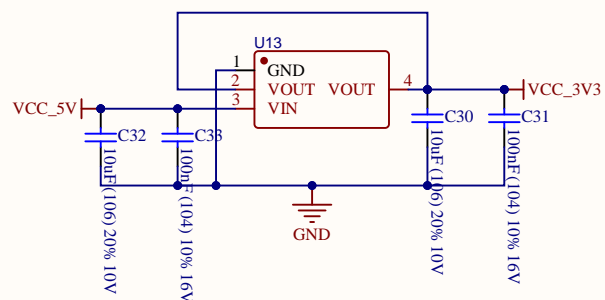


Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	6/26/2023	Sheet of
File:	D:\累现-工作资料\Power.SchDoc	Drawn By:

医疗床行列接头-正面

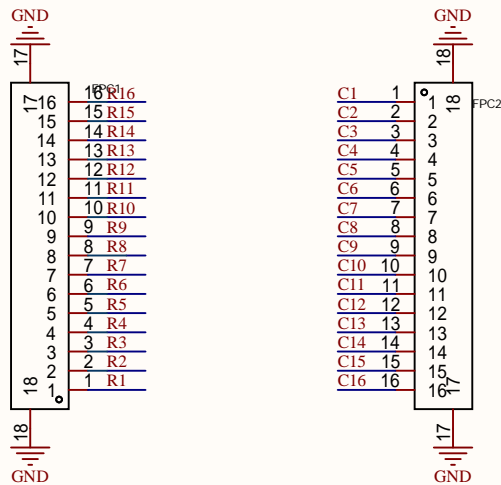

医疗床行选

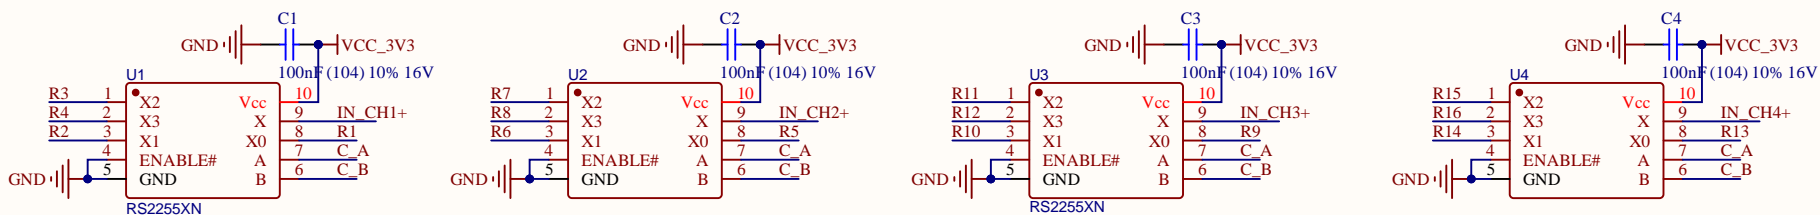

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	6/26/2023	Sheet of
File:	D:\墨现-工作资料\Scan.SchDoc	Drawn By:

