Relatório experimental de leitura espectral

Caracterização espectral e estimativa demonstrativa de Kappa

AMOSTRA PRÉVIA DE NOMENCLATURA	**OPERADOR** Exemplo de apresentação
DATA DA MEDIÇÃO 18/10/2026 — prévia de apresentação	**MÉTODO OPERACIONAL** Amostra seca / reflectância difusa

01 / Resultado do ensaio

KAPPA DEMONSTRATIVO	FAIXA DO MODELO EXPERIMENTAL
7,24	Faixa 3 — acima de 6 até 12

Estimativa por equações parametrizadas, sem validação analítica. A faixa numérica descreve apenas o modelo experimental; não identifica processo industrial nem teor de lignina.

RAZÃO R680 / R730 0,936	**RAZÃO R860 / R760** 0,902
SOMA DOS SINAIS ADC 15.292,8 ADC	**CANAL DE MAIOR SINAL** 610 nm / 8.729,8 ADC

02 / Perfil espectral relativo

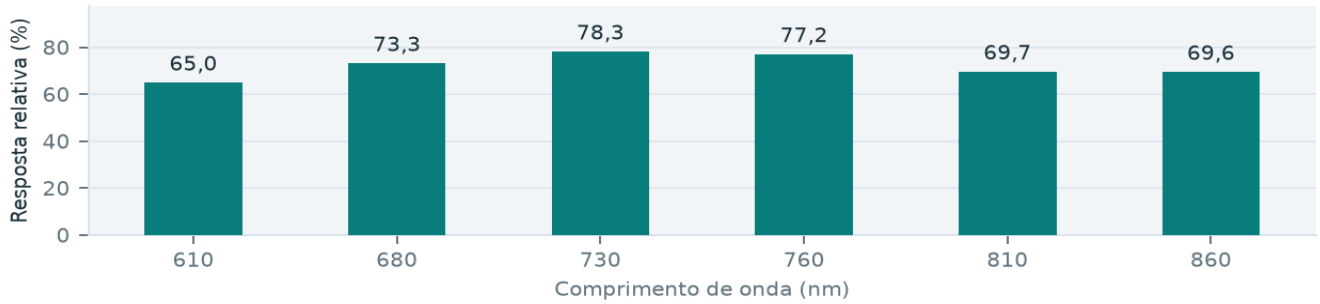

Canal	Sinal da amostra (ADC)	Resposta relativa (%)
610 nm	8.729,8	65,03
680 nm	3.217,0	73,27
730 nm	1.571,8	78,27
760 nm	853,6	77,15
810 nm	657,6	69,72
860 nm	263,0	69,56

ADC: contagens do detector. A resposta é relativa ao branco de trabalho, com correção do escuro; não representa refletância absoluta certificada.

Rastreabilidade

Referência instrumental, aquisição e condições do ensaio

03 / Referência utilizada na medição

REGISTRO DA REFERÊNCIA Referência registrada no ensaio	**REFERÊNCIA DE TRABALHO** Cartão branco fosco (referência de trabalho não certificada)
CALIBRAÇÃO REALIZADA EM 2026-10-18 08:34:46	**OPERADOR DA CALIBRAÇÃO** Operador
IDENTIFICADOR DA CALIBRAÇÃO e7eb5ecb5c87416c895bcd3fc79daa7f	**AQUISIÇÕES DA AMOSTRA** Não informado

Configurações registradas: Sensor: AS7263 / Ganho: 64x / Integração: 140,0 ms / Corrente LED configurada: 50,0 mA
Interface de comunicação: Não informado
Método do escuro: LED desligado

Canal	Branco (ADC)	Escuro (ADC)	CV branco (%)	DP escuro (ADC)
610 nm	13.424,2	0,0	0,44	0,00
680 nm	4.390,6	0,0	0,53	0,00
730 nm	2.008,1	0,0	0,57	0,00
760 nm	1.106,4	0,0	0,58	0,00
810 nm	943,2	0,0	0,57	0,00
860 nm	378,1	0,0	0,51	0,00

Aquisições do branco: 10 | Aquisições do escuro: 10. DP: desvio padrão amostral; CV: coeficiente de variação.

04 / Consistência das aquisições

Aquisições individuais insuficientes ou não disponíveis neste registro; desvio padrão e CV da amostra não foram calculados.

05 / Método e limites de interpretação

Correção por canal: resposta relativa (%) = 100 x (amostra - escuro) / (branco - escuro). As razões R680/R730 e R860/R760 são descritores utilizados pelo modelo parametrizado da bancada.
O Kappa é uma estimativa demonstrativa. Não foram atribuídos R^2, RMSE ou incerteza analítica sem dados de validação. O resultado não substitui um método de referência. Valores acima de 100% são preservados, pois a amostra pode retornar mais sinal que o branco de trabalho.
A presença de uma referência registrada não comprova, por si só, sua validade temporal ou a certificação do resultado. Campos sem dados são identificados como não informados. Este documento descreve o registro experimental e não possui validade oficial.
Observações da calibração: Branco medido + escuro com LED desligado; referências relativas

Registro do operador: Exemplo de apresentação | Documento gerado eletronicamente; sem assinatura digital.
Emissão: 18/10/2026 09:16:24 (UTC-04:00)