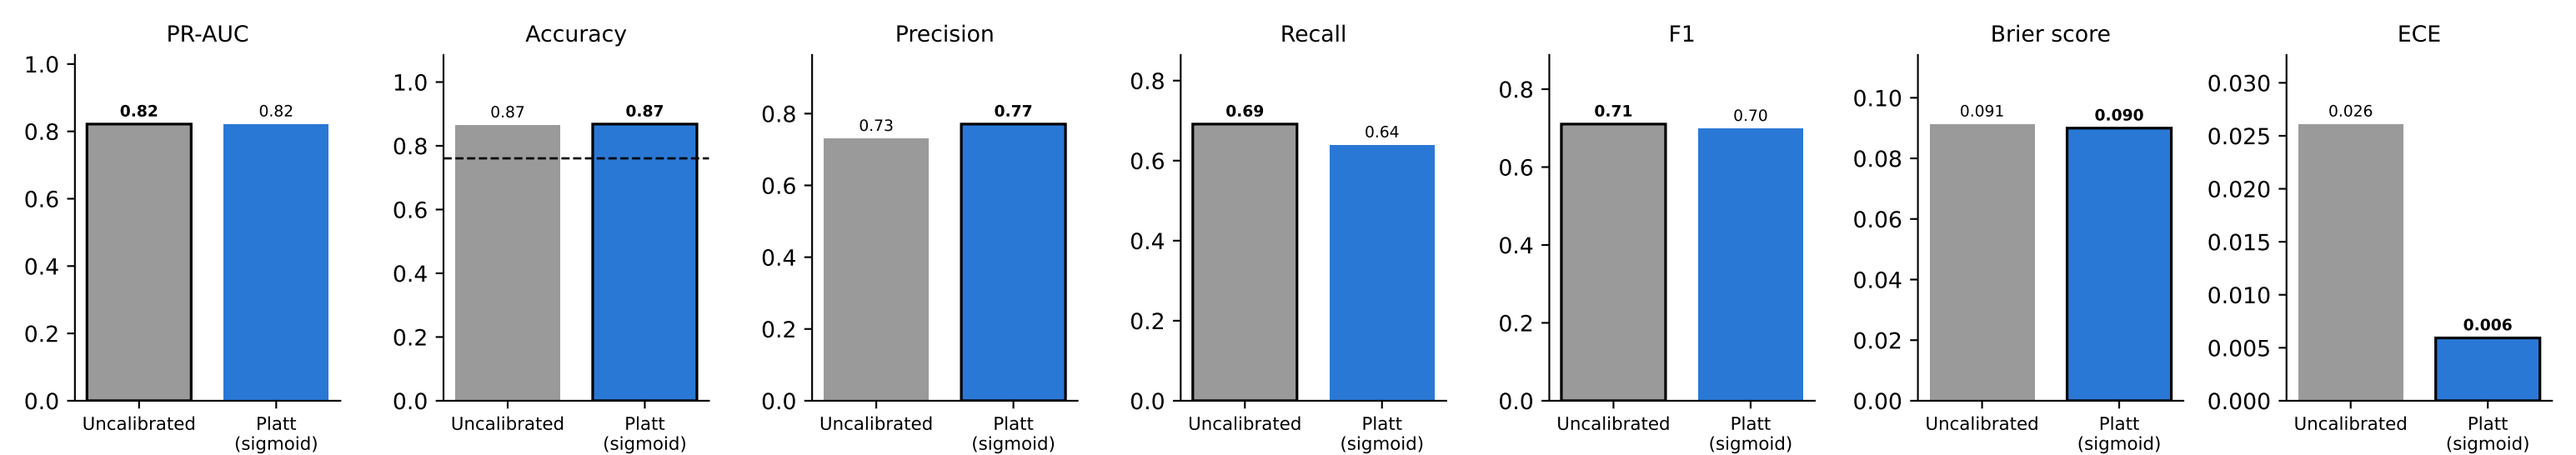
PR-AUC
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.82
0.82
Uncalibrated
Platt (sigmoid)
Accuracy
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.87
0.87
Uncalibrated
Platt (sigmoid)
Precision
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.73
0.77
Uncalibrated
Platt (sigmoid)
Recall
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.69
0.64
Uncalibrated
Platt (sigmoid)
F1
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.71
0.70
Uncalibrated
Platt (sigmoid)
Brier score
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
0.091
0.090
Uncalibrated
Platt (sigmoid)
ECE
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
0.026
0.006
Uncalibrated
Platt (sigmoid)