

KC桌面——外资精译

JPM：医疗科技与医疗服务行业，数字化转型与AI应用影响

数字化转型与AI在医疗领域的应用影响：幕后正在推进将带来未来市场份额增长的举措

数字化转型和AI应用近期似乎在医疗机构中悄然推进，我们总结了其短期影响。在我们覆盖范围内，我们认为这可能有助于日本光电的数字医疗解决方案部门在监护仪及其他产品上实现长期市场份额增长，尽管该业务规模仍然较小。在医疗服务行业，M3和JMDC正在各项业务中推进AI应用，虽然我们预期这将在长期内有助于增强竞争优势并提升新服务的盈利能力，但我们关注短期内与AI相关的研究增加（工程师招聘增加、AI系统使用费及资本支出上升）。

- 对日本光电的影响：日本光电的中期业务计划概述了一项战略，即通过专注于为住院护理医务人员提供报警解决方案以及促进住院患者监护与管理的系统，来扩大数字医疗解决方案的销售。我们预计，随着日本医院利用政府补贴部署ICT设备及软件以提升医疗机构运营效率并改善工作环境（申请提交计划于2026年6月开放），医疗服务领域对数字化转型和AI的采用将从2026年7月起增加。对于日本光电而言，尽管单个数字医疗解决方案产品的销售规模不大，但我们认为，在其于日本建立部署记录的同时，美国医院对其数字医疗解决方案产品的逐步认可，可能有助于提升其在美国患者监护仪市场的份额（装机基础）。事实上，新的数字医疗解决方案产品在2024财年为美国市场的监护仪销售增长做出了贡献，且这可能带来大型项目，因此我们认为从长期角度来看这很重要。在新冠疫情相关特殊需求结束后，由于日本及部分海外市场状况出现变化以及工资上涨，日本光电自2024财年以来盈利尤其仍在调整且估值较低。然而，自2025财年起，该公司已开始停止低利润业务并实施结构性改革。此外，日本光电在日本市场的监护仪销售在2025财年第四季度恢复了同比两位数的增长，且由于日本医院的资本支出似乎已显示出复苏迹象，我们预计报价将在2026财年第二季度前上涨（日本光电表示，日本市场状况改善应会在2026财年下半年全面贡献盈利）。

- 医疗设备制造商需要做出的改变：自生成式AI服务广泛推出以来，医疗机构一直在快速推进数字化转型和AI的试验，近期医院和诊所使用数字化转型和AI的案例在7月4日的Eucalia友谊会议上进行了展示（我们从第3页总结了要点）。自2026年7月起，日本医院已能够申请政府计划下的补贴，以提升运营效率并改善工作环境。该计划为每家医院提供最高8000万日元的补贴，用于支持ICT设备和软件的部署，包括通信设备、AI


医疗咨询、生成式AI文档创建、运输机器人、监护设备及网络基础设施。然而，随着医疗机构引入用于AI应用的先进计算机和系统基础设施（参见我们关于NVIDIA等公司提供医疗AI基础设施举措的报告），医疗机构在数字化转型和AI方面的研究似乎超出了我们的预期。我们认为，有效使用有限资金对医疗机构至关重要。在新冠疫情之前，将数字化转型和AI应用于医疗领域存在诸多挑战，包括与医疗机构实际需求脱节，以及涉及精准度、安全性、伦理和运营的问题（图15）。然而，近期获批的使用数字化转型和AI的医疗设备数量有所增加，虽然我们并未看到产品本身存在问题，但竞争性医疗设备制造商似乎已发布了越来越多类似的AI产品。在这种环境下，我们认为当前的关键问题在于产品是否具备使其成为医疗机构首选所需的竞争优势和独特功能。例如，福田电子的具备AI分析能力的心电图机能够提供与竞品类似的AI诊断，但能够在性能较低的计算机上使用该系统是与竞品相比的独特优势。鉴于近期关注焦点在于医疗机构部署数字化转型和AI所带来的固定成本上升不确定性，我们认为医疗设备制造商在开发使用数字化转型和AI的产品时，不仅需要考虑提升诊断和治疗能力，还需要考虑医疗机构的资本支出负担。

医疗前线数字化转型和AI应用加速推进

医疗前线数字化转型和AI应用会议要点

7月4日的Eucalia友谊会议从医院和诊所管理应从根本上最大化医疗专业人员与患者相处时间的角度，展示了众多近期在医疗前线使用数字技术和AI的案例，引发了广泛讨论。我们总结要点如下。

图1：日本临床工作流程支持系统市场规模

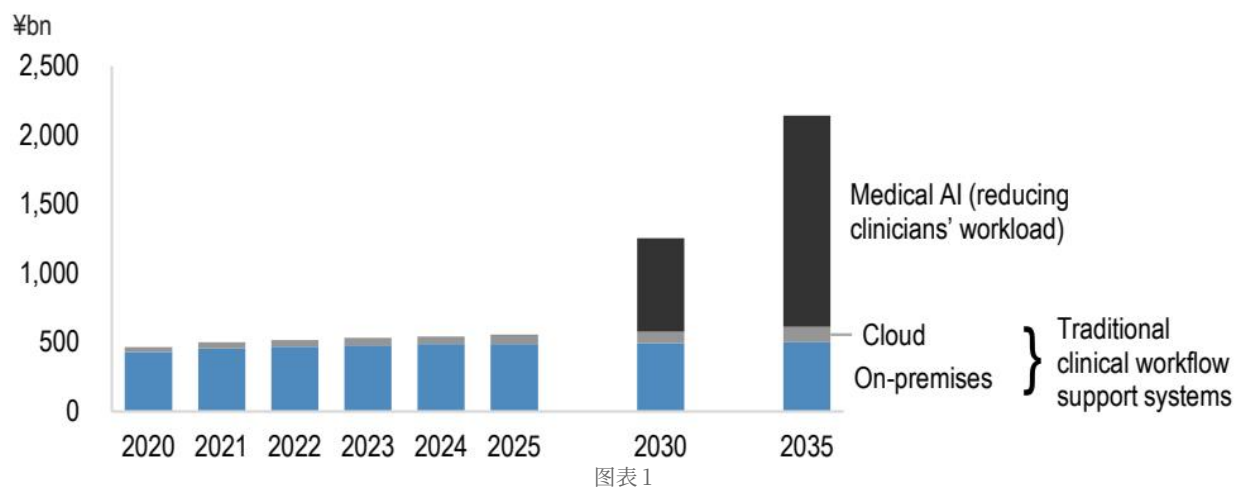

来源：Medley估算，JPM 注：历史数据为Medley估算。

(1) AI显著减少医疗实践中的文档编写时间

在某医院的一个案例中，通过语音识别捕捉患者与医疗专业人员之间的对话，并以SOAP格式（包含主观信息、客观信息、评估和护理计划）生成文本，使用AI能够在不到六十秒内生成电子病历。此外，使用Claude使医疗专业人员撰写常规电子邮件和信息材料的速度提高了1.8倍。

(2) 部分医院使用专有数据

会议展示了一家医院为应对2026年6月医疗收费修订而创建的数据分析仪表盘。特别是电子病历与各科室系统相连，因此该医院计划从这些系统收集数据，并用于改善运营和业务效率。

(3) 医疗文书自动化不仅减少医院营业时间，还带来追溯性补偿计费

讨论了医疗管理的未来方向。近年来，医院和诊所面临与医疗报销申请相关的专业化工作增加以及长期劳动力短缺的问题。会议重点介绍了一家医院通过使用机器人流程自动化（RPA）和自动化医疗管理操作，每月减少550个工时（相当于3.6名员工）的案例。这使得所有员工能够在白天专注于接待和面向患者的工作，而非内部行政任务。通过使用RPA，该医院还发现了此前因依赖人工技能而被忽视的数千万日元医疗索赔，并成功申请了追溯性报销。

(4) AI代理可能取代部分医院的接待操作和专科分诊，可能导致医院和诊所因使用AI而增加资本支出

会议展示了一款由富士通和英伟达为医疗机构联合开发的AI代理，可帮助接待员为患者分配专科医生。该产品通过标准化既往接诊问询，让患者到达医院后在屏幕上与AI虚拟形象对话，使AI能够接管患者登记和问询等任务。AI还可以接管将患者分配给适当专科医生的任务，自动化此前由医疗专业人员执行的一系列接诊任务。未来，这些公司计划通过提前为患者定制问询，在患者智能手机上进行筛查，建议应就诊的专科医生，并告知是否可以选择在线问诊。这些举措旨在促进医院与患者的首次接触。由于医院需要具备一定的复杂度的计算机来安全处理内部机密医疗数据并使用生成式AI，我们认为对桌面AI超级计算机的需求可能会增加。

(5) 在线问诊的普及

在线问诊目前在中国和印度最为普及。在日本，大多数在线问诊在诊所使用，但医院常使用医生对医生的在线服务，让心脏外科医生及其他医生与远程地点的专家协作。诸如DeNA开发的医疗专业人员沟通应用Join等产品的使用正在增加。

关键在于数字解决方案和AI功能能否获得认可和重视，最终推动设备市场份额增长


日本光电：DHS业务规模仍小，但焦点在于其是否有助于提高北美监护仪市场份额

日本光电的中期计划战略是扩大向医院销售数字健康解决方案（DHS），我们预计包括报警解决方案和下一代中央监护仪在内的新产品将从2026财年起贡献收益。特别是在日本医院，我们预计从2026年7月起，日本政府旨在通过使用信息通信技术（ICT）设备提高医疗前线运营效率和工作环境的补充预算将得到更多使用，从而增加数字技术在医疗中的应用。我们还认为，从2026年6月起医院诊疗费用的上调改善了其商业环境，提供了一定的保障。因此，我们认为这可能为日本光电患者监护业务的DHS产品销售提供一些顺风。尽管该公司DHS的销售规模仍然较小，但我们认为其利润率优于设备产品。作为未来的关注点，尽管飞利浦和GE医疗目前在美国市场占据高份额，但我们认为重要的是日本光电的DHS能否受到医院欢迎，并有助于其患者监护系统在美国市场份额的提升（基于已安装设备）。

图2：日本光电：提升医院管理效率和医疗宏观环境学的关键新产品与服务

来源：公司数据、公司估计、JPM 注：解决方案业务 = DHS（数字健康解决方案）+ ITS（IT解决方案）；PFM（患者流量管理）中心：实时收集和分析院内数据，床位利用率和患者接诊/接收状态以集成方式进行集中管理。


图3：日本光电：DHS+ITS产品日本销售额

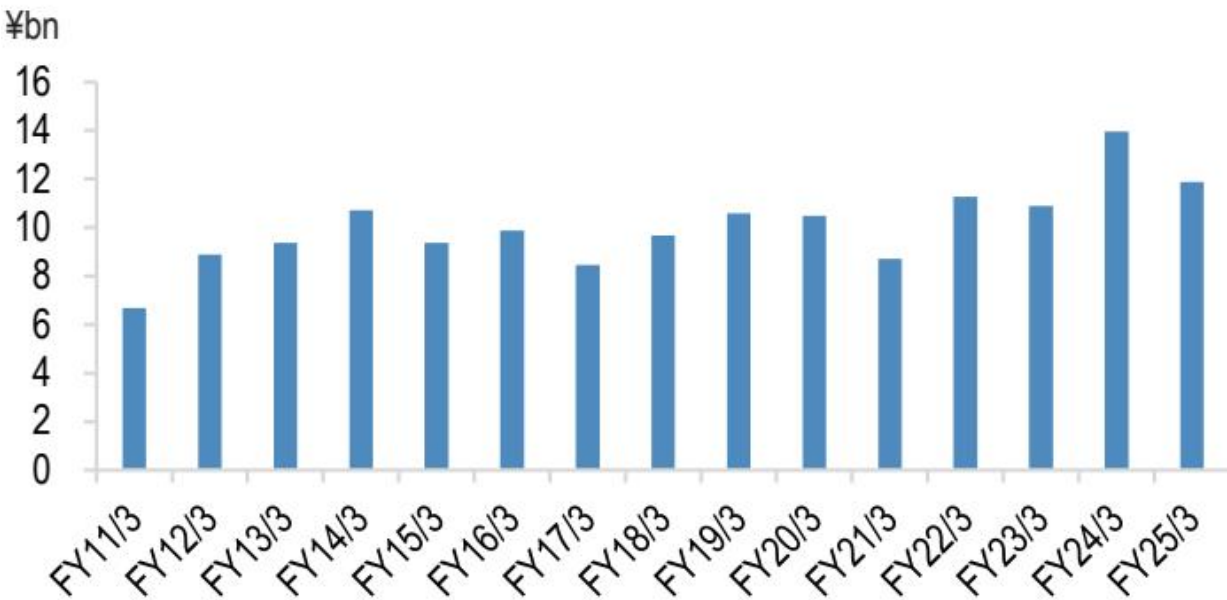

图表 2

来源：公司数据、JPM


图4：DHS产品北美市场规模

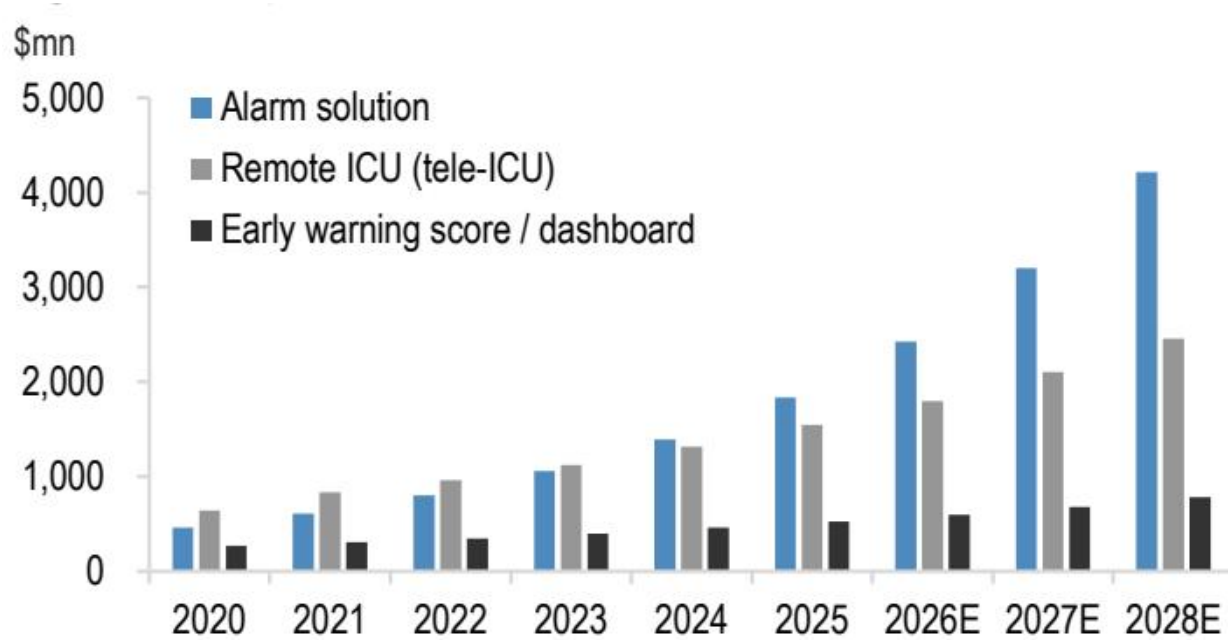

图表 3

来源：日本光电、日本光电估计（自2026年起）、JPM


图5：日本光电：按类型划分的销售额

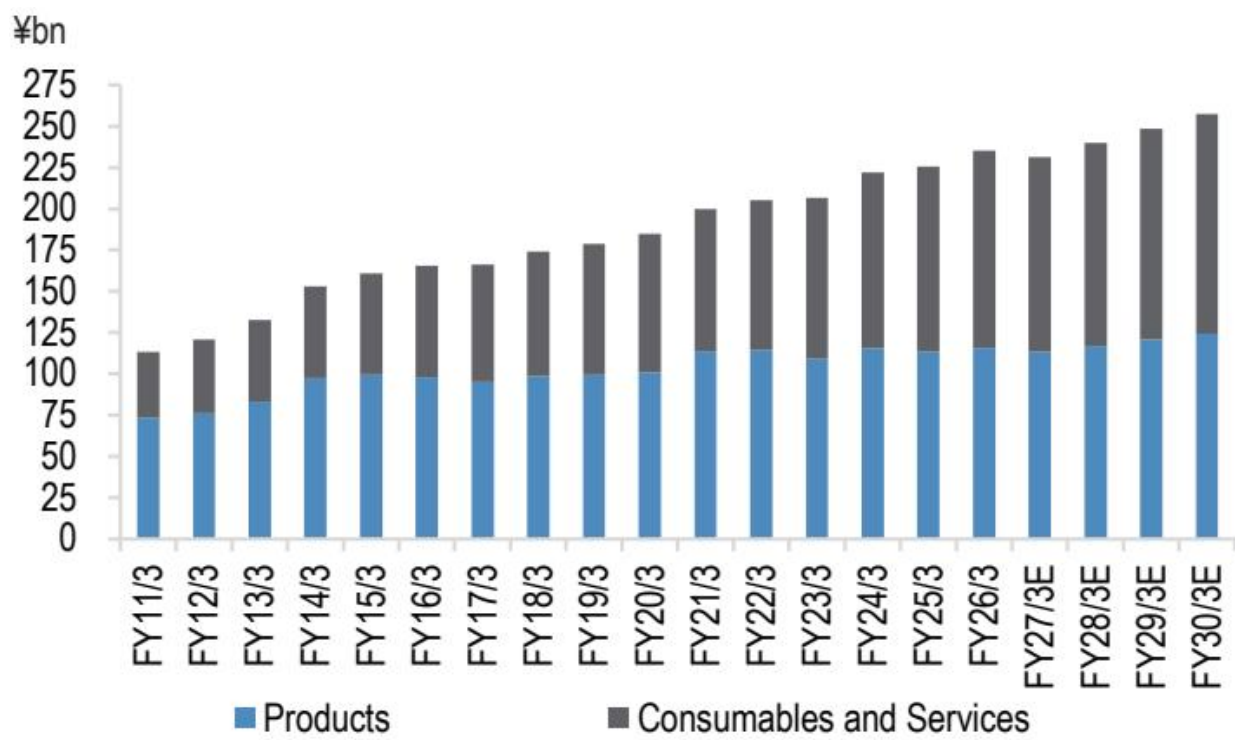

图表 4

来源：公司数据、JPM估计

图6：患者监护仪全球市场份额（2024年）

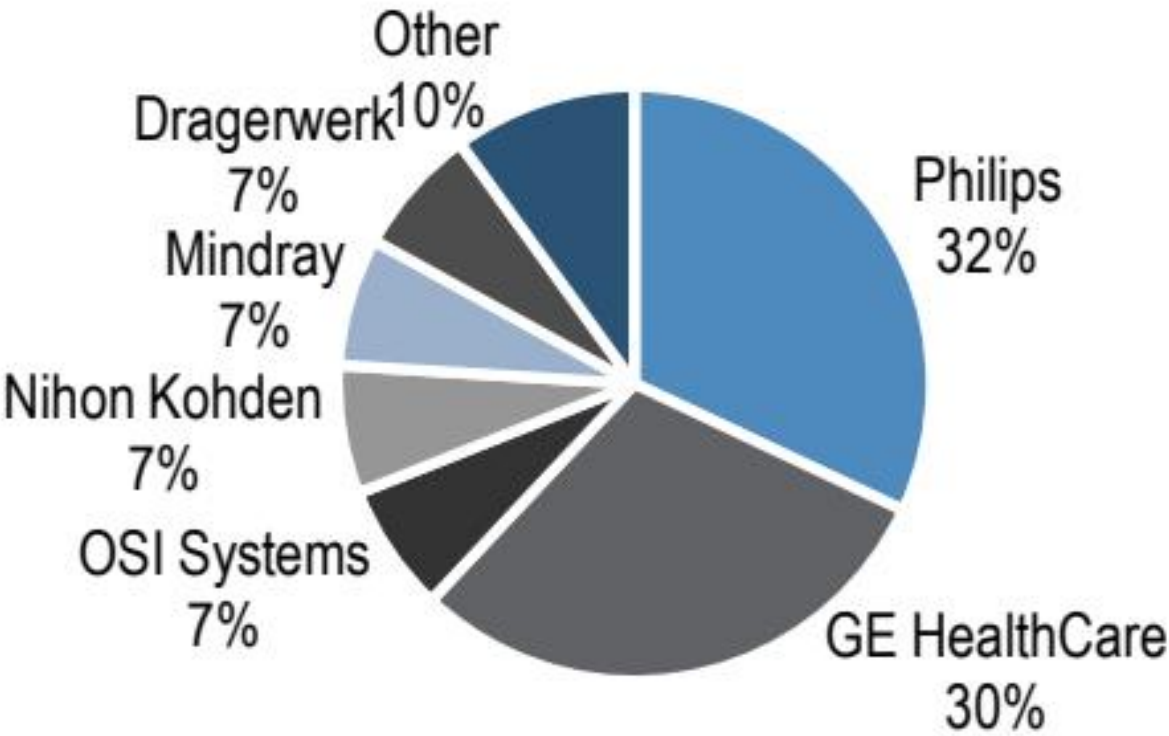

图表 5


来源：Spherical Insights、Precedence Research、JPM

日本光电：减少病房医护人员报警疲劳的解决方案

日本光电的优势之一是其用于测量患者生物特征（如血氧饱和度、呼出二氧化碳、脉搏和脑电波）设备的传感器技术。该公司基于这些信息提供高精度报警管理系统。当住院患者的报警响起时，目前医疗专业人员会前往患者处亲自核实情况，但这已成为医疗前线的一个问题，有数据显示约85%的核实是不必要的（截至2026年，来源：日本光电资料）。为解决这一报警问题，日本光电向医疗前线提供报警报告（其服务人员离线收集和分

析报警数据并提出运营改进建议），并于2025财年推出了一款现场报警分析软件。该软件实时、现场按患者显示报警的发生和原因，使医疗前线的报警管理更加便捷。现场报警分析软件QP-841N于2026年2月在日本推出，定价150万日元，公司预计到2028财年将售出超过100套，主要面向日本医疗机构。它计划继续研究于高精度报警检测技术的研发，并为医院病房报警管理提供全面的咨询服务（图7-8）。


图7：日本光电：报警状态持续时间

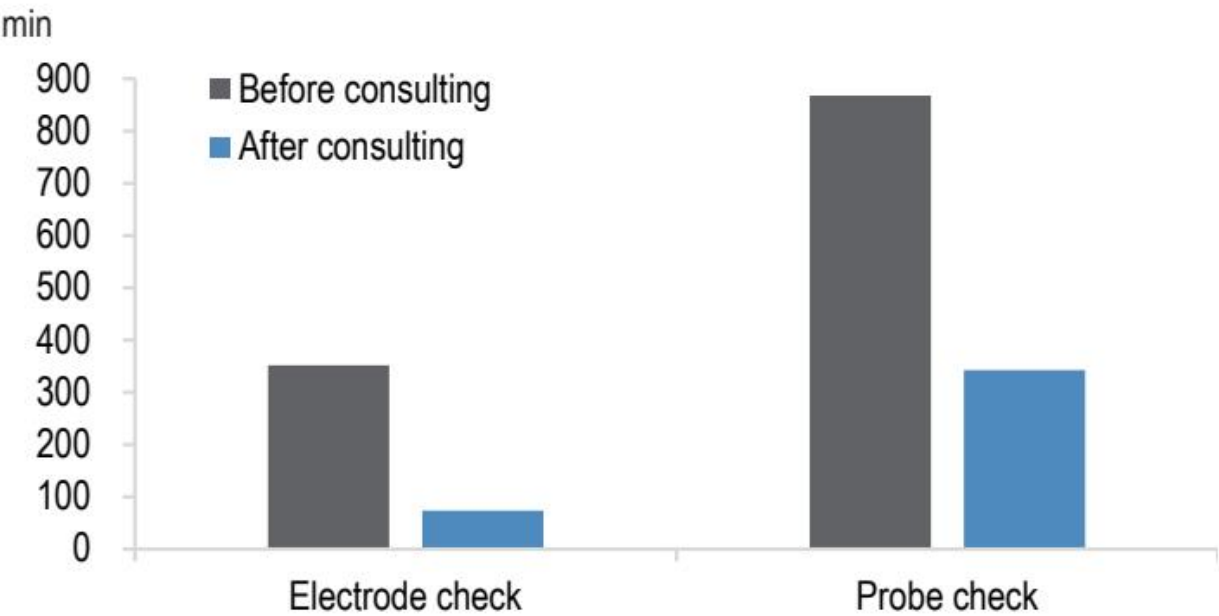

图表 6

来源：公司数据（2026年）、JPM

图8：日本光电：报警声音持续时间

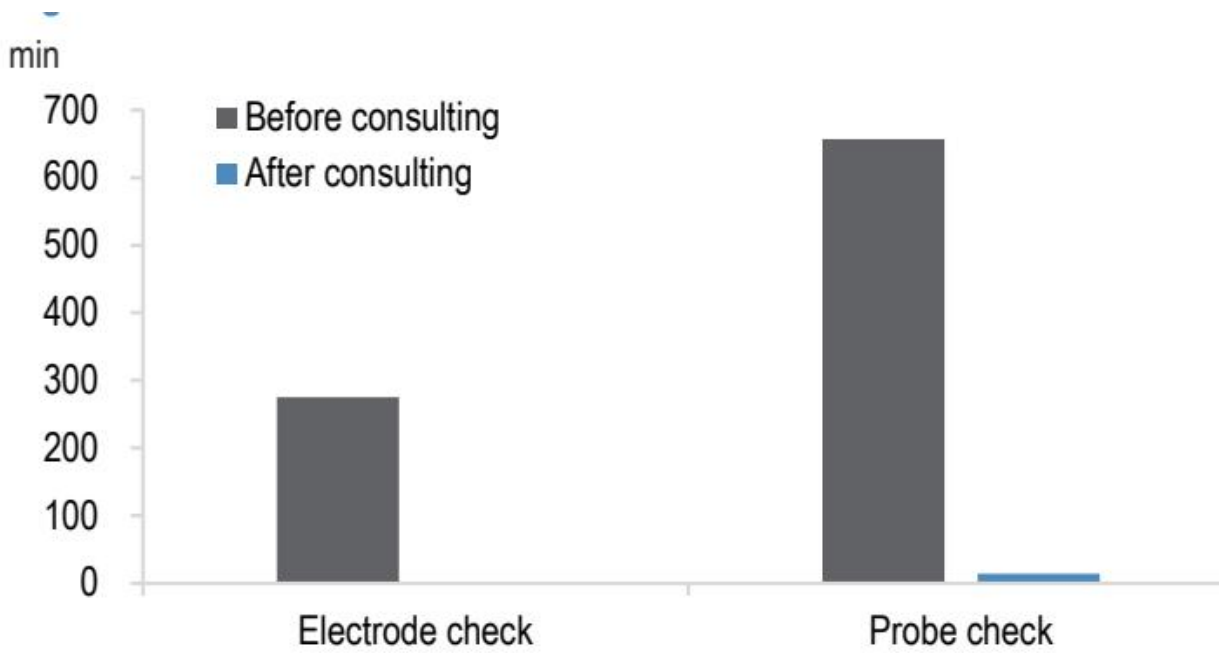

图表 7

来源：公司数据（2026年）、JPM

福田电子：AI诊断提高房颤症状检出率并有助于预防，可在非高端计算机上使用

福田电子（未覆盖）与日本光电存在竞争关系，于2024年推出了具备AI分析功能的心电图仪CardiMax 9 Ai（FCP-9900Ai系统）。该系统能够评估既往房颤，这是传统心电图难以做到的，我们认为它有助于房颤不确定性的早期发现和预防发作。福田的技术曾发表于2026年7月2日的《自然》杂志（文章见此）。此外，尽管多家海外竞争对手也推出了类似的AI诊断产品，但我们认为福田产品的优势在于其使用的算法不仅适用于适合AI的高端计算机，也能在配备标准CPU的通用计算机上运行。鉴于医疗领域将AI使用带来的固定成本增加视为不确定性，我们预计市场对这类能降低医院使用AI的资本支出负担的技术需求将更加强劲。


医疗器械制造商中数字化转型和AI应用的现状

数据分析与AI在诊断影像领域的应用正在推进

AI在诊断影像领域的应用正在推进。近期有报道称，约20%的早期癌症在过去的内镜检查中被漏诊（来源：AI Medical Service，2026年），多个AI诊断产品已获批。我们认为，对于单个公司而言，收集内镜图像并不容易，这已成为开发AI内镜产品的瓶颈。奥林巴斯尽管在全球胃肠内镜市场占有率超过60%（截至2026年），但也没有内部系统来收集检查图像，我们认为这一过程需要与医生合作且成本高昂。

近年来，全球胃肠内镜市场份额有所波动（富士胶片的市场份额近期有所上升），能够替代内镜的简单初步筛查检测也在增加。我们认为，从长远来看，研发能够减轻患者负担并提高内镜准确性的产品非常重要。

图9：内镜AI产品

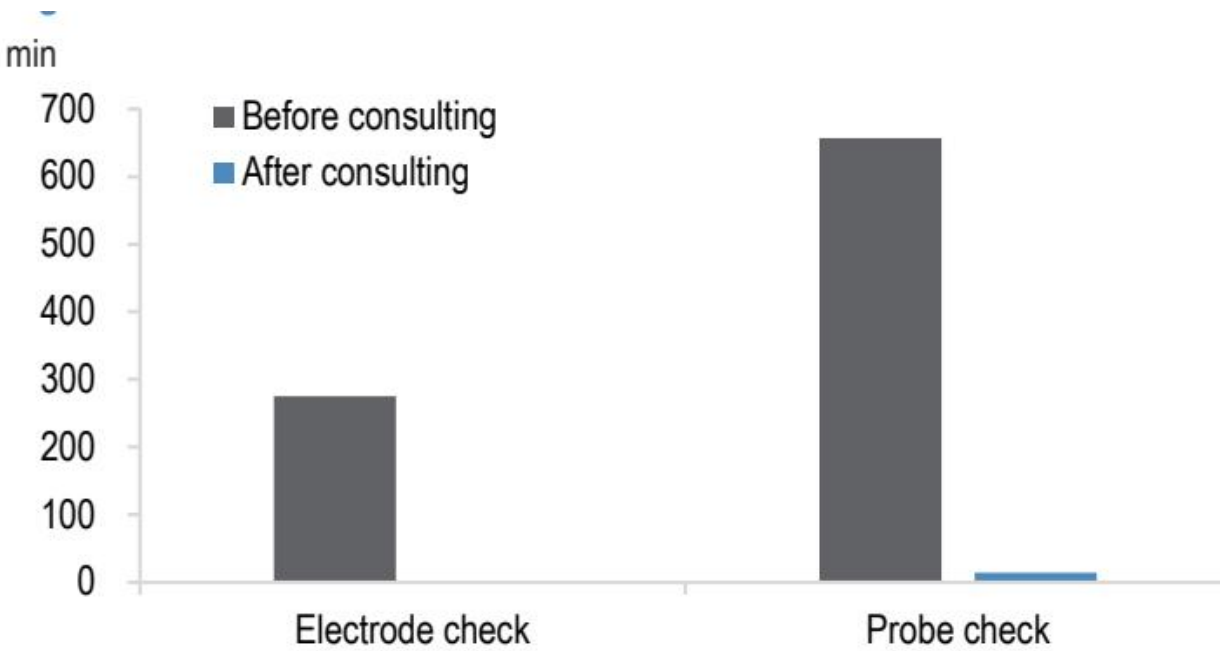


图表 8

来源：公司数据，JPM

数据分析与AI在治疗设备和体外诊断检测中的应用有限，但在新业务和工厂中正逐步推进

与诊断影像相比，数据分析与AI在用于治疗 and 手术的医疗器械中的应用目前似乎有限。然而，主要经营心血管产品的泰尔茂计划专注于影像业务（血管内超声成像、光学频域成像），并正在研发如何将AI用于这一新业务（图10）。同样专注于心血管产品的朝日英达科正在尝试利用数据分析和AI来提高工厂生产率并缩短文件编制工作（包括监管审批所需文件）（关于泰国工厂的举措，请参见我们的报告）。

图10：血管成像中的数字化转型与AI应用

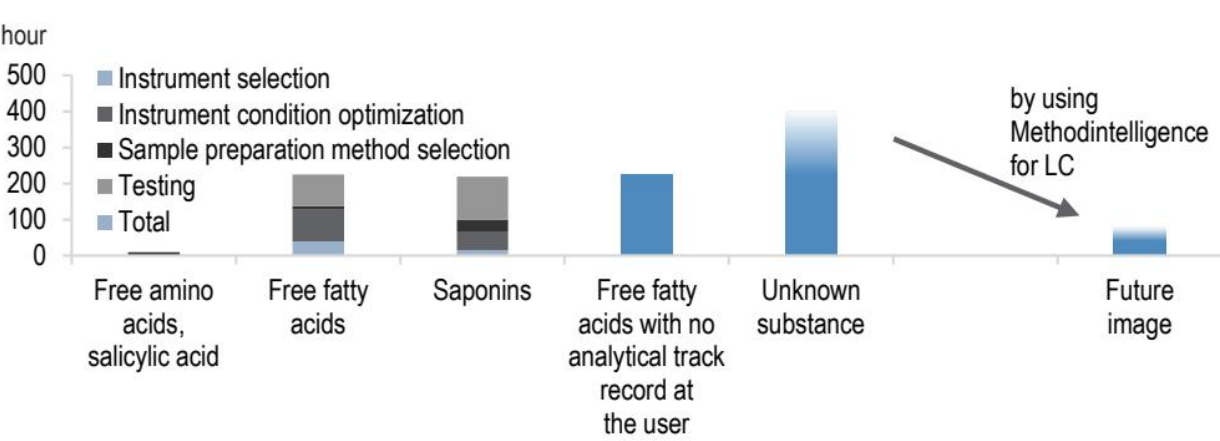


图表 9

来源：公司数据，JPM

在希森美康的核心业务——体外诊断检测领域，尽管目前配备AI功能的检测设备数量有限，但AI在实验室中的应用总体上正在逐步扩大。例如，罗氏等公司正在利用AI预测耗材更换、设备故障、校准错误和停机时间，旨在提高实验室产能利用率并降低维护成本。各公司还在努力支持诊断，包括通过试剂批号异常检测进行质量控制，以及通过AI分析检测结果进行患者不确定性评估。此外，作为希森美康长期愿景的一部分，尽管我们认为其对盈利产生贡献需要相当长的时间，但其目标是在包括印度在内的亚太地区利用数据分析来提高设备利用率，并从医疗成本效益的角度成为各地区政府的首选品牌（参见我们的报告）。

图11：体外诊断检测中的数字化转型与AI应用

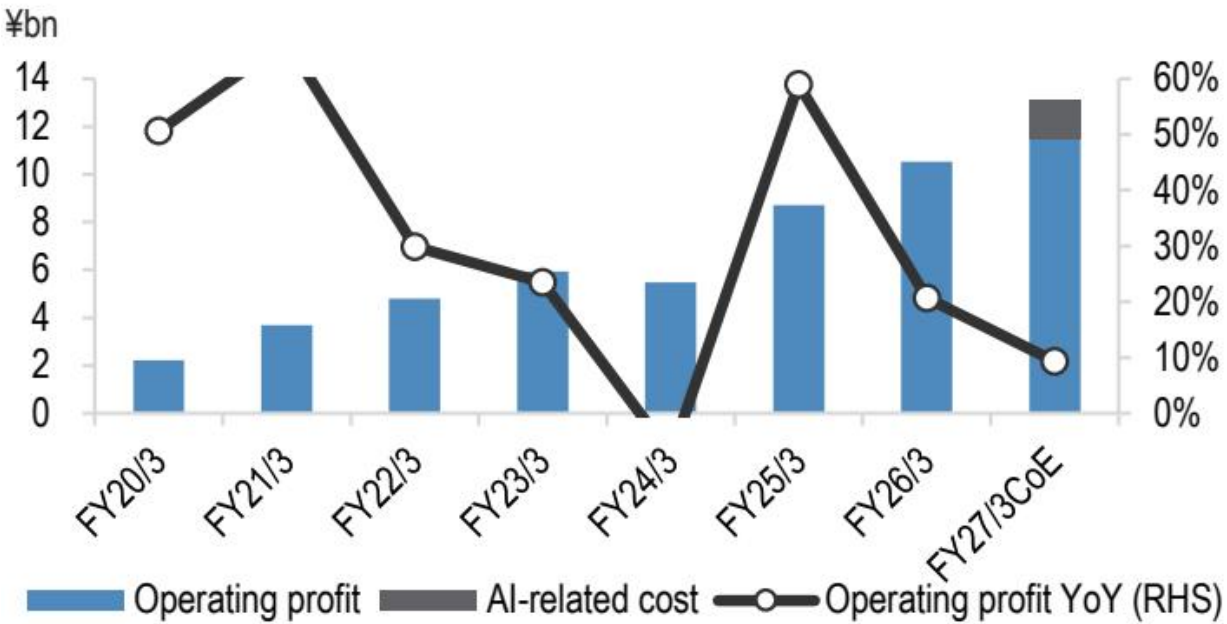


图表 10

来源：公司数据，JPM

在生命科学领域，利用AI也能带来竞争优势

岛津制作所在其2025年9月的分析计测仪器部门简报会上推出了数款新软件产品（参见资料第22-24页）。其新的AI分析方法创建软件“Methodintelligence for LC”采用了类似生成式AI的系统，当用户用日语或英语输入想要分析的物质和条件文本时，它会根据过往论文数据和岛津自有的分析数据，即时提出最优测量条件以及适合用户设备的最佳测量条件。该公司的AI专家团队花费数年时间开发了这款软件。我们认为其进入壁垒很高，因为开发不仅依赖于已发表论文的数据，还依赖于岛津积累的分析数据。该新产品尚未发布，公司设想以月度订阅模式提供。该公司在开发节省分析时间和精力的软件方面领先于竞争对手（它利用AI来涵盖分析方法创建、自动波形处理和异常峰检测等任务），我们认为其未来将拥有竞争优势。此外，我们的印象是，岛津的业务总体上被AI替代的不确定性较小。我们认为AI无法直接替代测量仪器，但测量仪器的客户（如制药商）已开始有部分研发流程中使用AI，因此测量仪器的使用频率长期来看可能会下降。

图12：液相色谱质谱联用中评估分析条件所需时间的示例

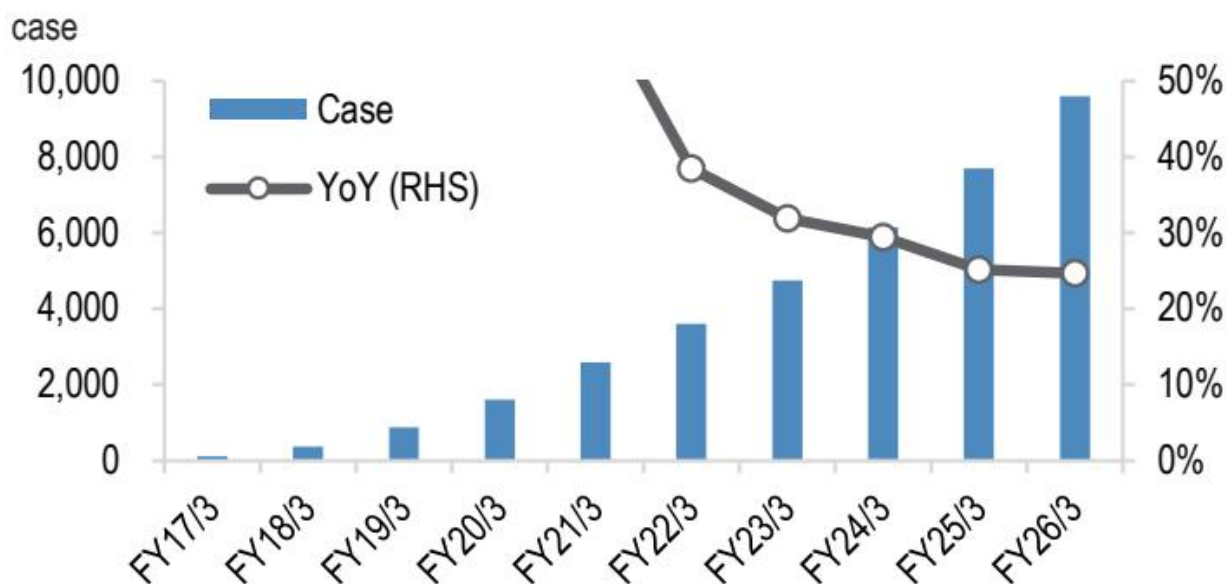

图表 11


来源：JPM基于鸟取大学Soichiro Okita等人的估算，2023年

AI在医疗保健领域应用的影响

长期来看，这可能增强公司的竞争优势并提升新服务的盈利能力；短期来看，我们将密切关注成本上升。JMD C以医疗大数据分析为核心业务，该业务长期以来与数字化转型（DX）和人工智能的整体应用紧密相连。关于人工智能演进对公司的影响，管理层在2025财年第四季度业绩说明会上表示，AI并未取代其咨询服务和分析服务，而是降低了分析门槛并加速了假设验证周期，从而加快了与客户公司的讨论及提案活动。管理层称，其项目种子确实在成长，结合其他行业公司数据的新商机也在扩大。此外，鉴于医疗数据所需的高可靠性，JMDC表示预计此类数据不会被合成数据大量替代。同时，鉴于行业变化和AI演进，公司宣布计划在2026财年加速对AI的战略研究。其2026财年指引预计营业利润仅同比增长9%，而销售额增长20%。JMDC解释称，2026财年是加速AI相关研究（包括为中期业务增长所需的人力资源和基础设施）的时机（近50%的战略研究将用于AI使用的基础设施研究和增加AI工程师，略超50%的研究将用于增加数据顾问）。虽然公司希望在2026财年基本完成工程师和数据顾问的招聘，但我们担心这可能会推迟到2027财年。

M3在2025财年第四季度业绩说明会上展示了多种融入AI的产品和服务。公司表示，AI正越来越多地替代其核心医药营销支持业务中的操作，与2019财年相比实现了20%的生产率提升，并计划未来实现显著的生产率提升。公司还表示，AI使得针对新药营销的医生定位比以前更高效。然而，我们认为M3似乎认为AI产品本身长期来看可能会变得商品化。我们相信其竞争优势在于能够从其自身平台获取大量专有医疗行业数据。特别是，它拥有M3 DigiKar，这是日本市场份额领先（截至2026年）的基于云的电子病历应用，因此我们认为其易于获取广泛的最新数据。由于M3利用这些专有数据估算患者数量和药物处方，我们认为其医药营销支持业务被其他公司取代的可能性很小。然而，短期内，我们看到了在日本基于云的电子病历市场（包括Medley）与竞争对手竞争加剧的不确定性。随着日本政府目标实现100%的电子病历普及率，我们认为基于云的电子病历行业环境正在发生变化。WEMEX（PHC Holdings子公司）原本在日本诊所的本地部署电子病历市场中占据领先份额（截至2022年），目前正在发展兼具本地部署和基于云的电子病历优势的混合病历，以及100%基于云的电子病历。我们将关注行业竞争加剧对M3的影响，包括销售及管理费用的一次性增加。


图 13：JMDC：营业利润与 AI 相关研究

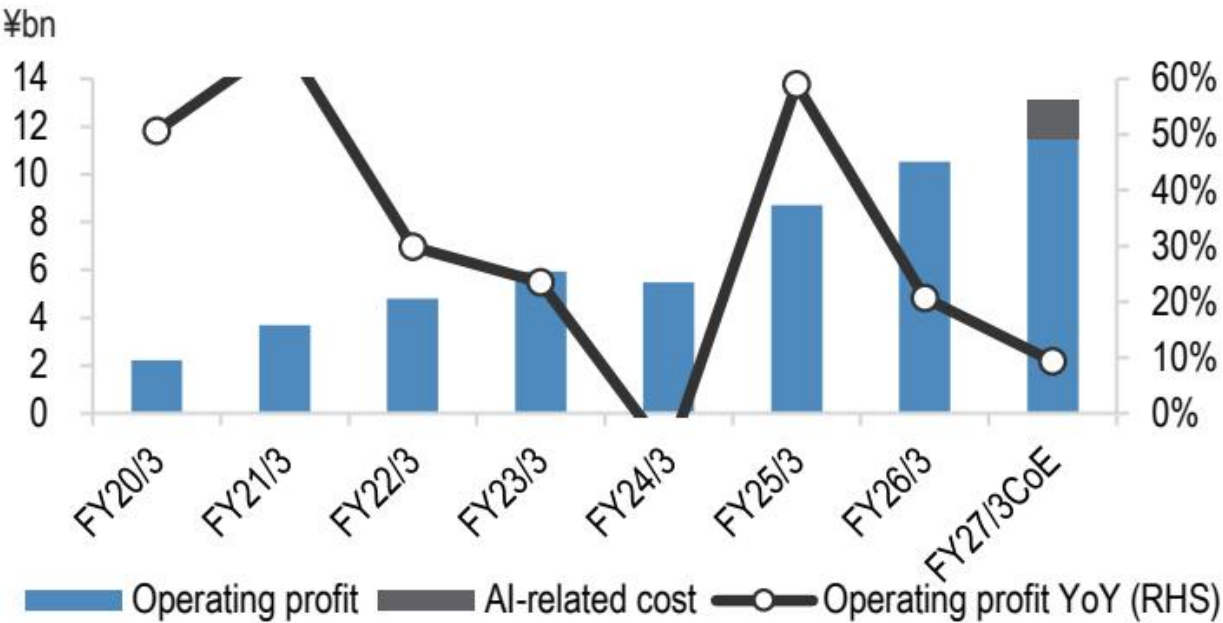

图表 12

来源：公司数据，JPM

图 14：使用 M3 DigiKar 的医疗机构累计数量

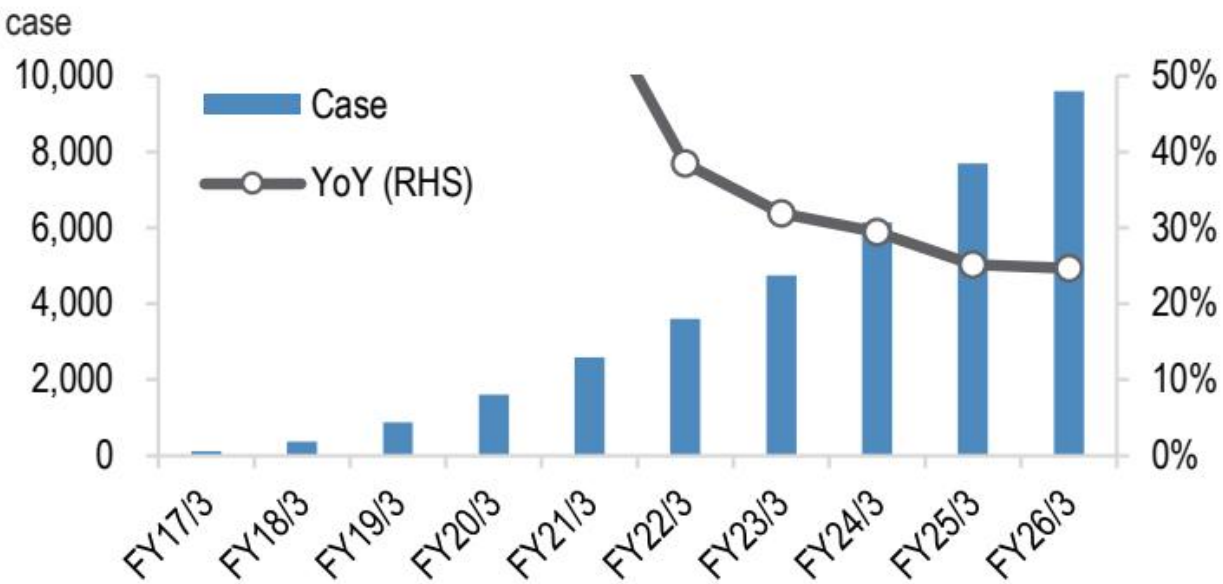

图表 13

来源：历史数据为JPM基于公司数据的估算

图 15：新冠疫情前医疗领域 DX 与 AI 应用面临的挑战案例

来源：公司数据，JPM