

KC桌面——外资精译


中国医疗健康：2026年5月中国医院设备招标：单月招标金额同比小幅转正

中国医疗健康：2026年5月中国医院设备招标：单月招标金额同比小幅转正

我们持续追踪9类医疗设备的招标数据。自去年12月以来连续五个月同比下降后，这9类设备的总招标金额在5月录得同比小幅增长 $+0.1\%$ 。我们认为这符合我们之前的预期，即该板块将从温和的同比下降过渡到温和的同比增长阶段，我们仍预计行业更明显的复苏将在2026年下半年出现。

按设备类别划分，5月仅有CT、MRI和直线加速器录得同比正增长。此前持续正增长的患者监护仪未能保持强劲势头。但考虑到疫情期间采购的许多监护仪现已进入更换周期，我们仍看好未来患者监护仪招标数据的潜在改善。


图表1：中国9类主要医疗设备总招标金额（单位：百万元人民币）

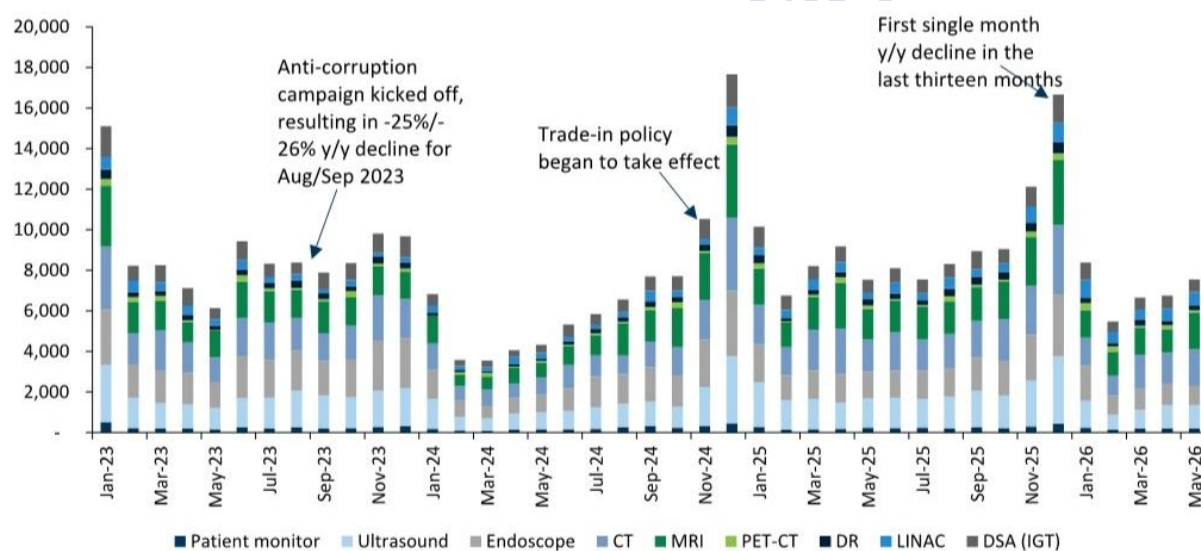

图表 1

来源：Joinchain

图表2：招标金额同比变化率

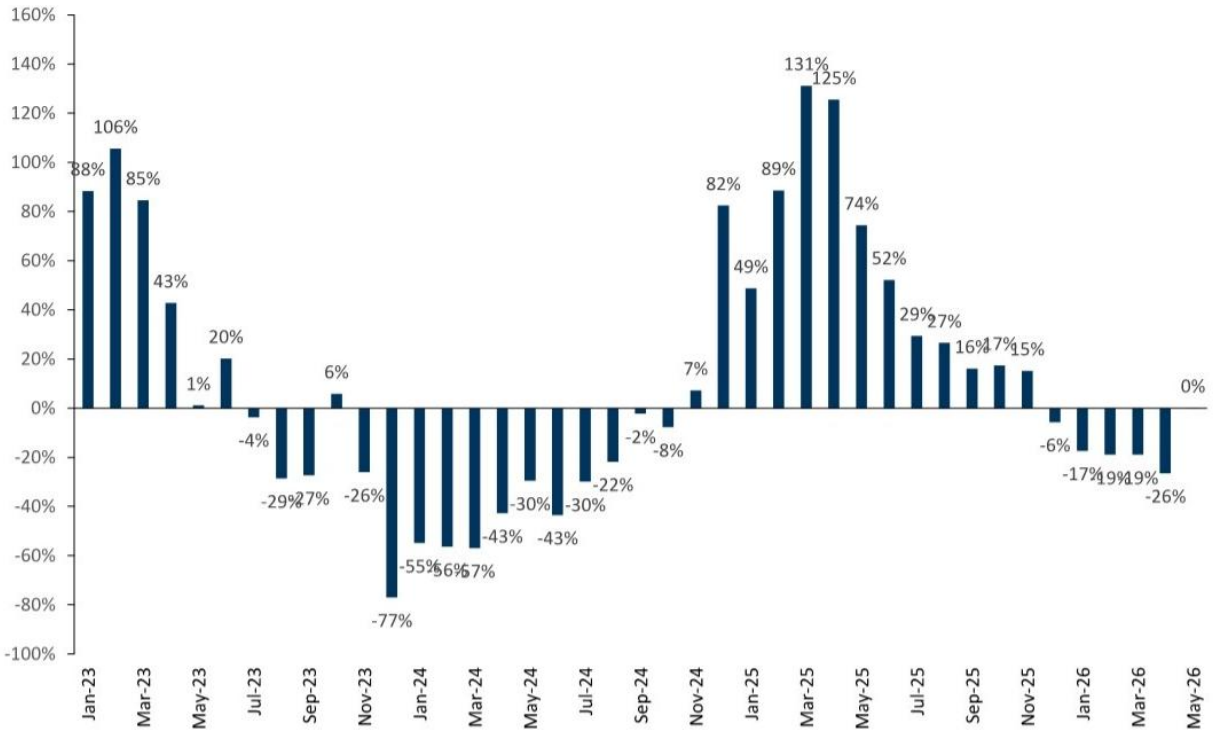

图表 2

来源：Joinchain

关联分析：迈瑞医疗与联影医疗

对于联影医疗，其今年前五个月的招标金额同比增长了+9%，使其成为主要竞争对手（包括GEHC、西门子医疗、飞利浦和东软医疗）中唯一实现正增长的公司。我们认为这主要得益于公司在CT和MRI领域稳定的市场份额，以及在DSA和直线加速器等品类中的份额增长。公司近期公布的新股权激励计划要求2026-28年每年营收增长超过20%；否则该计划将不会完全触发。考虑到国内招标需求仍处于复苏早期阶段，我们目前的预测（19.3%）略低于公司隐含的指引。我们预计公司2026年的海外增长率仍将高于国内增长率，其营收贡献将超过25%。


图表3：联影医疗按地区划分的营收构成

对于迈瑞医疗，2026年第一季度其中国营收同比下降\$-11\%\$，而海外营收同比增长\$+16\%\$（以美元计则同比增长\$+20\%\$）。其新兴业务在中国和海外均实现了快速增长。然而，其PMLS和医学影像业务在中国市场仍处于去库存过程中（公司现已指引该过程将在2026年第二季度结束），而IVD业务有所改善，尤其是凝血和免疫业务，据公司称均同比增长约+10%。此外，公司表示其三大核心IVD业务——免疫、生化、凝血——的平均市场份额从2025年上半年的10%增至2025年底的12%，并在2026年第一季度进一步升至13%。我们预计公司2025年中国营收将在低基数上实现正增长，而海外市场将继续保持两位数增长。

图表4：迈瑞医疗营收构成

九大品类详细招标数据


图表5：2023年1月以来患者监护仪采购金额

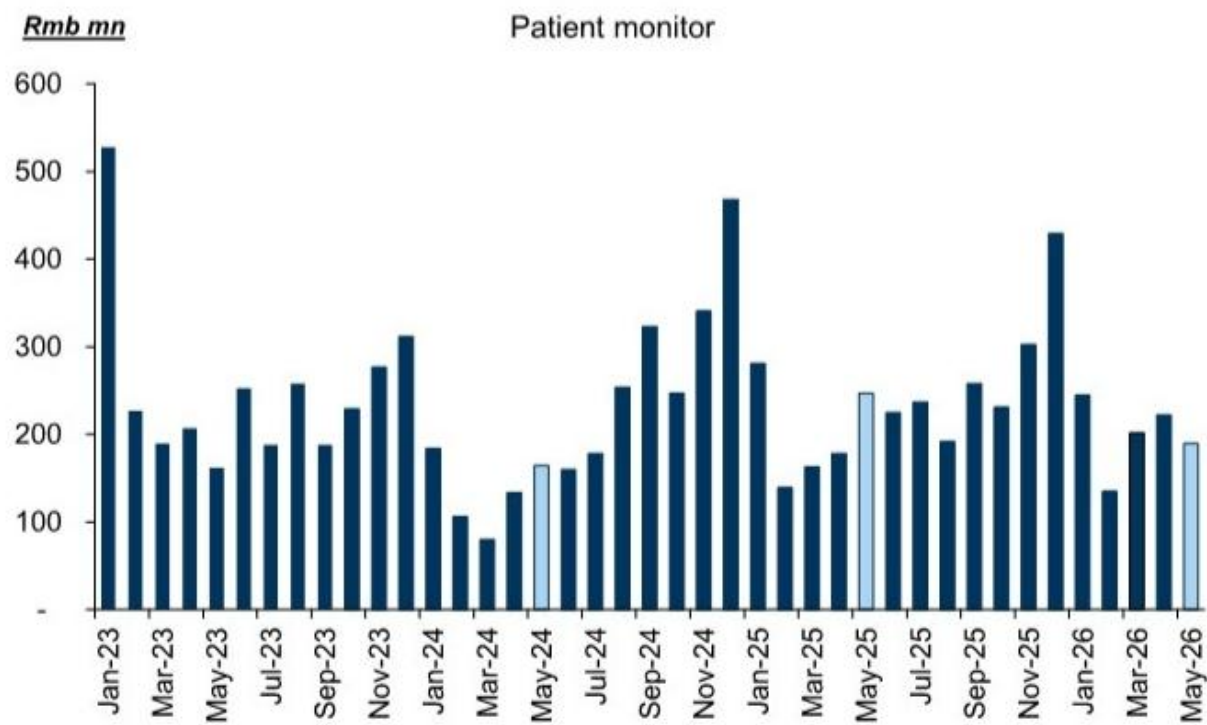

图表 3

来源：Joinchain


图表6：2026年5月患者监护仪采购金额同比下降-23%，2026年4月为+25%

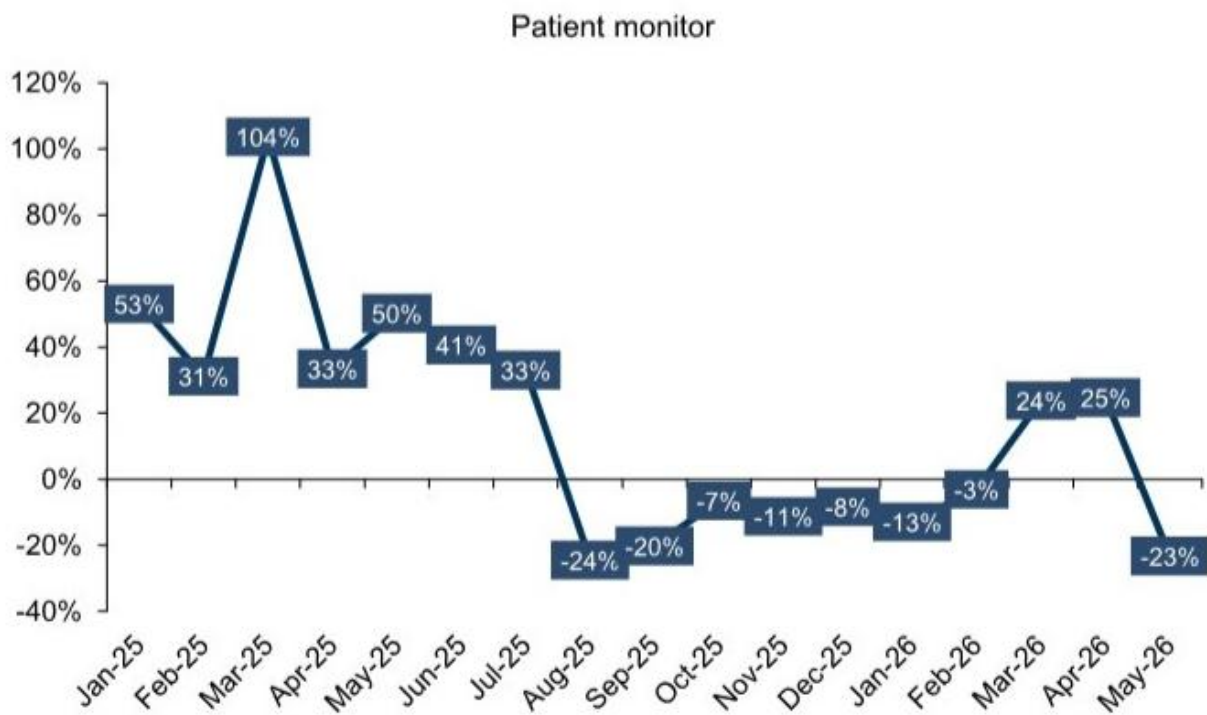

图表 4

来源：Joinchain


图表7：2023年1月以来内窥镜采购金额

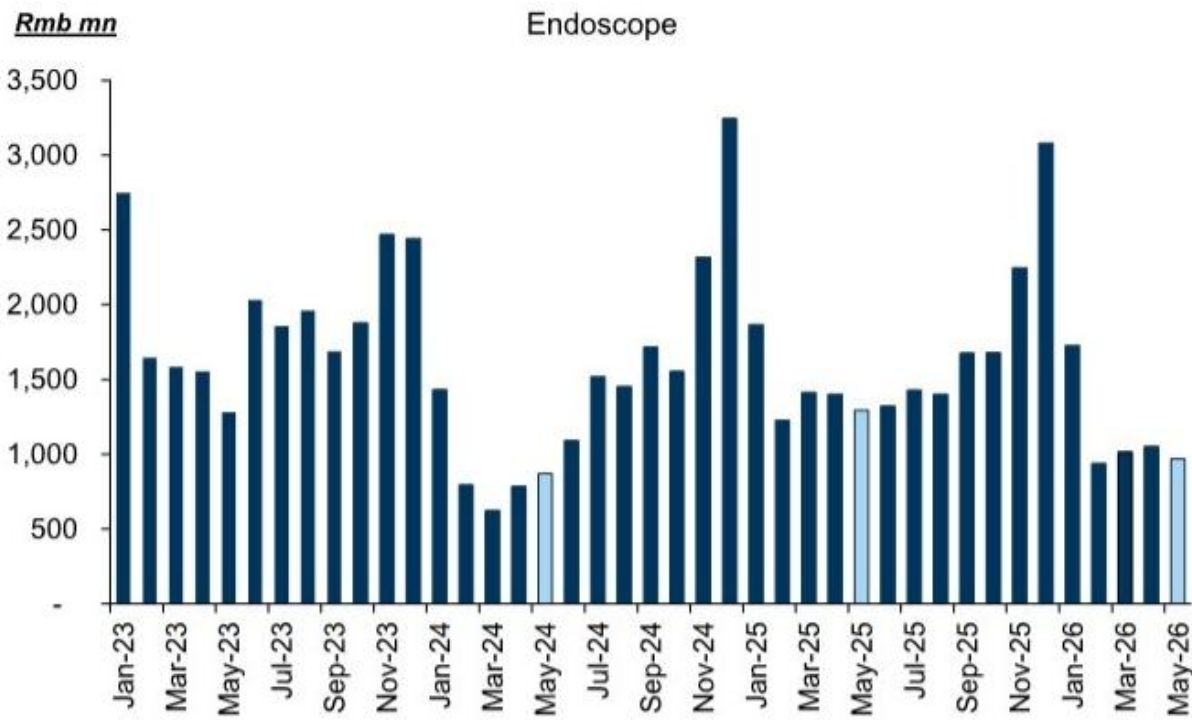

图表 5

来源：Joinchain


图表8：2026年5月内窥镜采购金额同比下降-25%，2026年4月为-25%

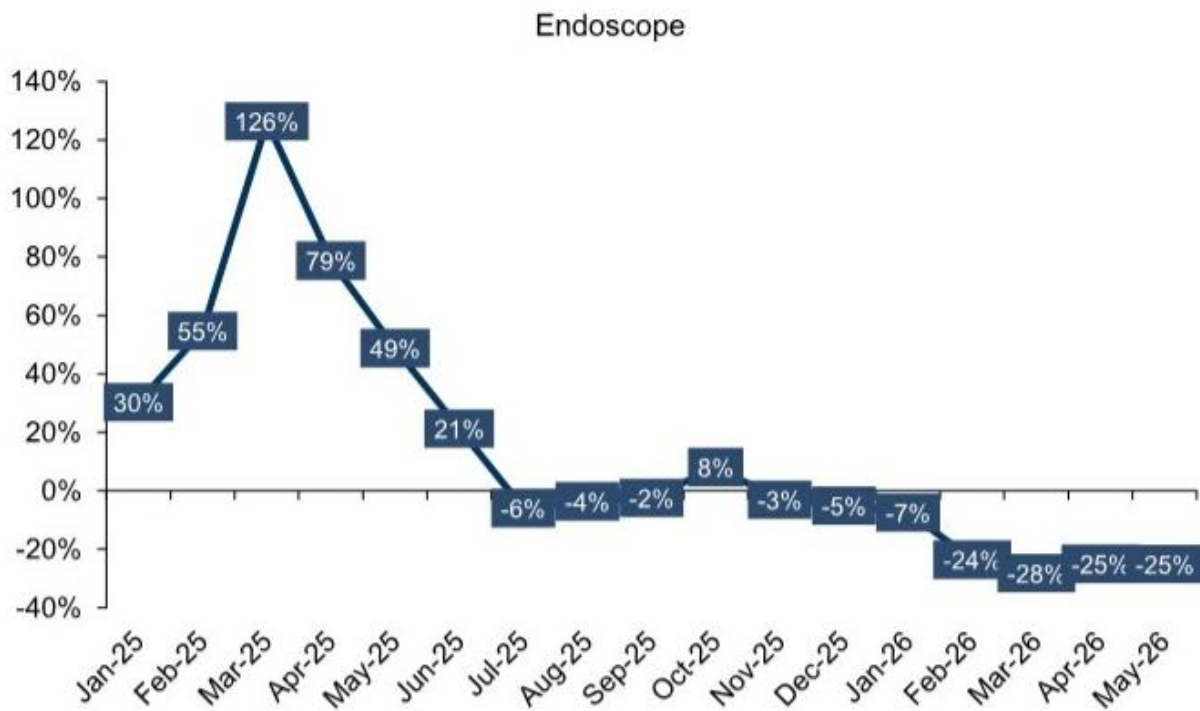

图表 6

来源：Joinchain


图表9：2023年1月以来超声采购金额

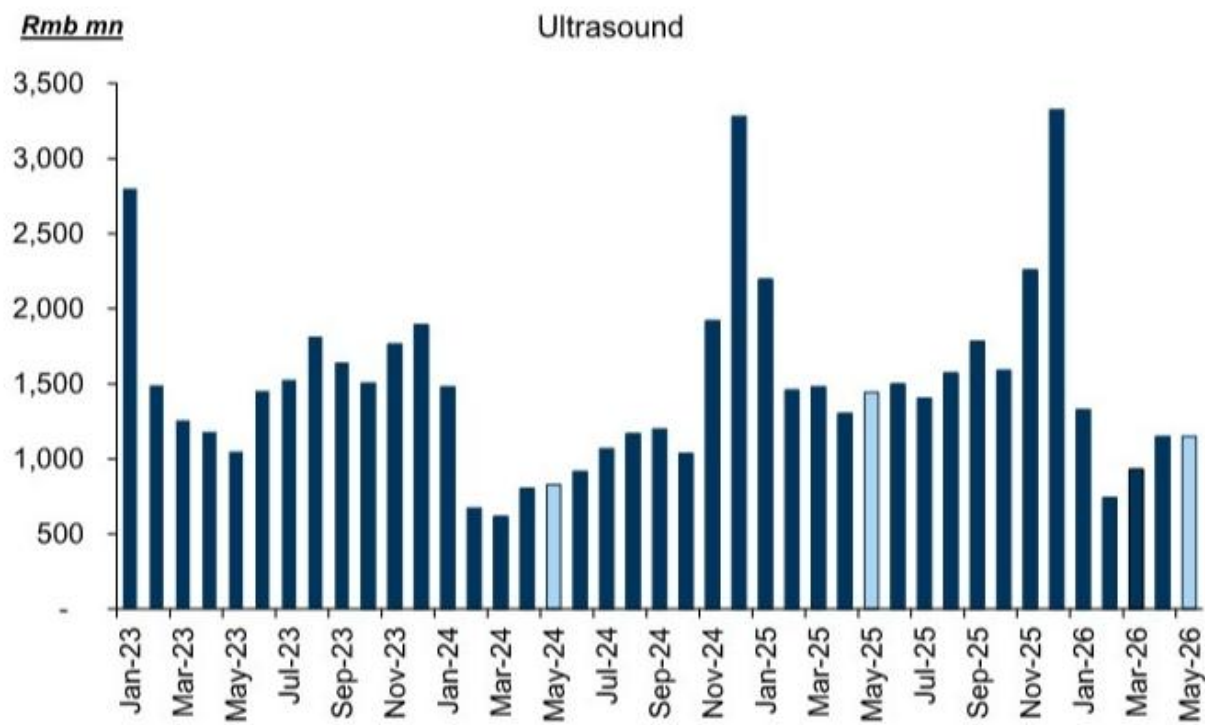

图表 7

来源：Joinchain


图表10：2026年5月超声采购金额同比下降\$-20\%\$, 2026年4月为\$-12\%\$

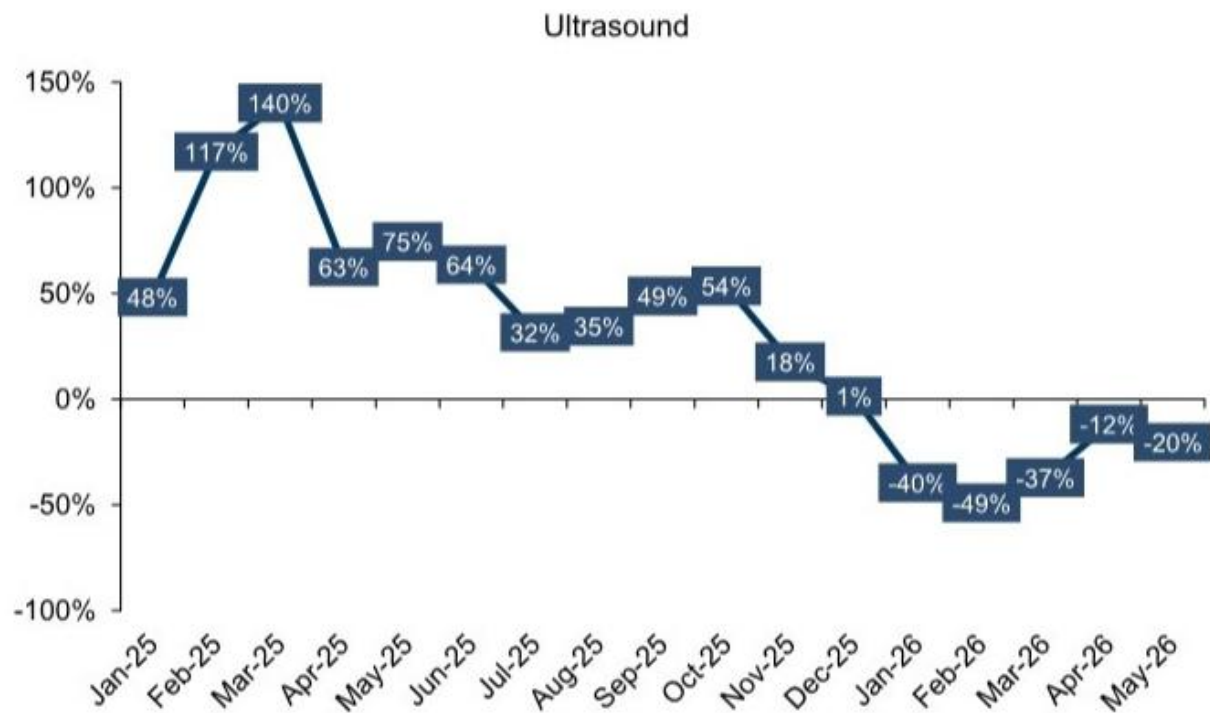

图表 8

来源：Joinchain


图表11：2023年1月以来CT扫描仪采购金额

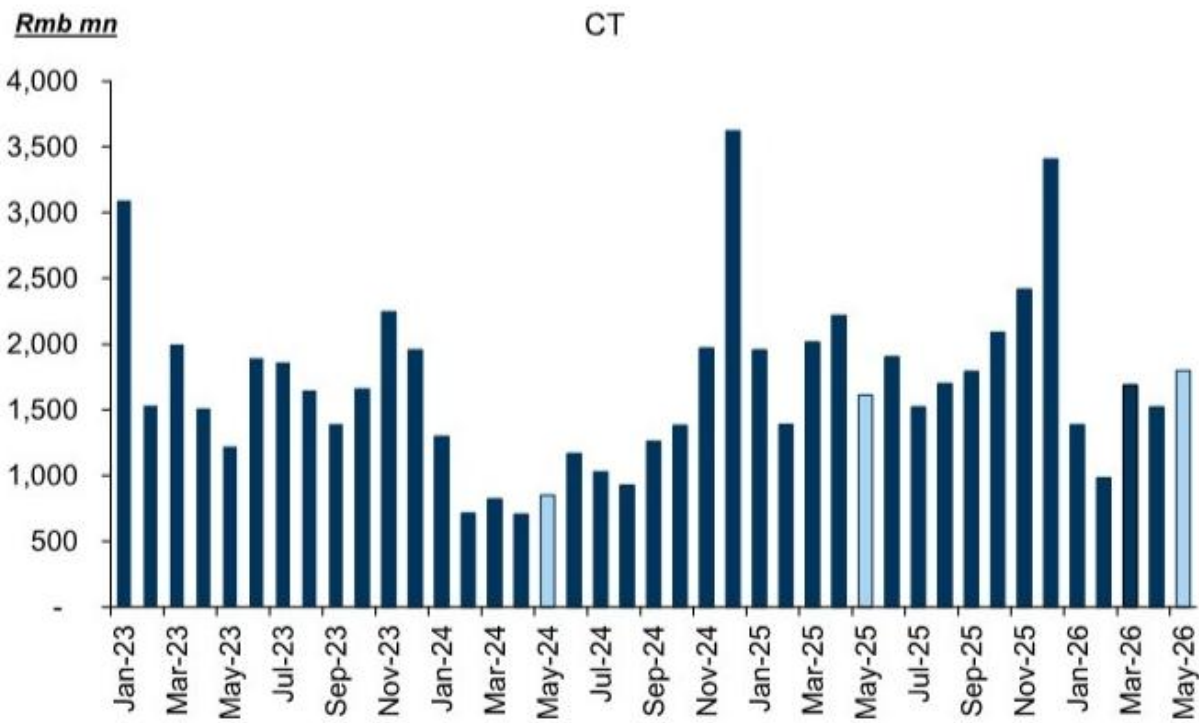

图表 9

来源：Joinchain


图表12：2026年5月CT扫描仪采购金额同比增长+12%，2026年4月为-31%

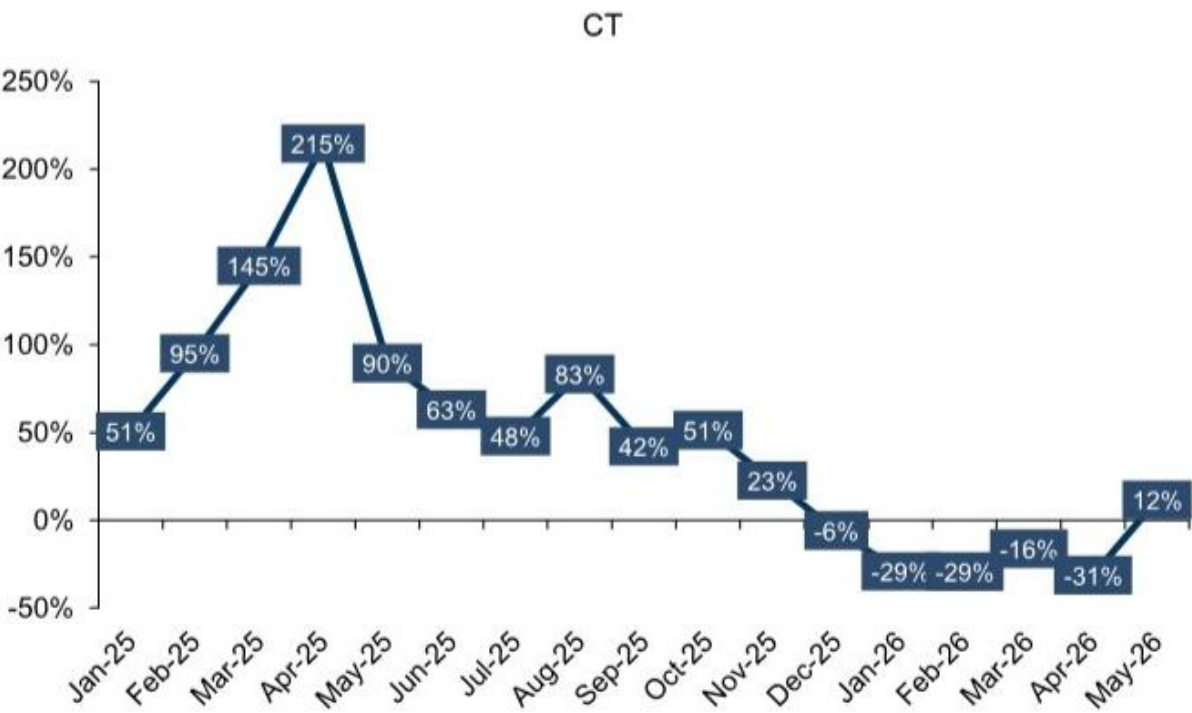

图表 10

来源：Joinchain


图表13：2023年1月以来MRI采购金额

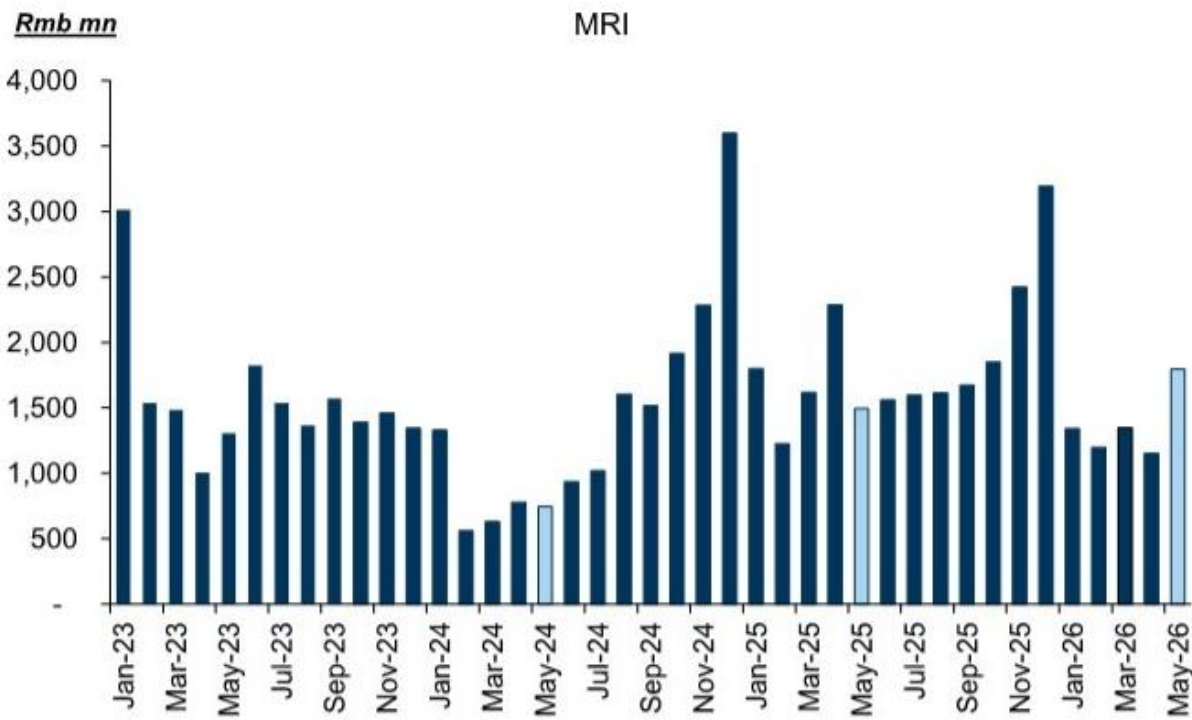

图表 11

来源：Joinchain


图表14：2026年5月MRI采购金额同比增长 $+20\%$ ，2026年4月为 -50%

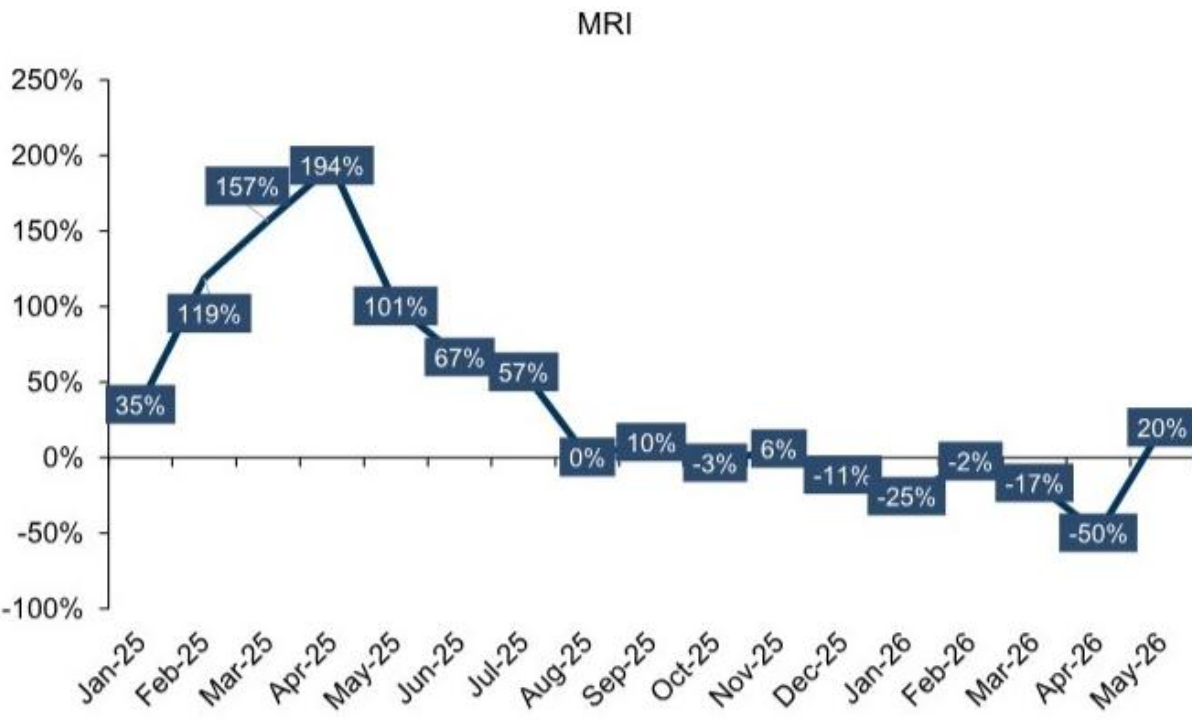

图表 12

来源：Joinchain


图表15：2023年1月以来PET-CT采购金额

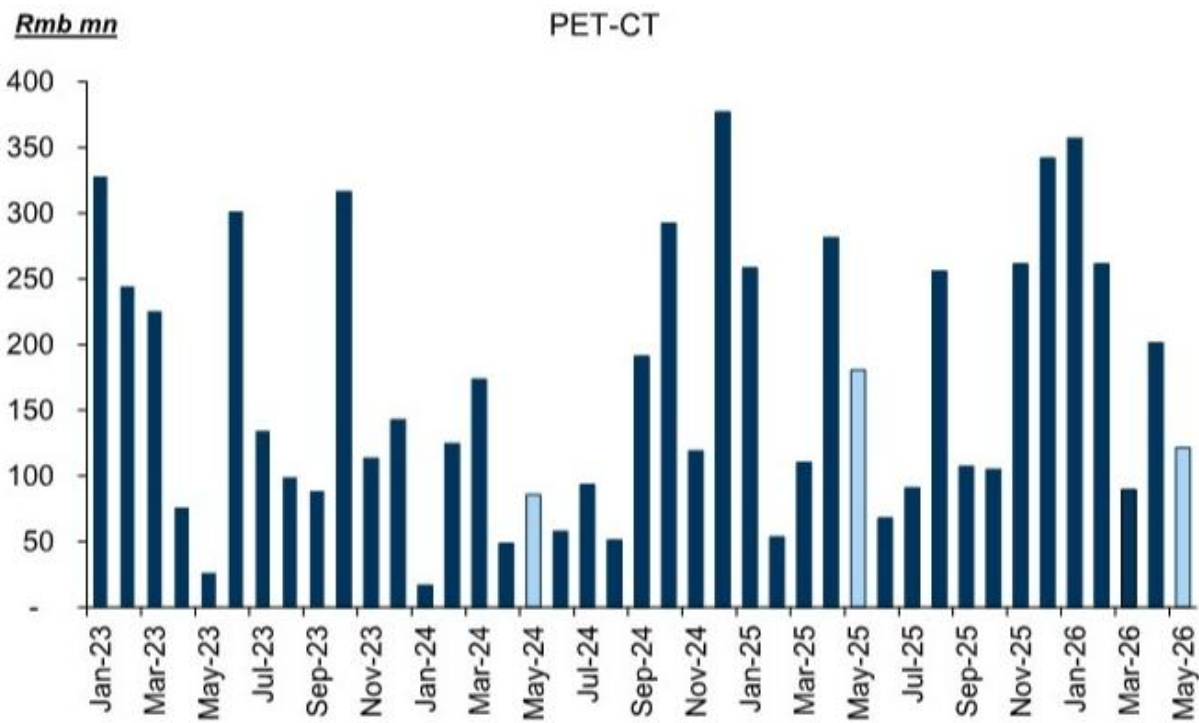

图表 13

来源：Joinchain


图表16：2026年5月PET-CT采购金额同比下降\$-33\%\$, 2026年4月为\$-28\%\$

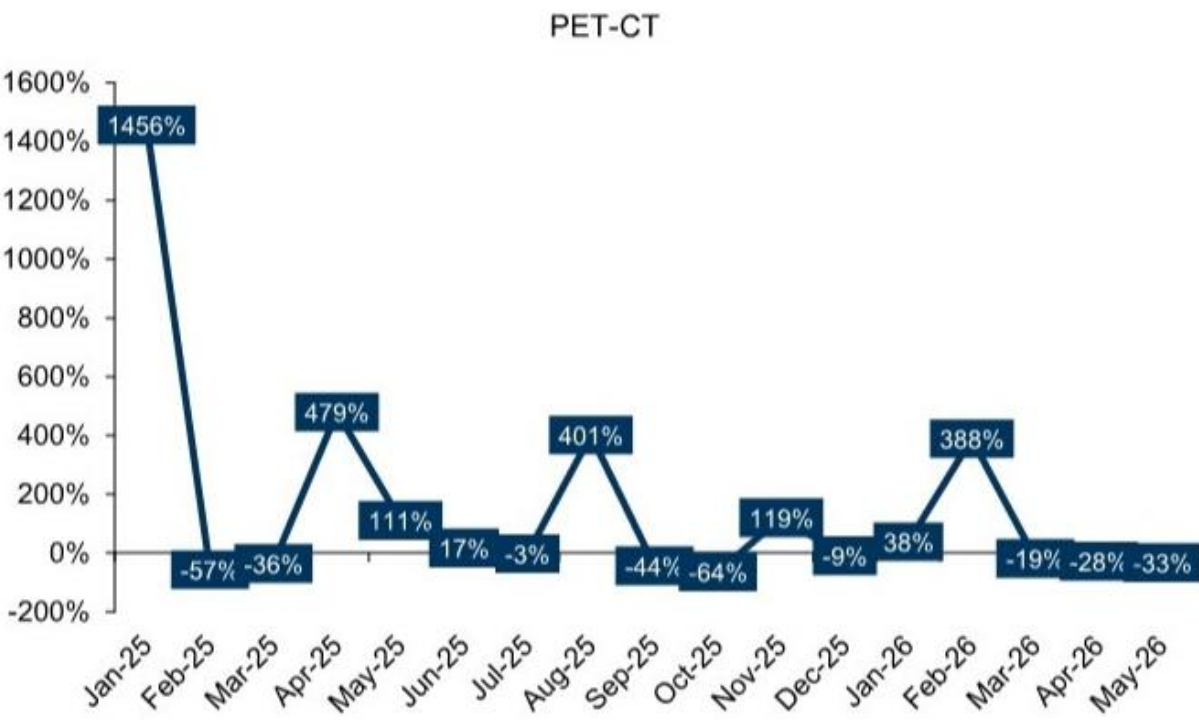

图表 14

来源：Joinchain


图表17：2023年1月以来DR采购金额

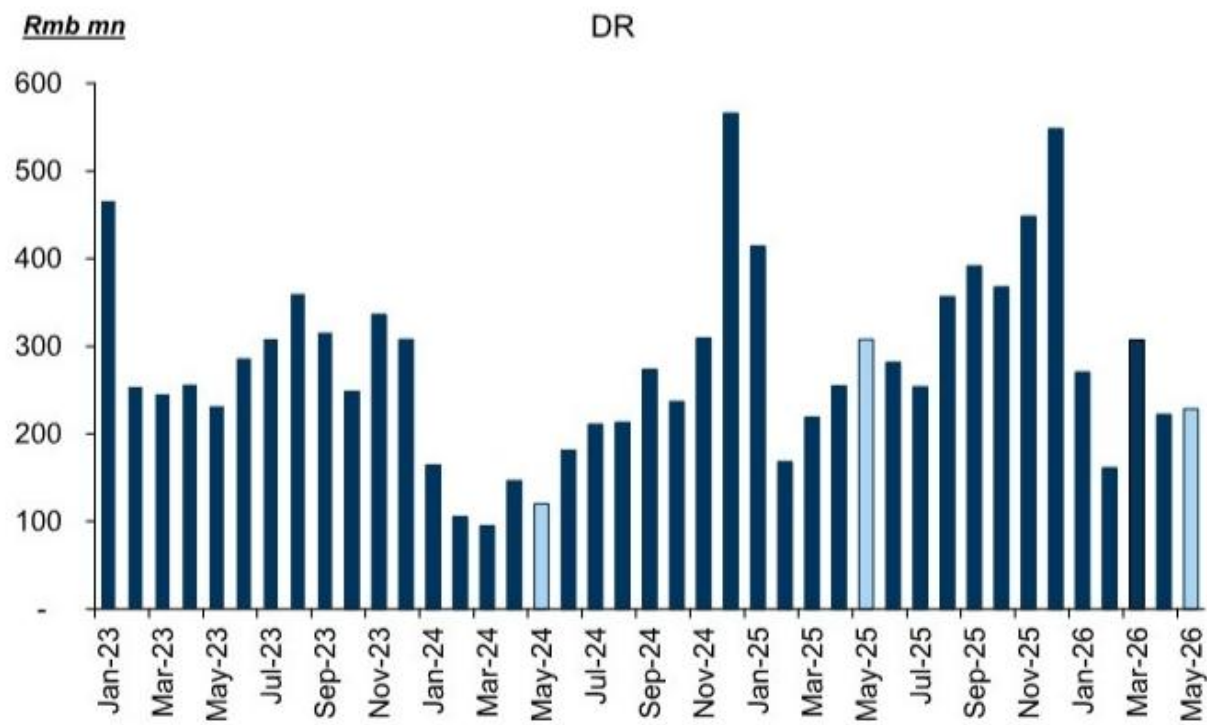

图表 15

来源：Joinchain


图表18：2026年5月DR采购金额同比下降\$-26\%\$, 2026年4月为\$-13\%\$

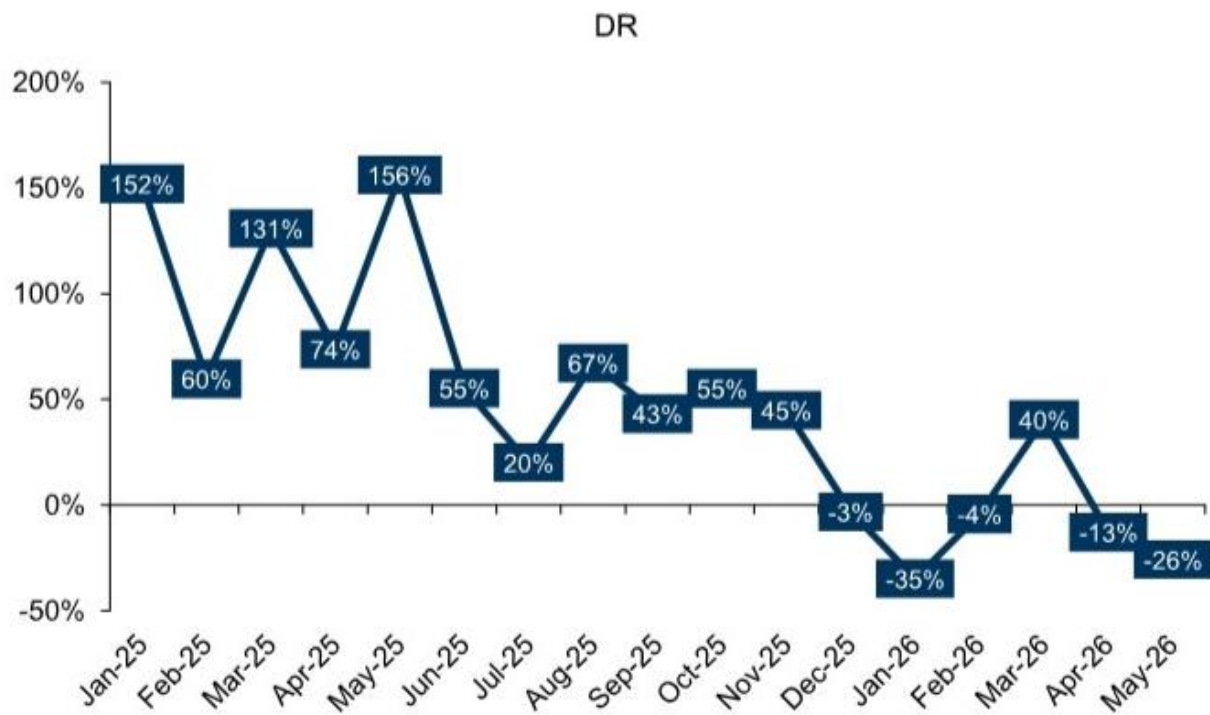

图表 16

来源：Joinchain


图表19：2023年1月以来直线加速器采购金额

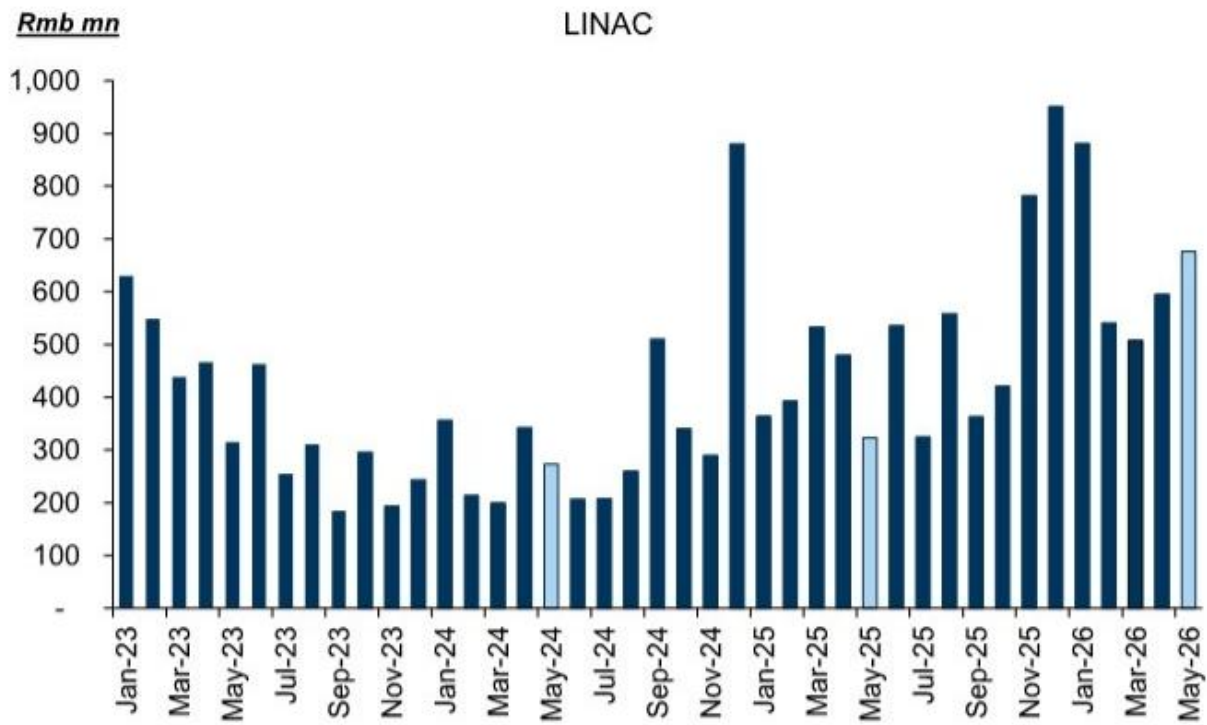

图表 17

来源：Joinchain


图表20：2026年5月直线加速器采购金额同比增长+109%，2026年4月为+24%

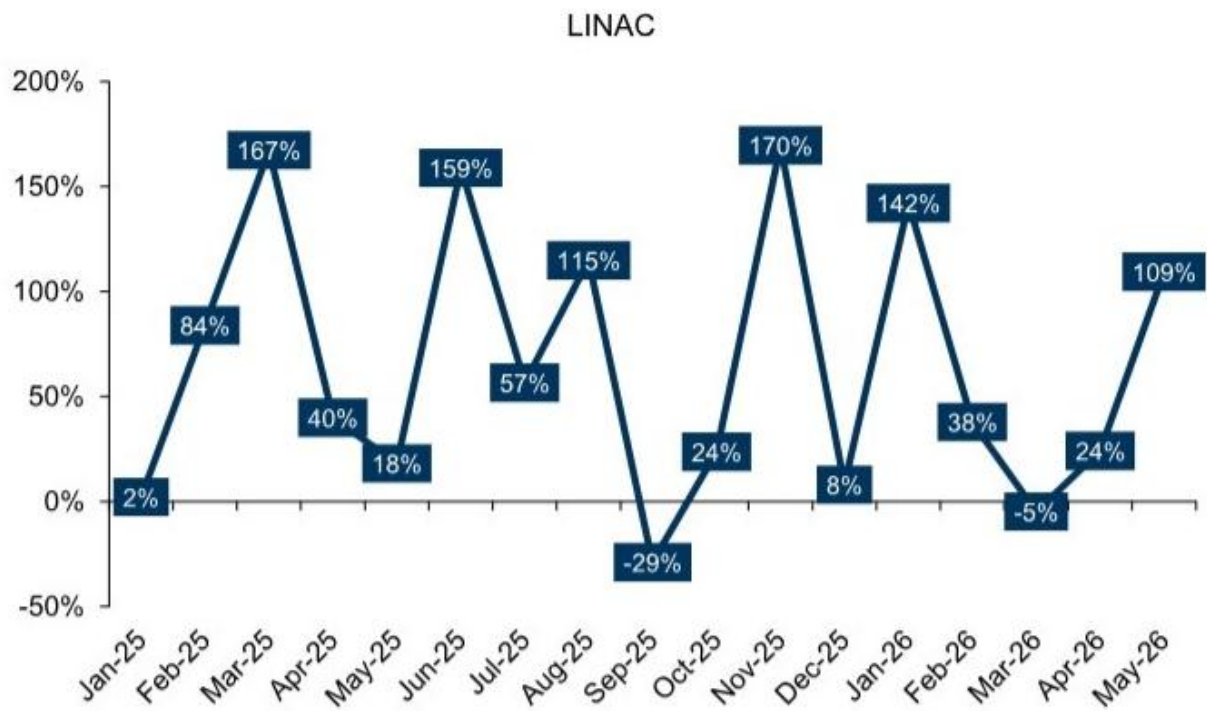

图表 18

来源：Joinchain


图表21：2023年1月以来DSA（IGT）采购金额

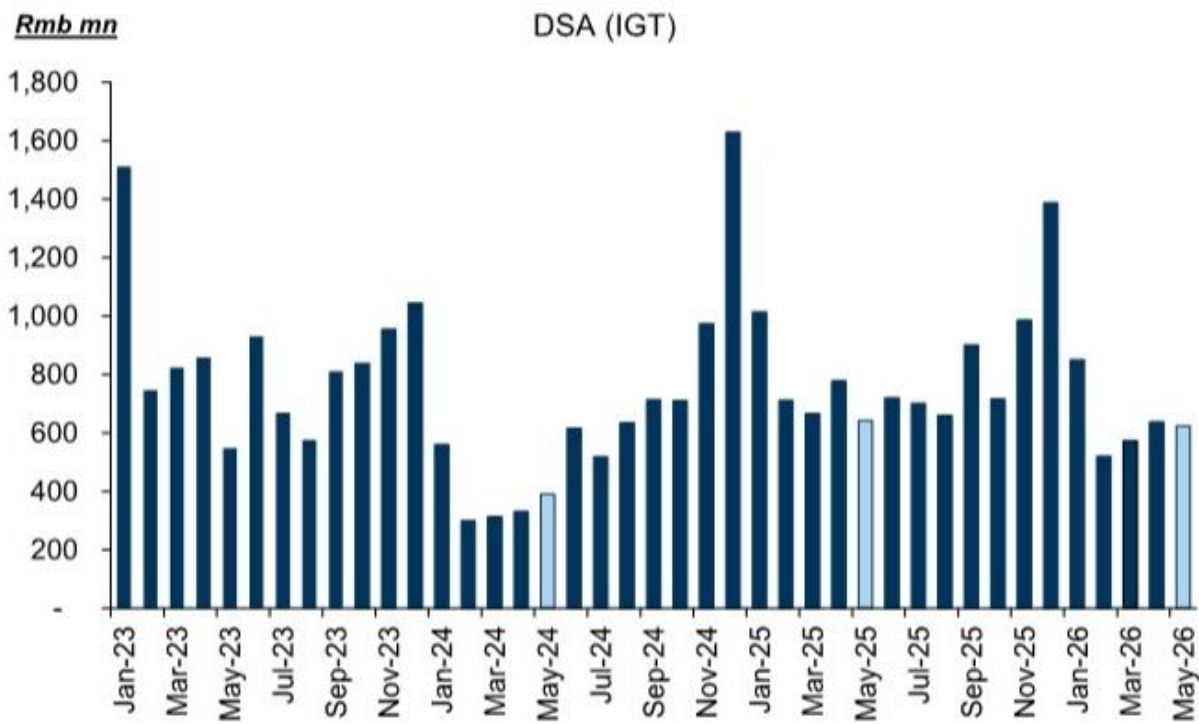

图表 19

来源：Joinchain

图表22：2026年5月DSA（IGT）采购金额同比下降-3%，2026年4月为-18%

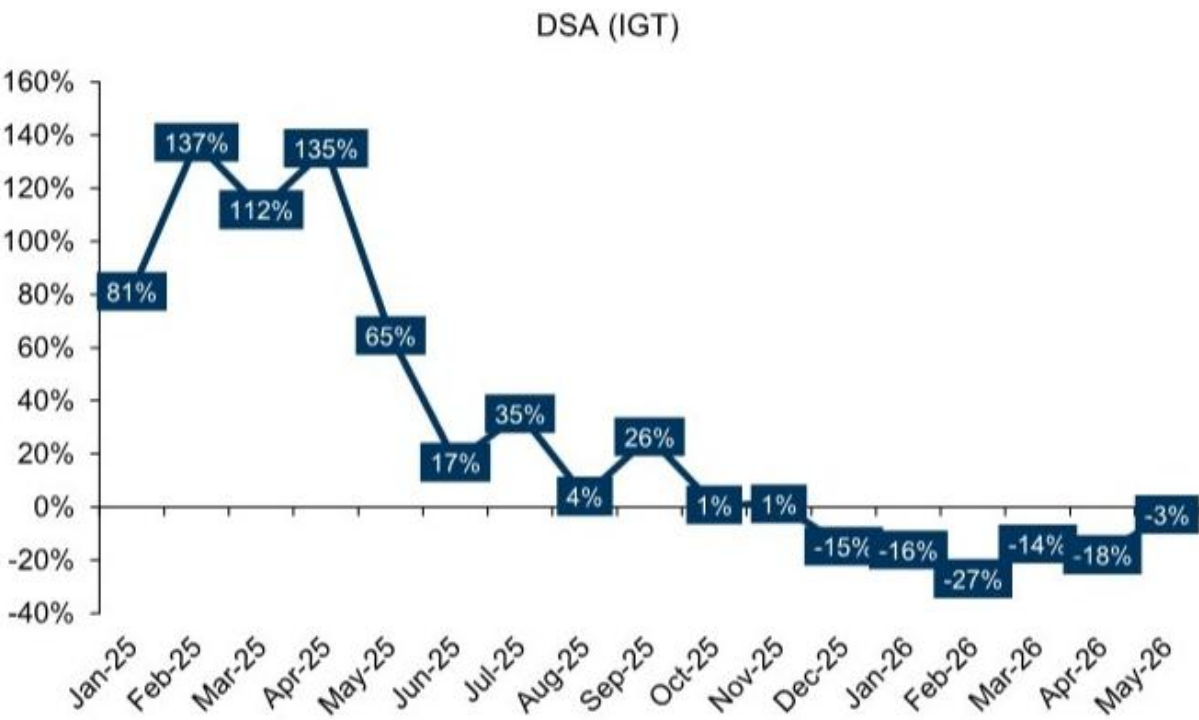


图表 20

来源：Joinchain

按品牌划分的招标金额：国产 vs. 跨国企业


图表23：2023年1月以来联影医疗总招标金额（单位：百万元人民币）

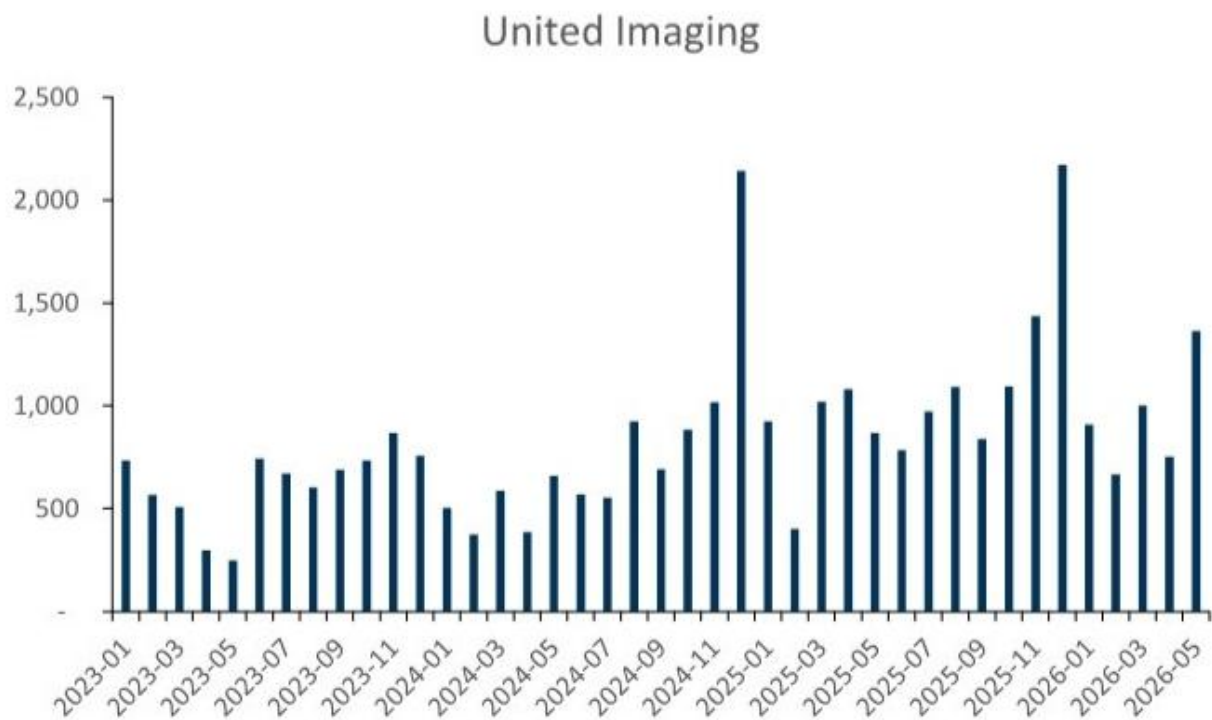

图表 21

来源：Joinchain


图表24：2023年1月以来GEHC总招标金额（单位：百万元人民币）

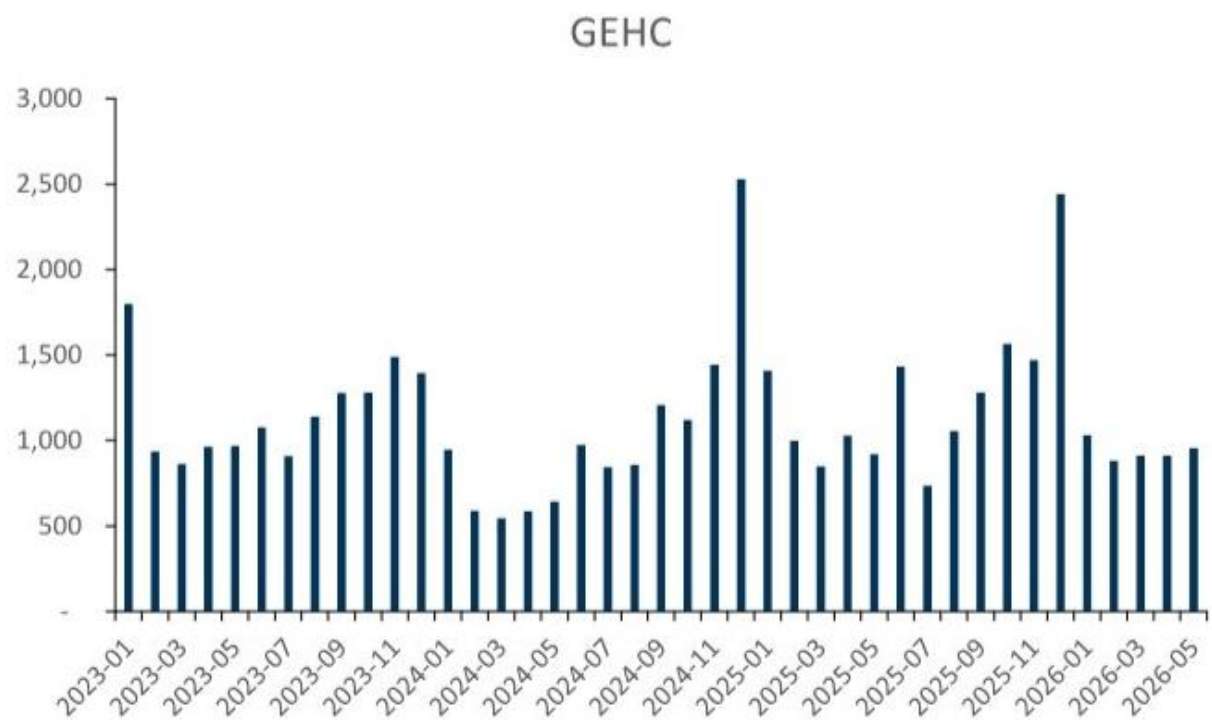

图表 22

来源：Joinchain


图表25：2023年1月以来飞利浦总招标金额（单位：百万元人民币）

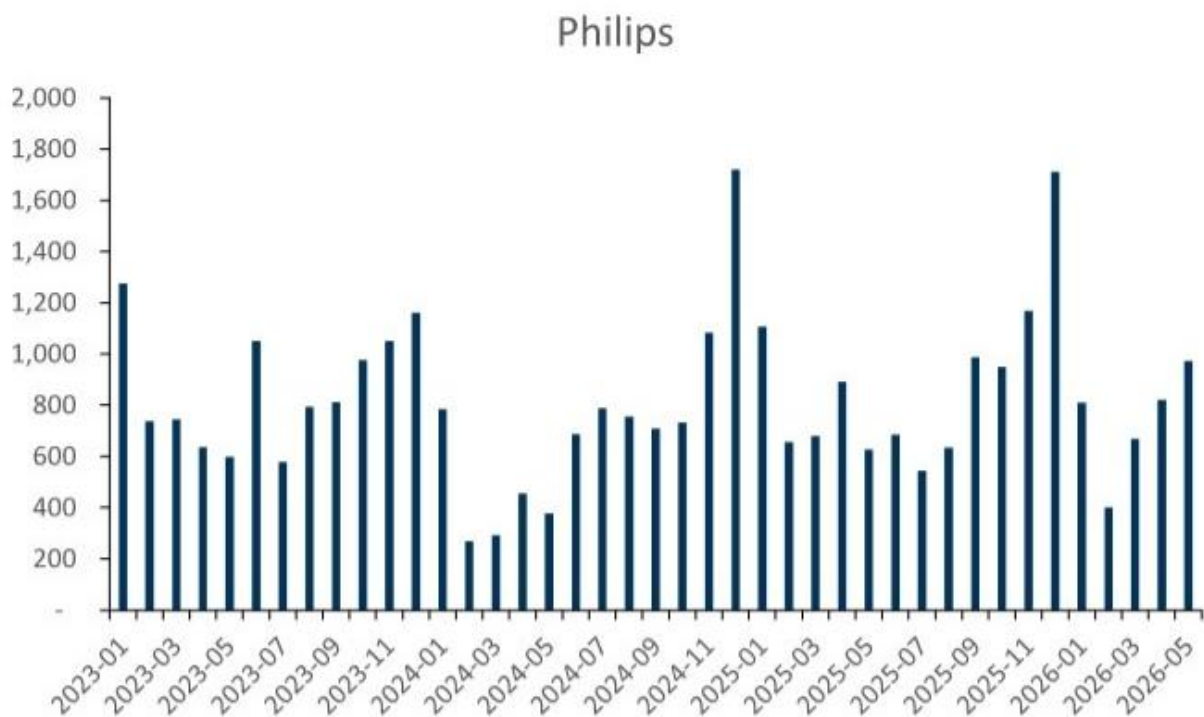

图表 23

来源：Joinchain


图表26：2023年1月以来西门子总招标金额（单位：百万元人民币）

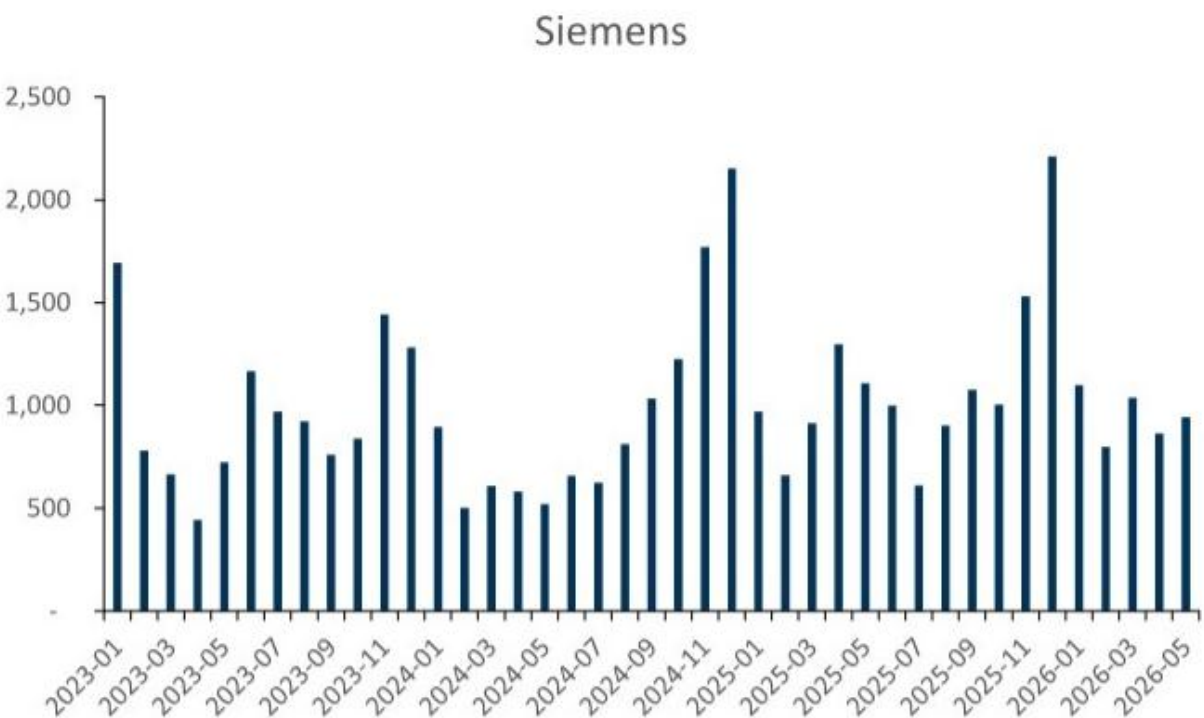

图表 24

来源：Joinchain


图表27：2023年1月以来医科达总招标金额（单位：百万元人民币）

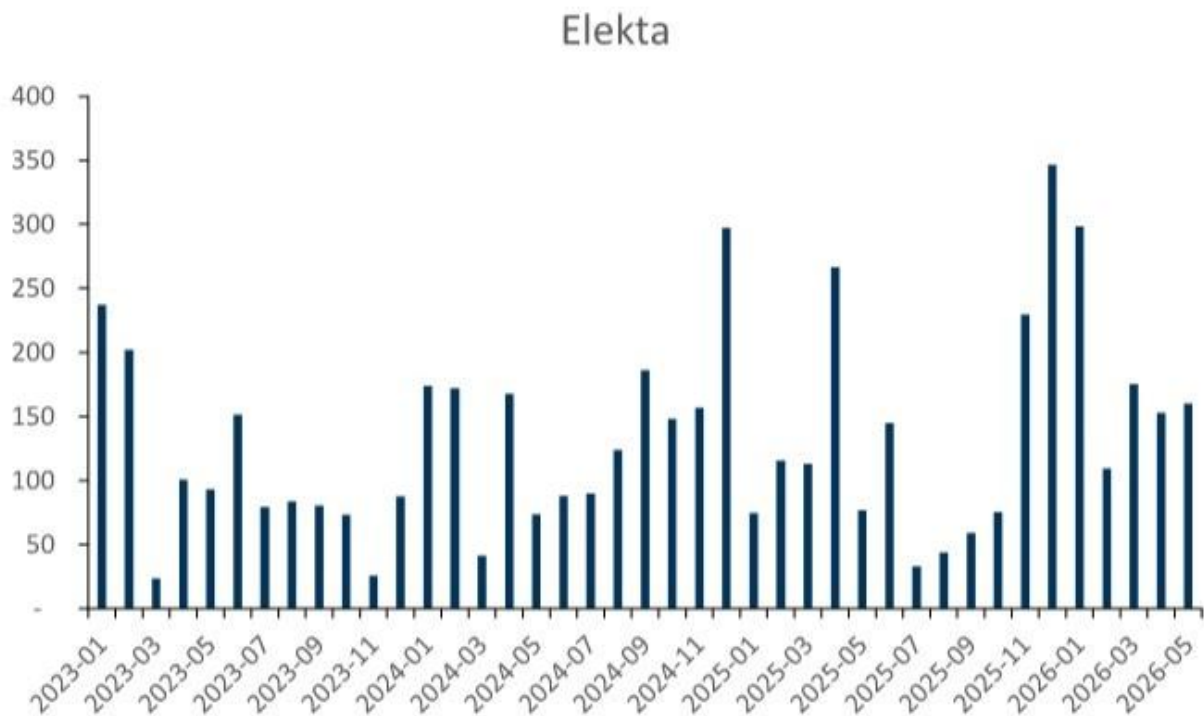

图表 25

来源：Joinchain


图表28：2023年1月以来迈瑞医疗总招标金额（单位：百万元人民币）

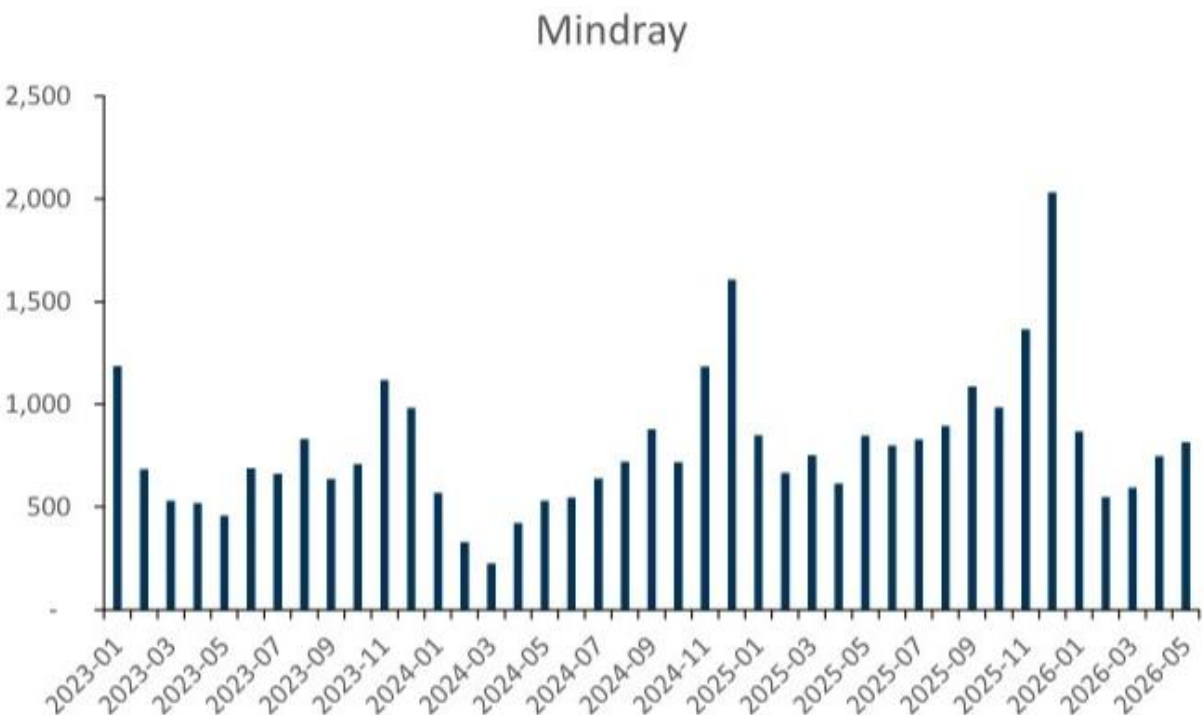

图表 26

来源：Joinchain


图表29：2023年1月以来开立医疗总招标金额（单位：百万元人民币）

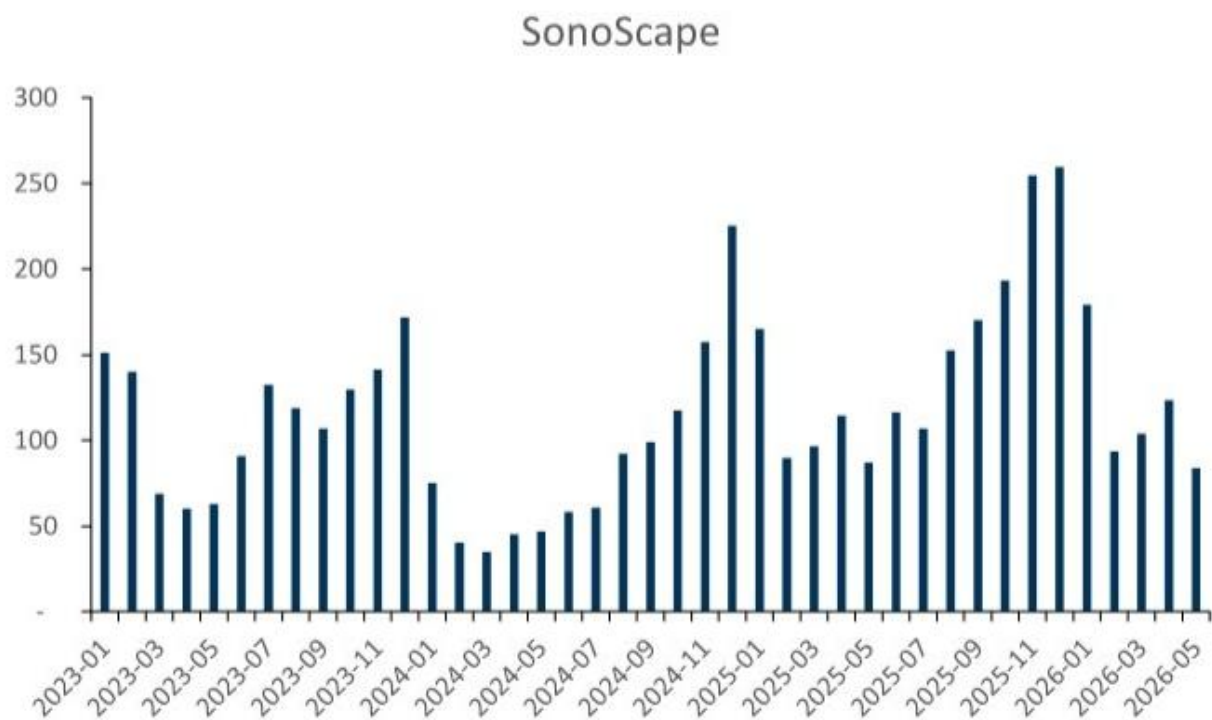

图表 27

来源：Joinchain

图表30：2023年1月以来奥林巴斯总招标金额（单位：百万元人民币）

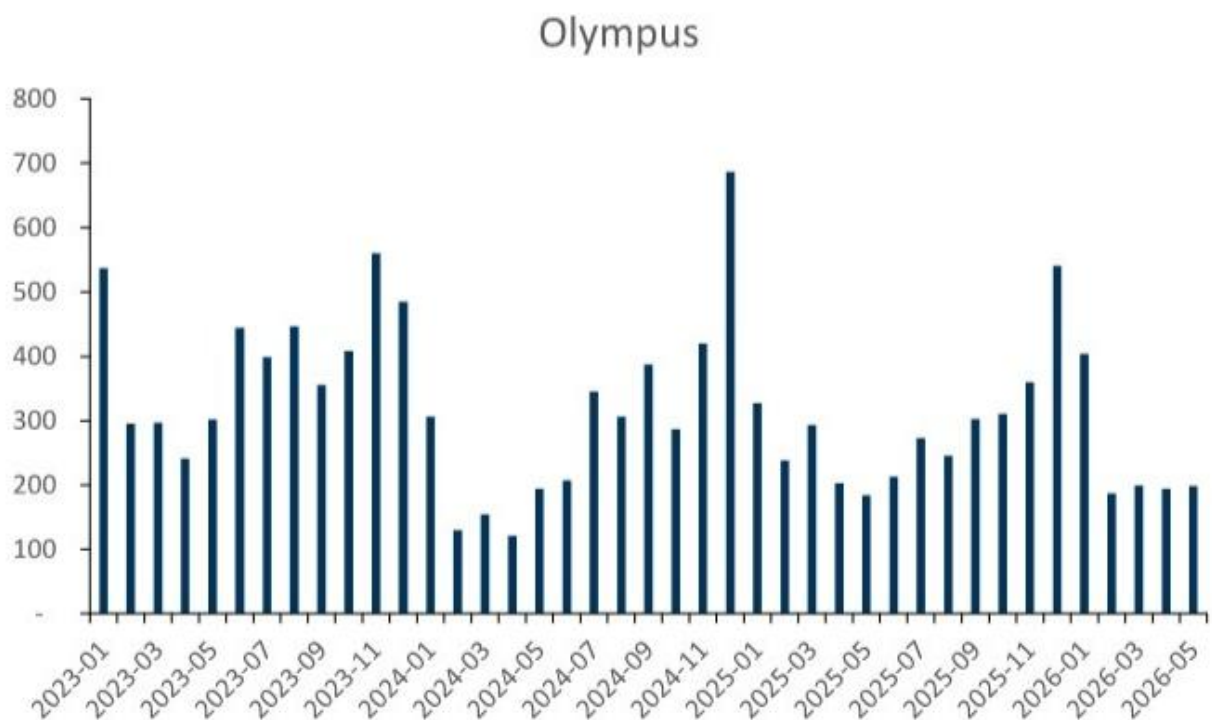

图表 28

来源：Joinchain

图表31：2023年1月以来澳华内镜总招标金额（单位：百万元人民币）

来源：Joinchain

投资论点：迈瑞医疗

迈瑞医疗是中国领先的医疗科技设备制造商，专注于患者监护系统、医学影像和IVD等多个领域。其2024年营收的55%来自中国。我们看好中国强劲的医疗基础设施建设及国产替代趋势。此外，鉴于迈瑞医疗相对较低的市场份额和具有成本效益的产品组合，我们预计海外营收将增长。由于政策风险，该公司的交易价格低于其五年平均远期市盈率。我们预计迈瑞医疗将凭借多重增长动力保持其市场领导地位。我们对迈瑞医疗给予买入评级。关键催化剂包括采购活动复苏、医疗设备以旧换新计划的进展以及新产品的推出。

联影医疗

联影医疗是中国大型医学影像设备领域的领先制造商，业务已拓展至全球超过100个国家。我们观察到，中国医疗设备采购已出现回暖，政府资金支持力度加大，同时公司市场份额持续增长。我们认为，随着这一趋势推进，服务收入占比将提升，带动公司毛利率改善。当前公司股价交易于上市以来市盈率中位数附近，但考虑到其营收、毛利率及净利率的预期增长，我们看好其长期增长潜力。因此，我们给予买入评级。关键催化剂包括未来中国月度医院采购数据以及其超声产品线的推出。

目标价风险与方法论 迈瑞医疗

我们基于两阶段DCF估值法给出12个月目标价247元人民币，假设永续增长率2%，加权平均资本成本9.5%（两者均未调整）。主要下行风险：1) 带量采购对部分产品出厂价的进一步冲击；2) 在中国顶级医院渗透进度低于预期；3) 进入北美和欧洲市场存在困难；4) 专利相关诉讼风险；5) 贸易政策意外变化。

联影医疗

我们基于两阶段DCF估值法给出12个月目标价172元人民币，假设：1) 折现率9%；2) 永续增长率2%。主要风险：1) 芯片供应链风险；2) 原材料风险，尤其是氦气；3) 中国宏观经济下行；4) 潜在的带量采购风险。

迈瑞医疗

来源：公司数据、GS预测、FactSet。股价截至2026年6月9日收盘。

来源：公司数据、GS预测、FactSet。股价截至2026年6月9日收盘。