

KC桌面——外资精译

Bernstein：Illumina2Q26业绩与临床浪潮

Illumina于周四收盘后公布了2Q26业绩。营收11.59亿美元，较市场一致预期的11.10亿美元高出4%；每股收益1.31美元，较一致预期的1.23美元高出7%。公司上调了FY26营收指引至46.0亿-46.4亿美元（此前为45.2亿-46.2亿美元），除中国外地区有机增长上调至5%以上（此前为2%-4%），每股收益中点上调约13美分。

NovaSeq X的装机量无疑是本季度最突出的亮点；超过95台的装机量较Q1的83台实现了不错的环比提升。值得注意的是，这些装机中有70%流向了临床客户（尽管在这种融资环境下，我们原本也不会预期太多装机进入科研领域）。不难想象，其中许多采购来自诊断公司，他们预计将大幅扩展现有检测项目（例如Guardant扩展Shield和Reveal）。但同样可以想象，其中一些流向了临床研发——这或许表明客户在花时间考量其他主要新进入者的定价和性能之后，正在重新承诺投入Illumina。

临床耗材的“悬崖”已变成了……一道可供冲浪的“浪潮”？此前，市场担心当临床客户从6000平台转向X平台时，他们每样本的支出会迅速下降，但样本量不会相应增加，导致收入遭遇“悬崖”。然而，越来越多的临床转型已成为过去：Q2中X平台占高通量测序产出（Gb）的79%，占高通量耗材收入的59%。随着临床耗材增长保持强劲（除中国外地区增长15%，美国增长超过20%……尽管空头可能会挑剔Q1除中国外地区增长为20%这一点），这一不确定性持续减弱。CEO Jacob Thaysen表示：“这不是悬崖，而是一道浪潮。我们正在冲浪。”

研究影响：公司情况更新

我们对本次财报的看法比之前更加积极。然而，市场在财报前的情绪比我们更加乐观（报价过去一个月上涨16.6%，当日上涨5.3%），因此我们可能不会看到太大的市场反应（盘后下跌1%）。我们维持与大市同步评级。，基于上调盈利预测，并将估值倍数上调至当前2026年水平（EV/EBITDA从22倍上调至2027年25倍，市盈率从34倍上调至2027年40倍）。WACC 9.25%和终端增长率3%保持不变。模型：ILMN公司模型

来源：彭博、Bernstein估计与分析。

一年期价格表现



来源：彭博、Bernstein估计与分析。

详情：公司情况更新

季度业绩：公司情况更新

以下为Illumina 2Q业绩与一致预期及Bernstein预测的对比（图表1），以及与2Q指引的对比（图表2）。

图表1：ILMN季度业绩 vs. 一致预期及Bernstein预测

来源：公司报告、彭博、Bernstein分析与预测

图表2：ILMN季度业绩 vs. 指引

来源：公司报告、Bernstein分析

指引：公司情况更新

Illumina上调了FY26指引；关键指标见图表3（FY26）和图表4（3Q26），补充说明如下。

图表3：ILMN全年指引

来源：公司报告、Bernstein分析

图表4：ILMN 3Q26指引

来源：公司报告、Bernstein分析

指引补充说明

- 2H26

\- NovaSeq X装机量预计在2H26保持高位，同比增速将有所节奏变化。

\- 耗材增长预计保持稳定，季度间波动可能来自仪器装机，预计2H26装机量保持高位，但自2H25起已处于高位。

\- 3Q26预计反映常规季节性，4Q26仍将是公司全年最大的季度。

\- 4Q26的额外销售周预计将为FY26营收增长贡献约50个基点，主要通过耗材实现。

- FY26及以后

\- 临床测序耗材增长预计为中等双位数百分比，而科研与应用耗材预计在FY26下降中至高个位数百分比。

\- 近期NovaSeq X装机的超预期表现预计将为FY26耗材收入带来适度贡献，大部分收益将在FY27体现，因为临床客户通常需要至少六至九个月才能达到常态化的耗材拉动水平。

\- 继续维持FY27高个位数营收增长目标，其中新产品贡献1至2个百分点。

电话会议及回访评论

测序业绩：公司情况更新

\- 装机超过95台NovaSeq X仪器，受到大型临床客户多项多台扩容订单的支撑，包括与新临床试验相关的订单。在回访中，管理层表示未看到仪器订单的提前采购。

- 约70%的NovaSeq X装机为临床客户，30%为科研客户。

\- 在回访中，管理层指出，由于转型已基本完成，大多数X平台科研装机为增量需求（而非从6000升级）。约50%的临床装机为增量需求（而非从6000升级），报销、新试验和产能扩张是需求驱动因素。

- \- 装机超过10台NovaSeq 6000，部分客户预计将在该平台上继续使用多年。现有的已上市临床检测在替换过程中更可能留在NovaSeq 6000上，而新检测更可能在NovaSeq X上启动。
- \- 测序耗材同比增长5%，主要受高通量测序量驱动，因NovaSeq X装机基数扩大且拉动率提升。
- \- 临床耗材除中国外地区增长15%，其中美国-加拿大增长超过20%，约占测序耗材收入的65%。中东和拉丁美洲的疲软导致2Q除中国外地区增速从Q1的20%仍在调整至15%。
- \- 科研与应用耗材除中国外地区同比下降7%，但环比改善9%。管理层表示，判断终端市场复苏仍为时过早。
- \- NovaSeq X约占高通量测序量的83%和高通量耗材收入的59%，平台上临床测序量约占78%。临床测序量转化率预计到2026年底达到80%至85%。
- \- 肿瘤学仍是领先的临床应用。治疗选择在金额上仍更大，而MRD开始带来增长动能；罕见病、筛查和NIPT也持续增长。
- \- 低通量需求保持强劲，受MiSeq i100支撑，而中通量需求仍较为平淡，因其对宏观环境较为敏感。

其他评论：公司情况更新

- \- 科研客户在融资不确定性下仍保持谨慎。美国资金拨付和报价活动在2Q26末有所改善，但判断复苏仍为时过早。
- \- 定价更加自律，多包装和多盒耗材订单折扣有限，但未出现全面降价。战略性领域和大批量机会仍可提供研究性装机。
 - Billion Cell Atlas开始产生收入，已交付超过3亿个细胞，并拥有六家生物制药合作伙伴，支持AI驱动的药物发现和预测性生物学模型。
 - 内存和货运成本上升影响了2Q26业绩，但Illumina已确保未来几个季度的关键组件供应，并正在通过定价和运营效率应对通胀不确定性。
 - 以每股129.07美元的平均价格回购了90万股，总金额为1.22亿美元。截至2Q26末，现有公司回购授权下剩余约18亿美元，并计划继续择机回购公司。
 - 产生了1.62亿美元的自由现金流；经营现金流受到税款支付时点和为保障关键组件而进行库存采购的影响。


模型更新：公司情况更新

图表5：ILMN模型更新

资料来源：公司报告，Bernstein分析及预测


历史数据：公司情况更新

图表6：Illumina核心收入

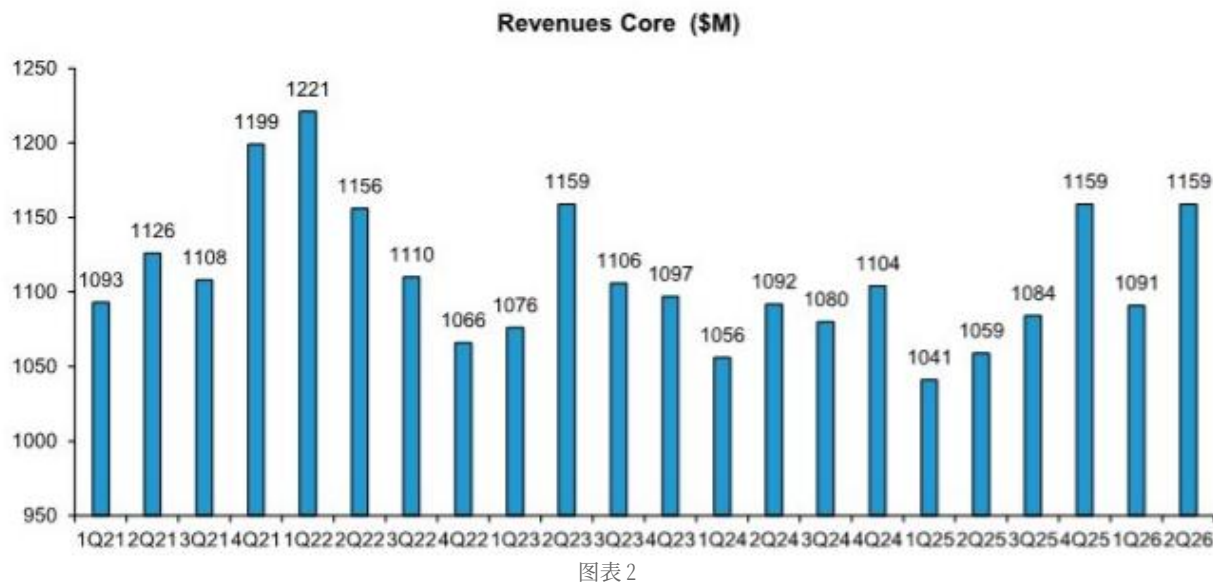

资料来源：公司报告，Bernstein分析

图表7：Illumina耗材与仪器收入

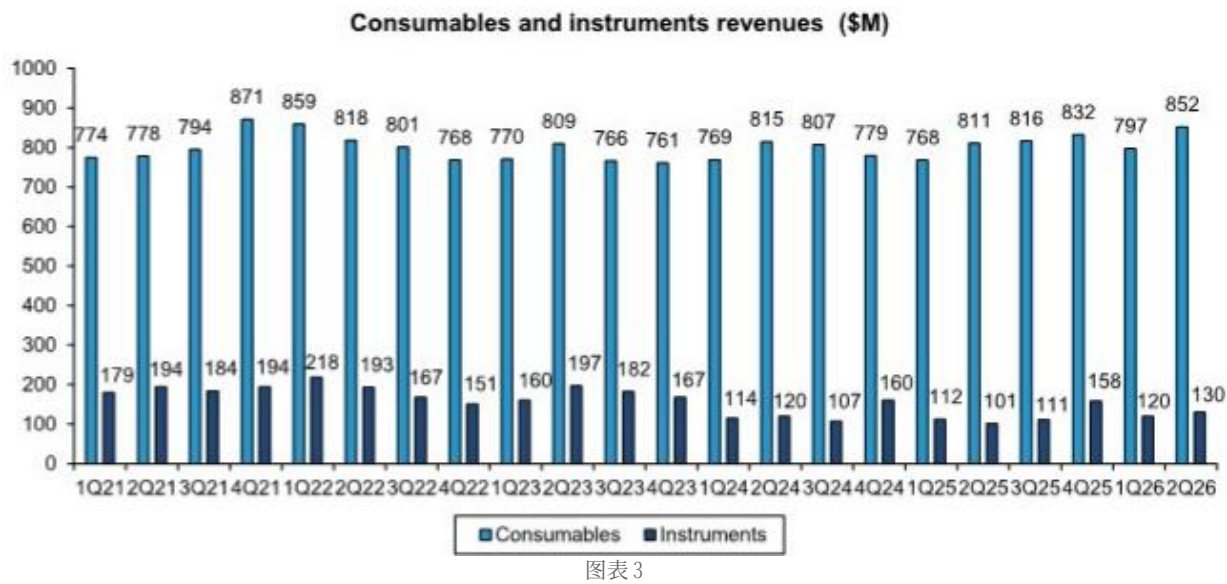

资料来源：公司报告，Bernstein分析


图表8：Illumina核心营业利润率



图表 4

资料来源：公司报告，Bernstein分析

图表9：NovaSeq X出货量

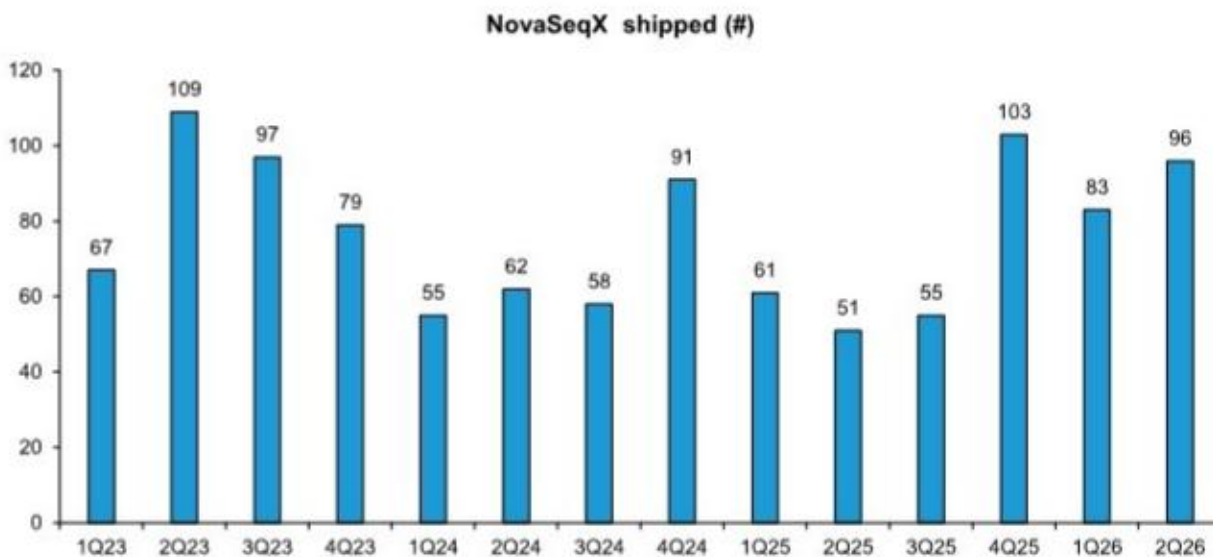

图表 5

我们根据Illumina报告的2Q26“超过95台”装机量，估算2Q26 NovaSeq X装机量为96台。资料来源：公司报告，Bernstein分析

附录 - 财务预测

图表10：ILMN收入及利润表

资料来源：公司报告，Bernstein分析及预测

图表11：ILMN资产负债表及现金流量表

资料来源：公司报告，Bernstein分析及预测

BERNSTEIN公司代码表

公司情况更新

O - 跑赢大盘，M - 与大盘持平，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖
资料来源：Bloomberg, Bernstein预测及分析