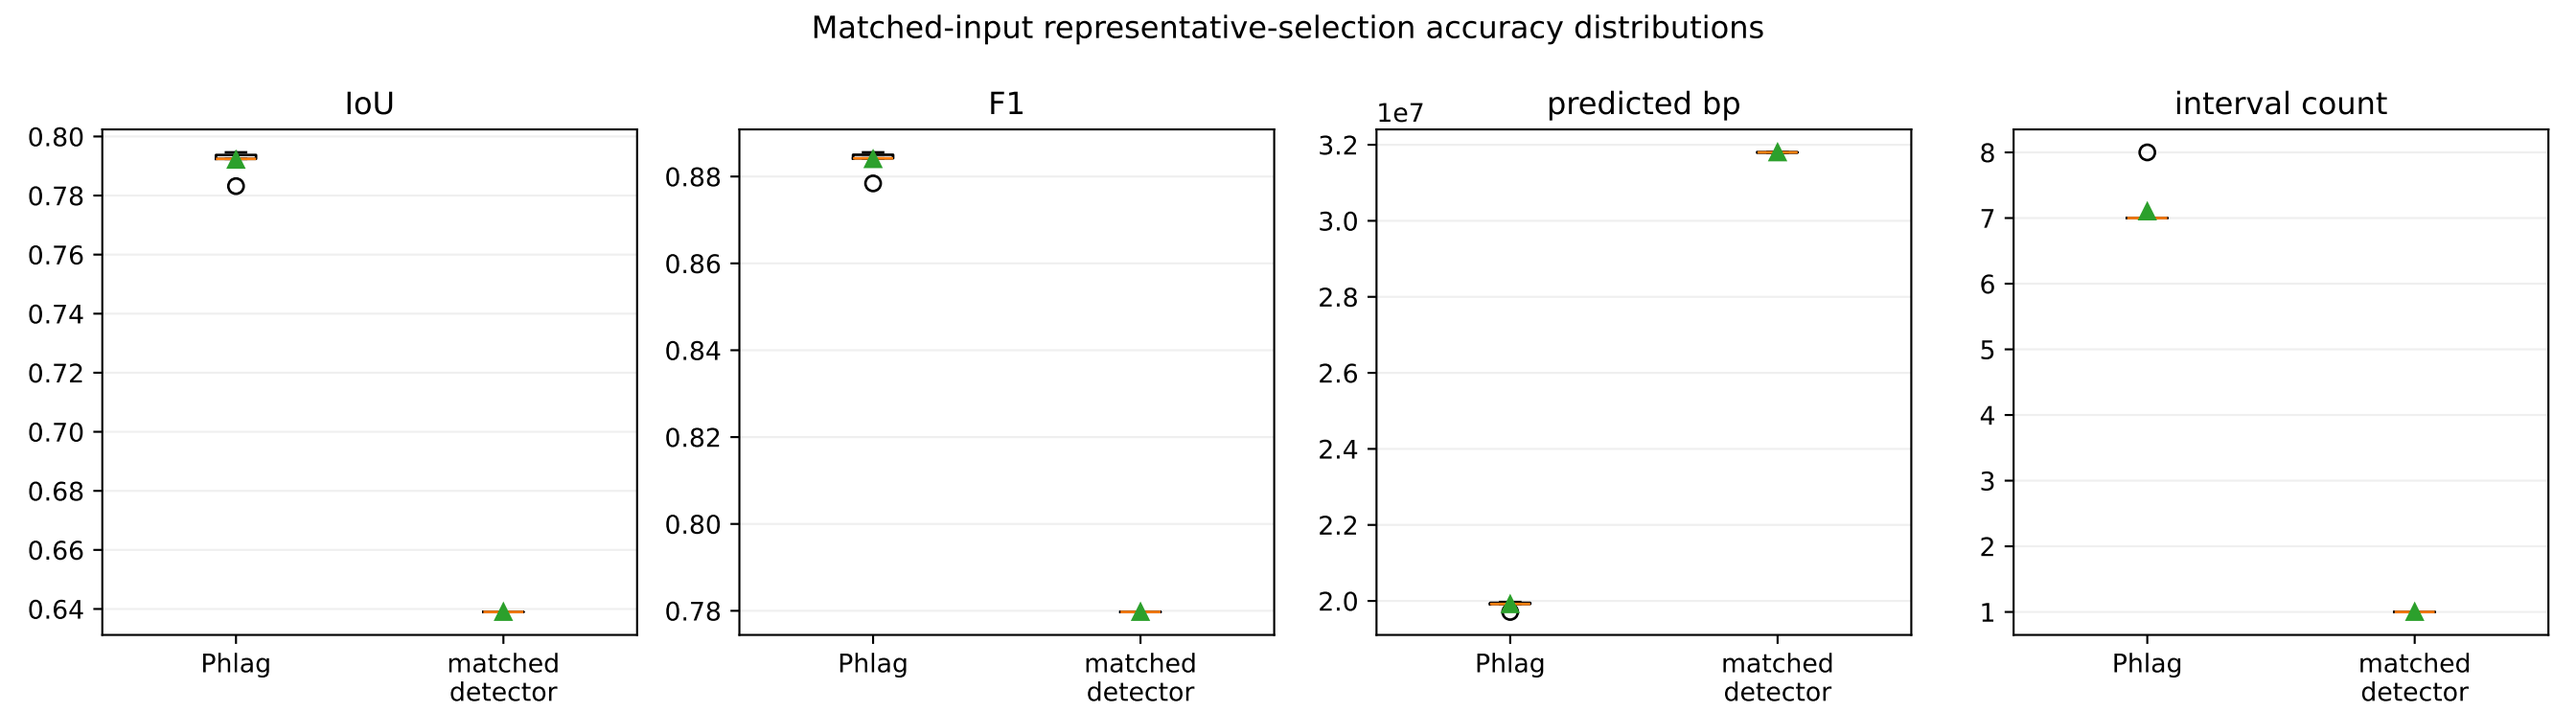
Matched-input representative-selection accuracy distributions
IoU
F1
predicted bp
interval count
1e7
0.80
0.78
0.76
0.74
0.72
0.70
0.68
0.66
0.64
0.88
0.86
0.84
0.82
0.80
0.78
3.2
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
8
7
6
5
4
3
2
1
Phlag
matched detector