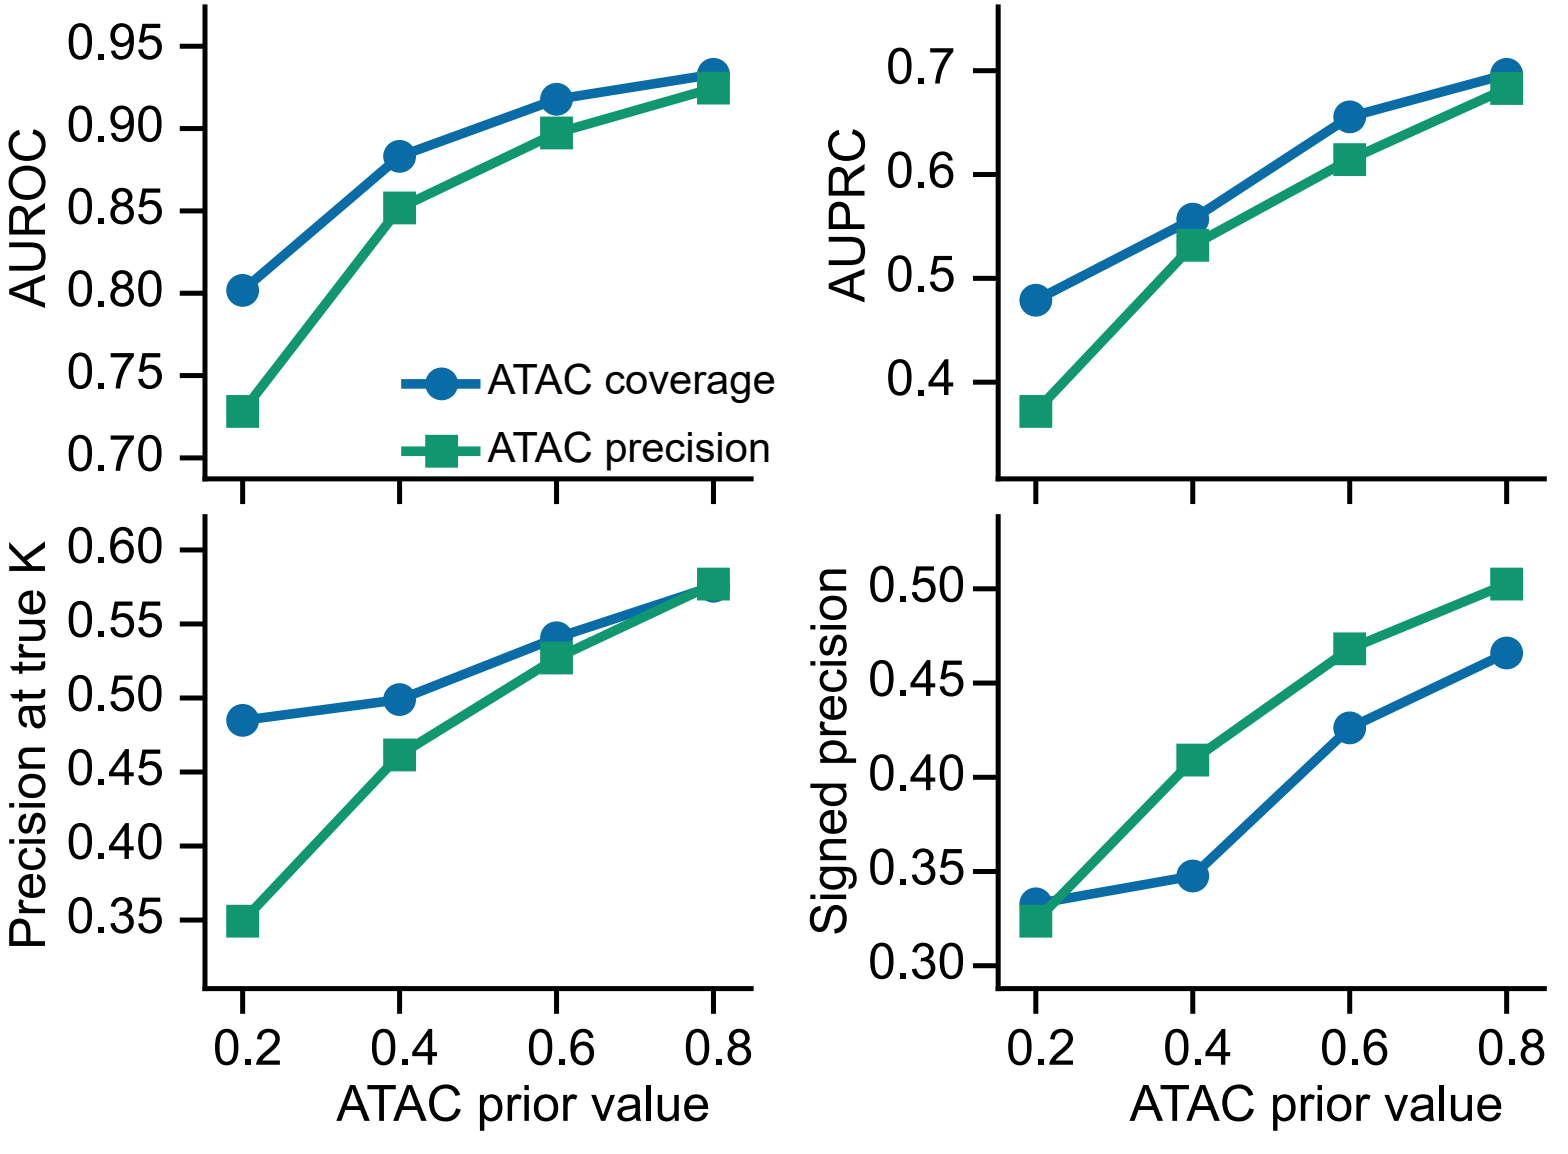

AUROC
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
ATAC coverage
ATAC precision
AUPRC
0.7
0.6
0.5
0.4
Precision at true K
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.2
0.4
0.6
0.8
ATAC prior value
Signed precision
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.2
0.4
0.6
0.8
ATAC prior value