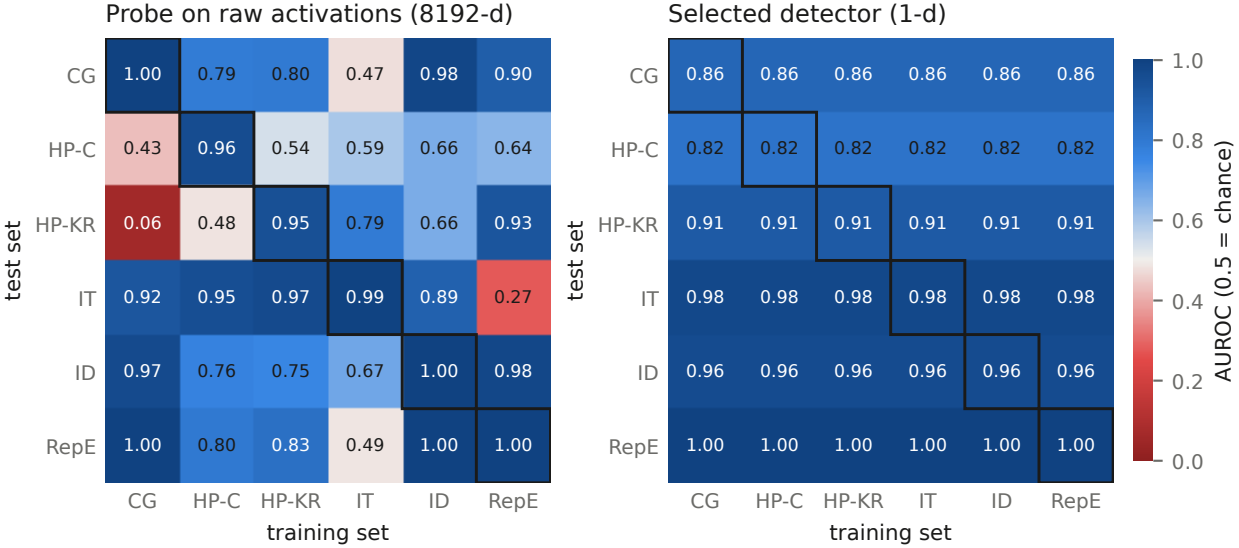
Probe on raw activations (8192-d)
Selected detector (1-d)
test set
training set
CG
HP-C
HP-KR
IT
ID
RepE
1.00 0.79 0.80 0.47 0.98 0.90
0.43 0.96 0.54 0.59 0.66 0.64
0.06 0.48 0.95 0.79 0.66 0.93
0.92 0.95 0.97 0.99 0.89 0.27
0.97 0.76 0.75 0.67 1.00 0.98
1.00 0.80 0.83 0.49 1.00 1.00
0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82
0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
AUROC (0.5 = chance)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0