




Passing Probes

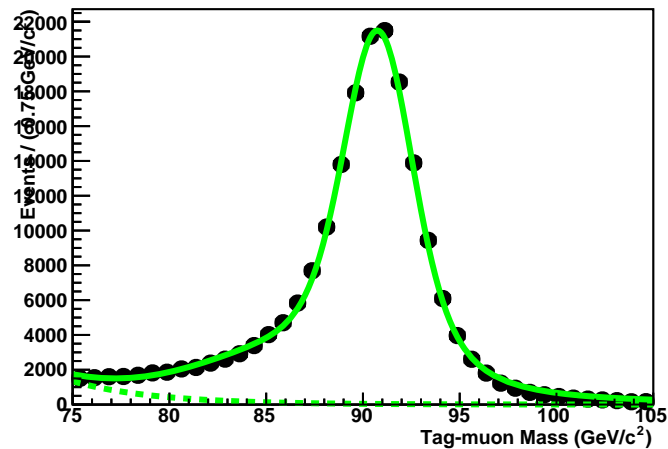

Failing Probes

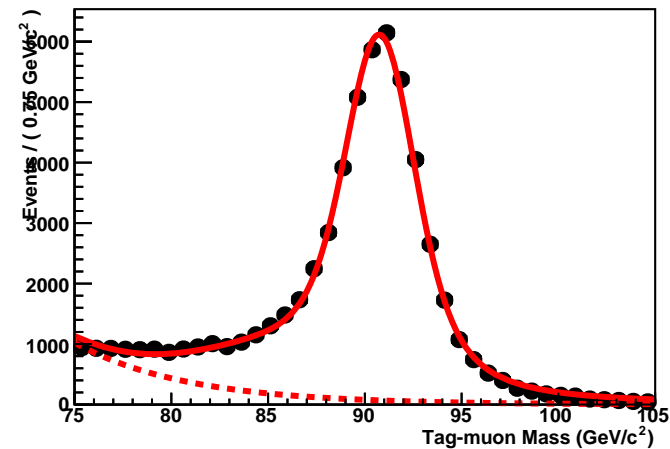

All Probes

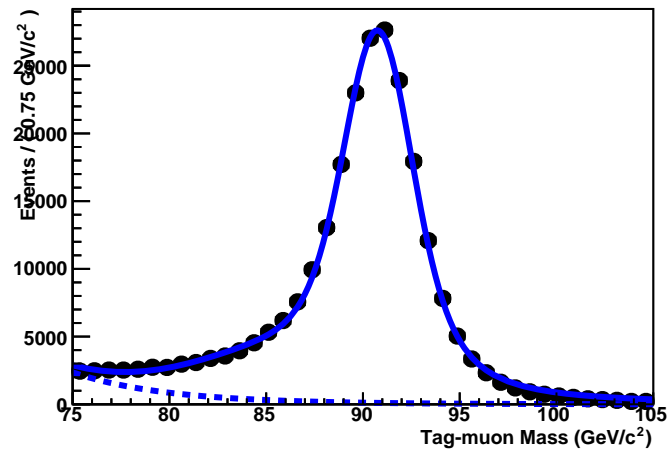

effBkg = 0.49 ± 0.01
 efficiency = 0.7801 ± 0.0010
 fSigAll = 0.939 ± 0.002
 lf = -0.1715 ± 0.005
 lp = -0.232 ± 0.01
 mean1 = 90.787 ± 0.008
 mean2 = 85.2 ± 0.1
 numTot = 256501 ± 506
 sigma1 = 1.29 ± 0.01
 sigma2 = 3.74 ± 0.08
 vFrac = 0.838 ± 0.004