
3D 打印机

操作手册（AI 智能实验室预约系统配套资料）

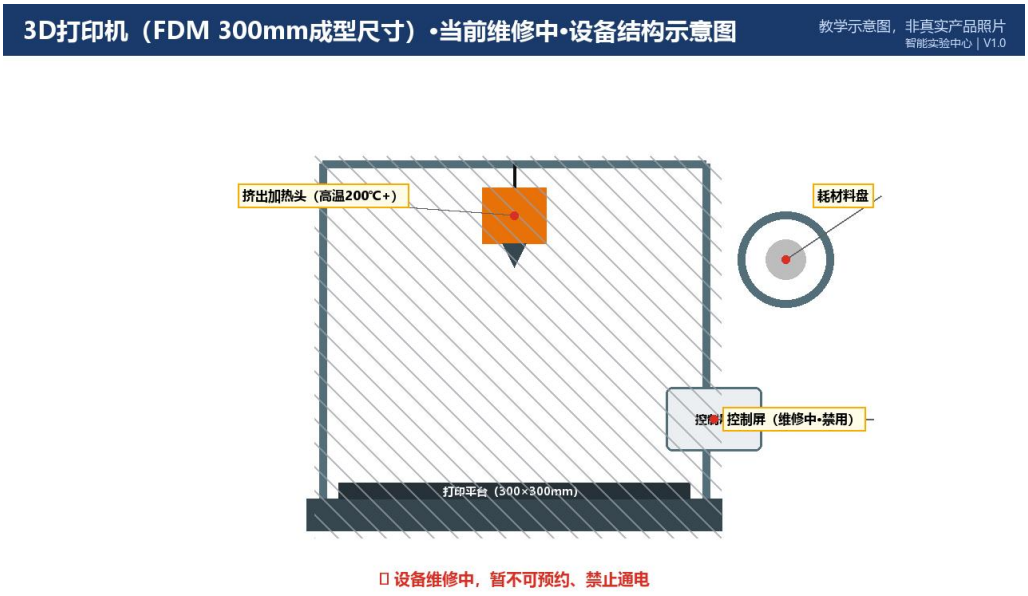

数据库规格：FDM / 300mm成型尺寸×2台 | 所属：综合开放实验室（实验室关闭期间）

所属实验室：综合开放实验室（创新中心 G 区一层）

数据库规格：FDM / 300mm 成型尺寸 | 数量：2 台/套

当前状态：维修中

版本 V1.0 | 2026-10-20

一、设备基本信息

设备名称	3D 打印机
所属实验室	综合开放实验室（数据库 ID 13）
所在位置	创新中心 G 区一层
数据库中的规格	FDM / 300mm 成型尺寸
数据库中的数量	2 台/套
当前状态	维修中
设备说明	用于原型零件打印，目前维护中
资料类型	操作手册（复杂/高风险设备）

二、主要用途与适用实验

本设备主要用于：用于原型零件打印，目前维护中。

适用实验：

- 原型零件打印、创客制作、结构件快速验证

三、使用前准备

1. 确认已在 AI 智能实验室预约系统预约成功，且预约时段位于实验室开放时间（08:00—22:00）内；
2. 携带校园卡完成到场签到；首次使用 3D 打印机须已完成对应的准入培训；
3. 注意：本设备当前为维修中状态，不可预约使用；
4. 注意：所属实验室当前整室关闭，即使设备状态正常也不可使用；

四、开机或启用步骤

（当前维修中）恢复后：登记打印任务→装耗材→平台调平→切片文件传输。

五、标准操作步骤

打印期间不离人；首层观察附着情况；异响或冒烟立即停机。

六、停机或退出步骤

打印完冷却取件→清理平台与废料→登记耗材用量。

七、使用后检查

1. 确认设备外观完好，附件无缺失；
2. 确认已按停机步骤正确关机/断电；
3. 使用登记表已填写（时间、状态、异常）；
4. 发现异常立即在 AI 智能实验室预约系统故障上报入口登记，勿带病使用。

八、禁止操作

- 维修期间私自通电打印造成二次损坏。

九、常见故障现象与简单排查

故障 1：首层不粘

排查方法：重新调平；清洁平台；调整首层温度。

故障 2：堵头

排查方法：按耗材要求温度打印；喷头冷却后清理。

十、无法解决时的上报流程

1. 在系统中提交故障工单：注明实验室、设备名称、故障现象、发生时间与已尝试的排查；
2. 同步电话通知值班台（虚构示例：0731-88880013，内部短号 0013）；
3. 紧急情况（冒烟/漏水/触电风险）先按安全应急流程处置再报修；
4. 管理员确认后把设备置为“维修中”，修复验收后恢复“正常”；维修期间系统内不可预约。

十一、日常维护要求

每打印 100 小时喷头检查；导轨每月润滑；耗材干燥保存。

十二、安全注意事项

喷头与热床高温（200℃+/60℃+）防烫伤；运动部件防夹手；打印释放气体须通风；耗材远离热源。

13、当前维修中、暂不可预约

本设备数据库状态为“维修中”，系统内不可预约；

维修完成经验收后由管理员恢复“正常”状态并通知；

维修期间严禁通电试机，防止二次损坏；

所属综合开放实验室同时整室关闭，双重限制期间任何人均不得使用。

14、设备结构示意图

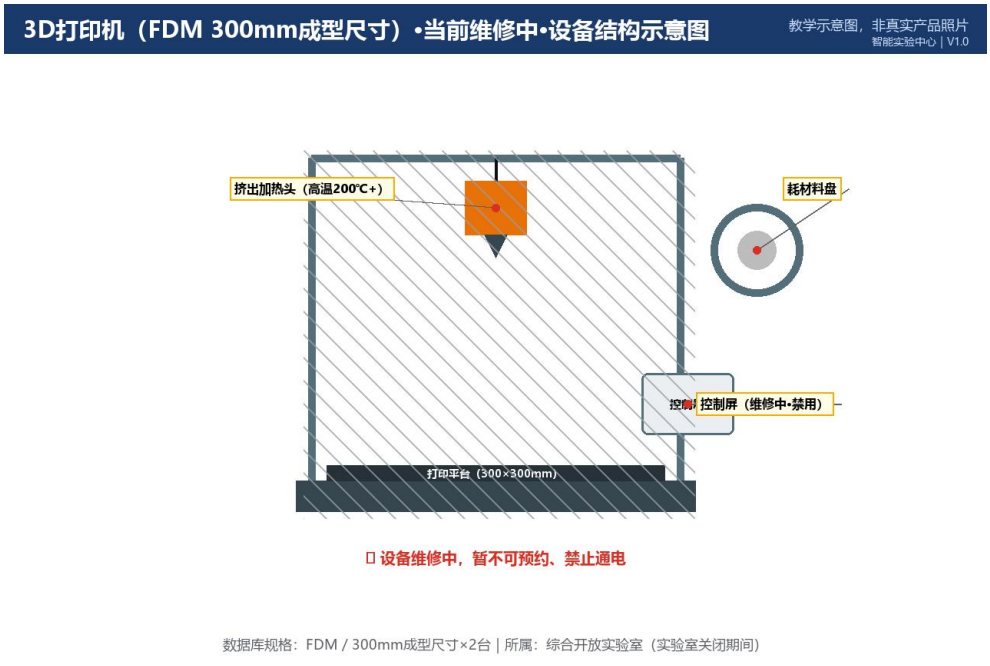


图 1 设备结构示意图（教学示意图，非真实产品照片）

15、关键接口或控制区域图



图 2 关键接口/控制区域图（教学示意图，实际位置以设备实物为准）

16、正确操作与错误操作对比



图 3 正确操作与错误操作对比（教学示意）

文档版本与修订记录

版本	日期	修订内容	编制/审核
V1.0	2026-10-20	首次发布；规格、数量、状态取自 2026-10-20 数据库快照；	智能实验中心