CD34 分选磁珠（抗人）产品说明书

产品简介：

纳米级 CD34 分选磁珠是通过在粒径为 50-100nm 的可降解磁珠表面偶联抗人 CD34 单克隆抗体从而实现 CD34+细胞分选，主要用于分选人外周血、脐带血、骨髓、单采血来源的 CD34+细胞，或者分化的 ES 和 iPS 细胞。CD34 单克隆抗体经过特殊的人源化改造，大幅降低了与 Fc 受体的亲和力，因此无需额外添加 Fc 受体阻断剂。纳米级 CD34 分选磁珠与外周血或有 CD34 表达的单细胞悬浮液孵育并进行磁性分离，使 CD34+细胞富集并分离，从而起到纯化 CD34+细胞的作用。

基质	可降解纳米磁珠
粒径范围	50-100nm
表面配基	人源化 CD34 单克隆抗体（抗人）
反应种属	人
性状	棕色胶体
处理细胞数	2 x 10^9 total cells/2mL
贮存温度	2-8℃，不可冷冻

使用方法：

1、试剂准备

分选缓冲液：磷酸盐缓冲液（PBS），pH 7.2，0.5% 牛血清白蛋白（BSA），2 mM EDTA。

注：▲可用人血清白蛋白（HSA）、人血清或胎牛血清（FBS）代替 BSA。

▲可用柠檬酸钠代替 EDTA。

2、样本准备

1) 当样本为人外周血时，建议使用密度梯度离心法获得外周血单个核细胞(PBMC)；对于其他组织，可使用单细胞悬液制备仪或手动制备单细胞悬液。
2) 较多的死细胞或红细胞可能会影响分选效果，可利用死细胞去除试剂和红细胞裂解液去除死细胞和红细胞。
3) 为了获得最佳性能，可用 30μm 细胞滤器过滤细胞悬液，去除细胞团块。

3、磁性分选

注：▲以下步骤给出的试剂推荐用量可处理 1×10^8 个总细胞，若细胞数量少于 1×10^8，则按 1×10^8 个细胞加入试剂；若细胞数量多于 1×10^8，应按比例相应增加试剂用量。

▲尽量快速操作，保持细胞冷却，并使用预冷溶液，以减少非特异性细胞标记。

▲磁珠与细胞孵育时需要温和地彻底混匀，以提高分选效率。

1) 将人的外周血单个核细胞（PBMC）重悬于分选缓冲液中，取样计数，取 1×10^8 个细胞至 1.5mL EP 管中 1500rpm，离心 5min。
2) 弃上清，将细胞沉淀重悬于 300μL 分选缓冲液中，随后加入 100μL CD34 分选磁珠，混合均匀后将其放入 2~8°C冰箱孵育 30min。
3) 将分选柱放入磁分离器上，用 3mL 分选缓冲液润洗 1 次。
4) 将孵育完成后的样品从 2~8°C冰箱取出，加入 5mL 分选缓冲液，1500rpm，5min 离心，弃上清。

5) 加入 1mL 分选缓冲液重悬样品，随后将样品加入分选柱中。
6) 用 15mL 离心管收集流出液，再用 3mL 分选缓冲液洗涤分选柱 3 次，收集流出液，这是未标记的细胞。
7) 待分选缓冲液全部流出后，将分选柱从磁分选器上取下，放入到另一新的 15mL 离心管中，向分选柱中加入 5mL 分选缓冲液，立即将配套活塞推入分选柱，磁性标记的细胞即被冲洗下来。
8) 取细胞计数并进行流式检测以评估细胞活率及纯度；为确保细胞活性，应立即将所需细胞部分悬浮在细胞培养基中。

注意事项:

本产品仅适用于体外细胞培养，不可直接用于临床治疗。

产品列表：


名称	货号	规格
CD34 分选磁珠（抗人）	CS1004-1	200μL
	CS1004-2	2mL

储存条件及有效期:

2°C-8°C，请勿冷冻；效期详见标签。

应用案例:

使用 CD34 分选磁珠、分选柱及配套分离器从人 PBMCs 中分离 CD34+细胞。用 CD45-APC 和 CD34-PE 对细胞进行荧光染色，并通过流式细胞术进行分析。

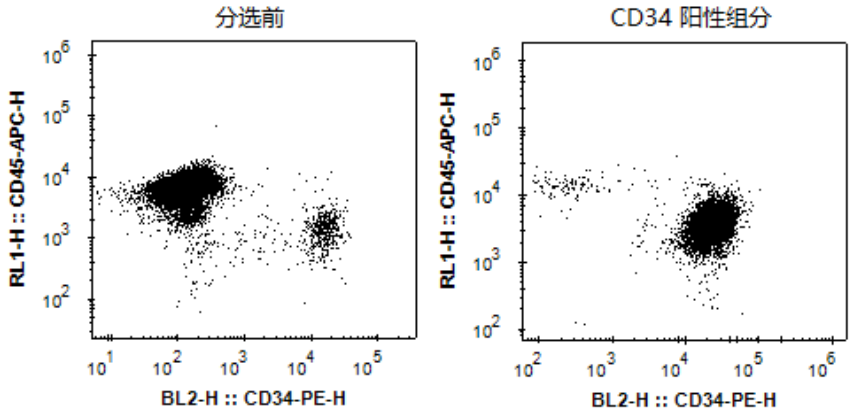

其他：

如需定制其他规格的产品请电话联系 0512-80905220 或发送邮件至 vdo@vdobiotech.com