NK 细胞阴选试剂盒（抗人）产品说明书

产品简介：

该 NK 细胞阴选试剂盒能高效地从人 PBMC 中分离 NK 细胞。非 NK 细胞，即 T 细胞、B 细胞、干细胞、树突状细胞、单核细胞、粒细胞和红细胞，则使用生物素抗体混合物和磁珠（该磁珠表面偶联单克隆抗体，可特异性与生物素抗体结合）进行磁性标记，通过将磁性标记的非 NK 细胞留在磁场中来实现高纯度 NK 细胞的分离。

产品成分	1 mL 人 NK 细胞生物素抗体混合物
	2 mL 人 NK 细胞磁珠
反应种属	人
处理细胞数	1 x 10^9 total cells
贮存温度	2-8℃，不可冷冻

使用方法：

1、试剂准备

分选缓冲液：磷酸盐缓冲液（PBS），pH 7.2，0.5% 牛血清白蛋白（BSA），2 mM EDTA。

注：▲可用人血清白蛋白（HSA）、人血清或胎牛血清（FBS）代替 BSA。

▲可用柠檬酸钠代替 EDTA。

2、样本准备

1) 当样本为人外周血时，建议使用密度梯度离心法获得外周血单个核细胞(PBMC)；对于其他组织，可使用单细胞悬液制备仪或手动制备单细胞悬液。
2) 较多的死细胞或红细胞可能会影响分选效果，可利用死细胞去除试剂和红细胞裂解液去除死细胞和红细胞。
3) 为了获得最佳性能，可用 30μm 细胞滤器过滤细胞悬液，去除细胞团块。

3、磁性分选

注：▲以下步骤给出的试剂推荐用量可处理 1×10^7 个总细胞，若细胞数量少于 1×10^7，则按 1×10^7 个细胞加入试剂；若细胞数量多于 1×10^7，应按比例相应增加试剂用量。

▲尽量快速操作，保持细胞冷却，并使用预冷溶液，以减少非特异性细胞标记。

▲试剂（生物素抗体混合物和磁珠）与细胞孵育时需要温和地彻底混匀，以提高分选效率。

1) 将人的外周血单个核细胞（PBMC）重悬于分选缓冲液中，取样计数，取 1×10^7 个细胞至 1.5mL EP 管中 1500rpm，离心 5min。
2) 弃上清，将细胞沉淀重悬于 40μL 分选缓冲液中，随后加入 10μL NK 细胞生物素抗体混合物，混合均匀后将其放入 2~8°C冰箱孵育 5min。
3) 将孵育完成后的样品从 2~8°C冰箱取出，加入 30μL 分选缓冲液，再加入 20μL NK 细胞磁珠，混合均匀后将其放入 2~8°C冰箱孵育 10min。
4) 将分选柱放入磁分离器上，用 3mL 分选缓冲液润洗 1 次。
5) 将孵育完成后的样品从 2~8°C冰箱取出，加入 1mL 分选缓冲液，随

后将样品加入分选柱中。

6) 用离心管收集流出液，再用 3mL 分选缓冲液洗涤分选柱 1 次，收集流出液，这些收集的流出液是未标记的细胞即 NK 细胞。
7) （选做）待分选缓冲液全部流出后，将分选柱从磁分选器上取下，放入到另一新的离心管中，向分选柱中加入 5mL 分选缓冲液，立即将配套活塞推入分选柱，磁性标记的非 NK 细胞即被冲洗下来。
8) 取细胞计数并进行流式检测以评估细胞活率及纯度；为确保细胞活性，应立即将所需细胞部分悬浮在细胞培养基中。

注意事项:

本产品仅适用于体外细胞培养，不可直接用于临床治疗。

产品列表：


名称	货号	规格
NK 细胞阴选试剂盒（抗人）	CS1009-1	100μL 生物素抗体混合物 200μL 磁珠
	CS1009-2	1mL 生物素抗体混合物 2mL 磁珠

储存条件及有效期:

2°C-8°C，请勿冷冻；效期详见标签。

应用案例:

使用 NK 细胞阴选试剂盒(抗人)、分选柱及配套分离器从人 PBMCs 中分离出未结合磁珠的人 NK 细胞。用 CD56-PE 和 CD3-FITC 对细胞进行荧光染色，并通过流式细胞术进行分析。

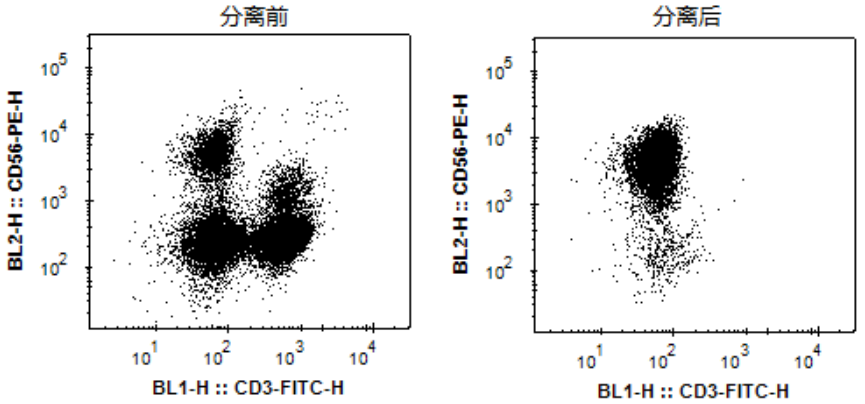

其他：

如需定制其他规格的产品请电话联系 0512-80905220 或发送邮件至 vdo@vdobiotech.com