# 小鼠单抗筛选套装（His-tag 抗原）

# 说明书

**【产品名称】**

小鼠单抗筛选套装（His-tag 抗原）

Mouse monoclonal antibody screening kit (His-tag antigen)

**【货号&规格】**

| 货号 | 规格 |
|---|---|
| SHC001 | 定制规格 |
| SHC001-1 | 1000 测试/盒 |
| SHC001-2 | 5000 测试/盒 |


**【预期用途】**

本产品采用均相发光法定性检测缓冲液、培养上清中小鼠抗体。

**【检测原理】**

均相发光法（Homogeneous ImmunoLuminescence Assay, HiLA）是基于供受体微球近距离传递能量发光的均相免疫分析方法。

本品由小鼠抗体筛选套装 A 试剂（抗 His-tag 抗体交联的受体微球）、B 试剂（生物素标记的抗小鼠 IgG 抗体）、D 试剂（链霉亲和素交联的供体微球）组成。A 试剂、His-tag 抗原与待测小鼠抗体、B 试剂以及 D 试剂，混合后经过一定时间孵育，形成发光免疫复合物。当两种微球的间距小于 200nm，经激发光照射后，供体微球产生单线态氧并扩散至受体微球，受体微球接受能量产生发射光。通过感光元件收集光信号，测定缓冲液或培养上清中小鼠抗体的反应性。

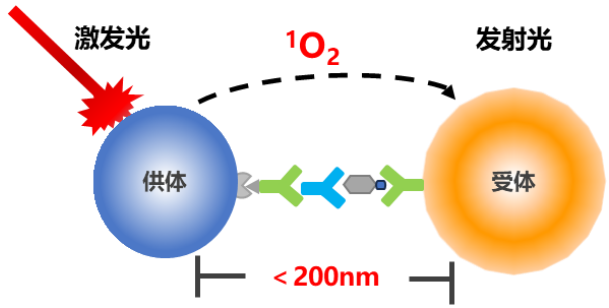


**【主要组成成份】**

| 名称 | 主要活性成份 | SHC001-1 | SHC001-2 |
|---|---|---|---|
| A 试剂 | 抗 His-tag 抗体交联的受体微球 | 10mL/瓶×1 | 50mL/瓶×1 |
| B 试剂 | 生物素标记的抗小鼠 IgG 抗体 | 5mL/瓶×1 | 25mL/瓶×1 |
| D 试剂 | 链霉亲和素交联的供体微球 | 5mL/瓶×1 | 25mL/瓶×1 |

**必需但本产品未提供的材料及仪器：**

1. 待测抗体所需的 His-tag 抗原；
2. 发光板/条；
3. HiLA 均相发光仪，或含 Alpha 模块的多功能酶标仪。

**【储存条件及效期】**

2～8°C 避光储存。

按照规定储存条件保存，本产品效期 12 个月。

**【检测流程】**

在 A 试剂中添加 His-tag 抗原，浓度 2μg/mL

↓

上述 A 试剂及 B 试剂、D 试剂按照体积比 2:1:1 混合均匀

↓

每个测试加 20μL 待测样品+ 20μL 混合试剂

↓

绿光/避光 37°C震荡孵育 60 分钟

↓

HiLA 均相发光仪 读数

↓

数据分析

**【注意事项】**

1. 本产品对光敏感，使用过程中注意避光，建议在绿光下配制、加样及孵育（光照度< 100LUX）；
2. 37°C孵育推荐在 HiLA 均相发光仪中进行；
3. 不同批次间应严格控制孵育时间及孵育温度；
4. 加样过程中应避免产生气泡。

**【性能验证】**

为保障产品质量，每批产品出厂前均按照性能验证方案（详见第 2 页）进行验证。

**【联系我们】**

企业名称：苏州为度生物技术有限公司

地址：苏州市工业园区星湖街 218 号生物医药产业园 C18

网址：https://www.vdobiotech.com.cn

电话：0512-80905220

# 小鼠单抗筛选套装（His-tag 抗原）

## 性能验证

**【所需材料及仪器】**

| 名称 | 来源 | 货号 |
|---|---|---|
| M1 抗原（His-tag 抗原） | 为度 | / |
| M1 抗体 | 为度 | / |
| 通用缓冲液 4 | 为度 | SHB07 |
| 发光八联孔 | 为度 | SHP0801 |
| 微孔板板架 | 为度 | SHPS01 |
| 绿光灯 | 为度 | SHL01 |
| HiLA100 均相发光仪 | 为度 | SHI100 |


**【样本及试剂配制】**

- 使用通用缓冲液 4 将 M1 抗体预先稀释至 250ng/mL（1.67nM）作为 C12，然后按以下方案做梯度稀释：

| 编号 | 浓度（ng/mL） | 通用缓冲液 4 体积（μL） | 高浓度添加体积（μL） |
|---|---|---|---|
| C12 | 2.50E+02 | / | / |
| C11 | 7.50E+01 | 210 | 90μL C12 |
| C10 | 2.50E+01 | 180 | 90μL C11 |
| C9 | 7.50E+00 | 210 | 90μL C10 |
| C8 | 2.50E+00 | 180 | 90μL C9 |
| C7 | 7.50E-01 | 210 | 90μL C8 |
| C6 | 2.50E-01 | 180 | 90μL C7 |
| C5 | 7.50E-02 | 210 | 90μL C6 |
| C4 | 2.50E-02 | 180 | 90μL C5 |
| C3 | 7.50E-03 | 210 | 90μL C4 |
| C2 | 2.50E-03 | 180 | 90μL C3 |
| C1 | 0 | 180 | / |

**【性能验证】**

- 反应曲线：

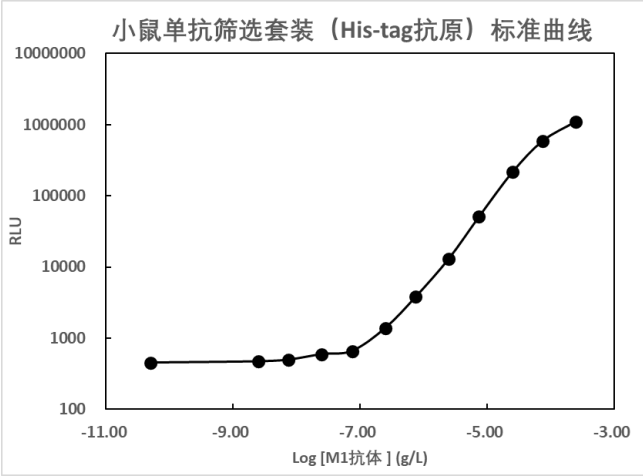


最高信号：1114027

最低信号：451

$EC_{50}$= 60.05 ng/mL（0.40nM）

- 空白限：

重复检测 20 次 C1，计算信号均值及 SD，用反应曲线计算信号均值+2×SD 对应的浓度值，即为空白限。

空白限= 0.023ng/mL（0.15pM）

- 重复性 CV%：

高、低浓度样品重复测试 10 次，计算浓度 CV%。

| | 低浓度 | 高浓度 |
|---|---|---|
| 重复性 CV% | 4.64% | 2.19% |

- 特异性：采用通用缓冲液 4 稀释下列各蛋白至 1μg/mL，测试交叉干扰率。

| 检测物质 | 交叉反应率 |
|---|---|
| 人 IgG | 0.00% |
| 兔 IgG | 0.00% |