人白介素-17A（hIL-17A）检测试剂盒说明书

【产品名称】

人白介素-17A（hIL-17A）检测试剂盒（均相发光法）

Human Interleukin-17A (hIL-17A) kit

(Homogeneous ImmunoLuminescence Assay, HiLA)

【货号及规格】

不同的组份用量对应的产品规格见下表：

货号	规格	各组份用量	推荐微孔板
SH2213	100t/盒	见检测流程	96 孔发光板
	200t/盒	同比缩至 1/2	384 孔发光板
	500t/盒	同比缩至 1/5	384 浅孔发光板
SH2213D	定制规格	/	/

【预期用途】

本产品采用均相发光法定量检测缓冲液、细胞培养上清或血清中人 IL-17A 的浓度。

白细胞介素-17A (interleukin-17A，IL-17A)，也称为 CTLA8，是 IL-17 受体家族的成员，由该基因编码的蛋白质是由活化的 T 细胞产生的促炎细胞因子。


IL-17A 介导的下游途径诱导炎症分子、趋化因子、抗微生物肽和重塑蛋白的产生。编码的蛋白质对宿主防御、细胞运输、免疫调节和组织修复产生重要影响，在诱导先天免疫防御中起关键作用。这种细胞因子刺激非造血细胞并促进趋化因子的产生，从而将髓样细胞募集到炎症部位。该细胞因子还调节 NF-κB 和丝裂原活化蛋白激酶的活性，可以刺激 IL6 和环氧合酶 2（PTGS2 /COX-2）的表达，并增强一氧化氮（NO）的产生。

IL-17A 在各种传染病、炎症和自身免疫性疾病以及癌症中起着关键作用。高水平的这种细胞因子与几种慢性炎症性疾病相关，包括类风湿性关节炎，牛皮癣和多发性硬化症。Th17 细胞和 IL-17 也与克罗恩病（CD）和溃疡性结肠炎（UC）有关，这是两种主要形式的炎症性肠病（IBD）。在宿主防御中，IL-17A 已被证明对抵抗细胞外细菌和真菌引起的感染发挥着重要的作用。

【检测原理】

本试剂盒采用双抗体夹心的均相发光法进行 hIL-17A 浓度的检测。均相化学发光是基于供受体微球近距离传递能量发光的均相免疫分析方法。

它采用受体微球交联 hIL-17A 抗体 1，供体微球交联链霉亲和素，生物素标记 hIL-17A 抗体 2。标记抗体、受体微球与待测物混合孵育，形成双抗体夹心免疫复合物，再与供体微球交联形成发光复合物。当两种微球的间距小于 200nm， 经激发光照射后，供体微球产生单线态氧并扩散至受体微球，受体微球接受能量产生发射光。通过感光元件收集光信号，采用数学拟合计算待测物中 hIL-17A 的浓度。当待测物中不含 hIL-17A 时，无免疫复合物的形成，两种微球的间距大于 200nm，超出单线态氧的传递距离，则受体微球不产生发射光。

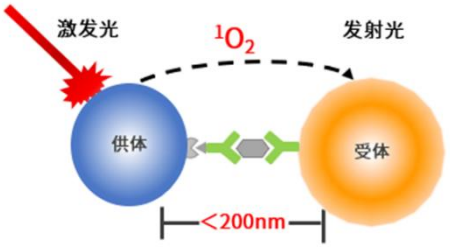

【主要组成成份】

名称	主要活性成份	规格
hIL-17A 检测试剂 R1	hIL-17A 抗体交联的受体微球	2mL/瓶×1
hIL-17A 检测试剂 R2	生物素标记的 hIL-17A 抗体	2mL/瓶×1
hIL-17A 检测试剂 R3	链霉亲和素交联的供体微球	5mL/瓶×1
hIL-17A 校准品	hIL-17A 蛋白，BSA	0.15μg 冻干品
hIL-17A 校准品缓冲液	BSA	6mL/瓶×1

必需但本产品未提供的材料及仪器：

- 发光板/条
- HiLA 均相发光仪，或含 Alpha 模块的多功能酶标仪

【储存条件及有效期】

- 2~8°C 避光储存 12 个月；
- 校准品复溶后可分装保存于-20°C，避免反复冻融。

【样品要求】

- 检测细胞培养上清时，细胞培养液中至少应添加 1%的 FBS 或 0.1%的 BSA。
- 细胞上清液需 1000 ×g 离心 10 分钟，去除颗粒和聚合物。
- 检测血清样本时，建议采用阴性的血清基质稀释校准品，要求用于稀释校准品的血清中人 IL-17A 的测值应低于空白限，用该校准曲线对血清样本进行检测和浓度计算。
- 若待测样本浓度超出检测上限，建议稀释后检测。

【检测流程】

- **检测流程 1(37°C):**

10μL 校准品/样品+ 20μL R1+20μL R2
↓
37°C 孵育 15 分钟
↓
绿光/避光 加入 50μL R3
↓
绿光/避光 37°C孵育 10 分钟
↓
仪器读数

- **检测流程 2(室温):**


10μL 校准品/样品+ 20μL R1+20μL R2
↓
室温孵育 60 分钟
↓
绿光/避光 加入 50μL R3
↓
绿光/避光 室温孵育 30 分钟
↓
仪器读数


【校准品梯度样品配制】

采用 50μL 去离子水复溶冻干校准品，然后用校准品缓冲液对 hIL-17A 校准品进行稀释，推荐稀释方案如下表：

梯度	浓度（pg/mL）	hIL-17A (μL)	稀释液(μL)
C12	300000	20μL 校准品	180
C11	100000	60μL C12	120
C10	30000	60μL C11	140
C9	10000	60μL C10	120
C8	3000	60μL C9	140
C7	1000	60μL C8	120
C6	300	60μL C7	140
C5	100	60μL C6	120
C4	30	60μL C5	140
C3	10	60μL C4	120
C2	3	60μL C3	140
C1	0	—	120

完整标准曲线示例：

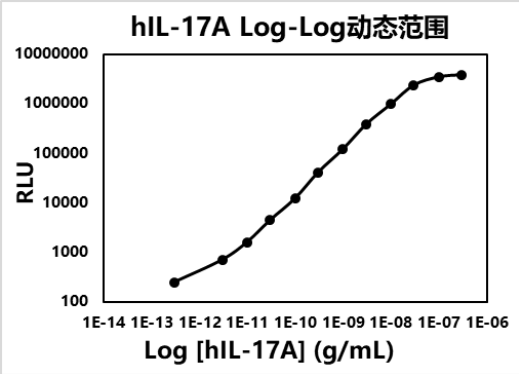

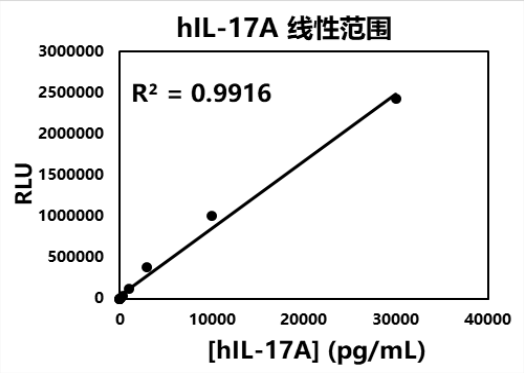

【注意事项】

- 检测试剂 R3 对光敏感，使用过程中注意避光，建议在绿光下加样及孵育（光照度< 100LUX）。
- 推荐每次检测重新定标，标准品各浓度点做 2~3 孔测试。
- 推荐使用四参数（权重 $1/Y^2$）进行拟合计算。
- 注意孵育温度和孵育时间的要求。
- 孵育建议在微孔板上覆膜，推荐在 HiLA 仪器中进行。
- 建议校准品的稀释基质应和待测样品保持一致。
- 校准品复溶后应在 2 小时内使用完毕。
- 不同批号试剂盒之间组分不宜混用。

【性能参数】

- 空白限：重复检测 20 次校准品 C1，计算信号均值及 SD，用标准曲线计算 信号均值+2×SD 对应的浓度值，即为空白限。

检测流程	基质	空白限(pg/mL)
检测流程 1	缓冲液	0.34
	DMEM	0.45
	RPMI	3.86
	人血清	0.28
检测流程 2	缓冲液	2.45

- 动态范围：0~300000 pg/mL。
- 线性范围：0.34~30000 pg/mL。
- 精密度：

重复性：高低浓度样品重复测试 10 次，计算浓度 CV。

检测流程	基质	重复性	
		低浓度	高浓度
检测流程 1	缓冲液	3.4%	3.7%
	DMEM	2.9%	4.3%
	RPMI	4.1%	3.6%
	人血清	3.5%	4.1%
检测流程 2	缓冲液	5.4%	6.1%

中间精密度：高低值样品测试 5 轮，每轮 5 次，计算浓度 CV。

检测流程	基质	中间精密度	
		低浓度	高浓度
检测流程 1	缓冲液	3.1%	3.8%

- 准确度：高低浓度 hIL-17A 按 1:9 混合后测试其回收率。

检测流程	基质	回收率
检测流程 1	缓冲液	97.4%
	DMEM	102.4%
	RPMI	93.5%
	人血清	88.0%
检测流程 2	缓冲液	86.5%

- 特异性：采用校准品缓冲液稀释下列各蛋白至 0.3μg/mL，测试交叉干扰率。

检测流程	检测物质	交叉反应率
检测流程 1	Mouse IL-17A	0.00%
	human IL-17F	0.00%

- 溯源：测试标准物质 NIBSC 01/420，1IU/mL≈83pg/mL。

【参考文献】

[1] 崔天盆. 细胞因子及免疫学检验.第 1 版. 北京：人民卫生出版社，2018.

【联系我们】

企业名称：苏州为度生物技术有限公司
地址：苏州市工业园区星湖街 218 号生物医药产业园 C18 栋
网址：www.vdobiotech.com.cn
电话：0512-80905220