小鼠配对抗体筛选试剂盒

说明书

【产品名称】

小鼠配对抗体筛选试剂盒

Mouse Antibody Pair Screening Kit

【货号&规格】

货号	规格
SHC005	定制规格
SHC005-1	1000T/盒

【预期用途】


本产品基于均相发光法（HiLA），用于鉴定两个小鼠单抗是否可作为“夹心法”检测的配对抗体。

本产品兼容多种样本类型，包括纯化后的抗体或未经纯化的复杂样本，如细胞培养上清。

【检测原理】

均相发光法（Homogeneous ImmunoLuminescence Assay, HiLA）是基于供受体微球近距离传递能量发光的均相检测方法。

本品由 A 试剂（抗小鼠 IgG 交联的受体微球）、B 试剂（生物素标记的抗小鼠 IgG）、D 试剂（链霉亲和素交联的供体微球）和抗原稀释液组成。A 试剂、B 试剂分别与待测抗体预反应，检测前 D 试剂与抗原提前混合。然后将 A 试剂预反应液、B 试剂预反应液、D 试剂-抗原混合液加入微孔板中孵育一定时间。若两个单抗可以同时结合在同一抗原上，即能形成“夹心”复合物，进而供体微球、受体微球之间距离会被拉近在 200nm 内。经激发光照射后，供体微球产生单线态氧并扩散至受体微球，受体微球接受能量产生发射光。通过感光元件收集光信号后分析数据，即可得知两个抗体与抗原是否形成夹心配对。

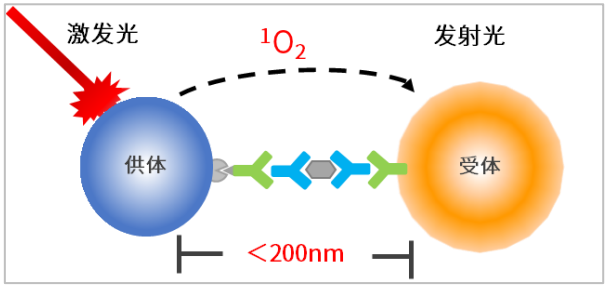

【主要组成成份】

名称	主要活性成份	SHC005-1
A 试剂	抗小鼠 IgG 交联的受体微球	15mL/瓶×1
B 试剂	生物素标记的抗小鼠 IgG	15mL/瓶×1
D 试剂	链霉亲和素交联的供体微球	15mL/瓶×1
稀释液	抗原稀释液	15mL/瓶×1

必需但本产品未提供的材料及仪器：


1. 发光板/条；
2. HiLA 均相发光仪，或含 Alpha 模块的多功能酶标仪。

【储存条件及效期】

2～8°C 避光储存。

按照规定储存条件保存，本产品效期 12 个月。

【工作流程】

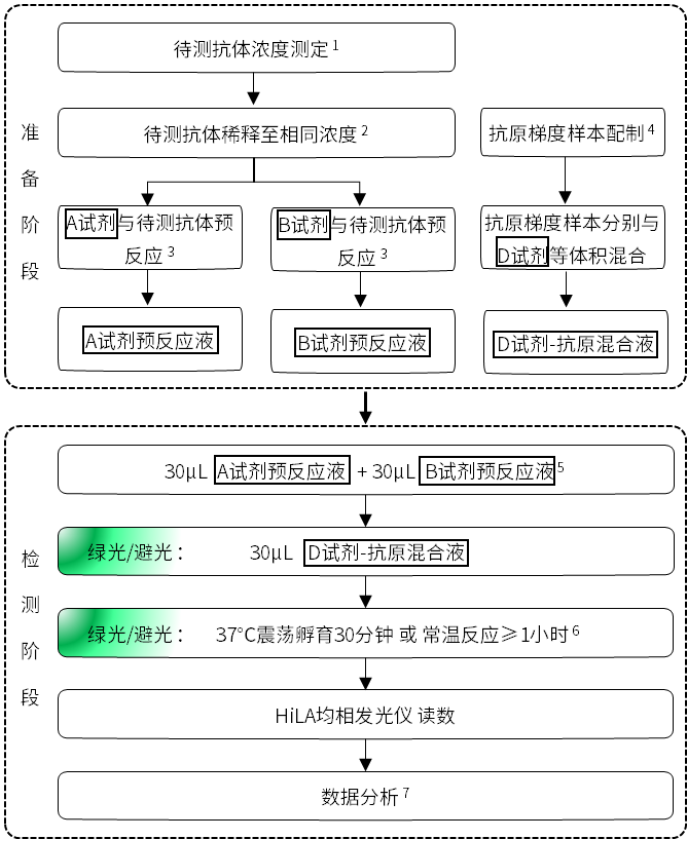

说明：

1. 推荐使用*小鼠总 IgG 检测试剂盒（货号：SH2505）*对复杂样本中小鼠 IgG 进行定量检测，然后稀释至相同浓度进行分析，可有效排除因 IgG 浓度差异带来的不确定影响；
2. 推荐使用与样本相同基质稀释待测抗体，稀释浓度介于 0.1-1 μg/mL 之间；
3. 预反应条件：A 试剂、B 试剂分别与待测抗体等体积混合后孵育，37°C30min 或常温 1 小时以上（不超过 24 小时）；

4. 抗原梯度样本使用稀释液配制，推荐配制 0、0.01、0.1、1μg/mL 四个浓度水平；
5. 实验通量较大时，建议一次完成 A 试剂预反应液 、B 试剂预反应液加样工作，然后再逐板加入 D 试剂-抗原混合液；
6. 常温反应≥1 小时，当实验通量较大时可选择过夜反应，不建议超过 24 小时；
7. 所有配对抗体分别计算其抗原 0.01、0.1、1μg/mL 浓度与 0 值浓度的信号比值。通常当信号比值≥1.2 时，可以认为此配对抗体与抗原为阳性配对。用户可根据具体的实验情况设定合理的阳性阈值。

【注意事项】

1. D 试剂对光敏感，使用过程中注意避光，建议在绿光下配制、加样及孵育（光照度< 100LUX）；
2. 检测阶段 37°C孵育推荐在 HiLA 均相发光仪中进行；
3. 为使不同板之间数据可比，应严格控制反应温度及时间；
4. 加样过程中应避免产生气泡。

【性能验证】

为保障质量，每批产品出厂前均按照性能验证方案进行验证。

【联系我们】

企业名称：苏州为度生物技术有限公司

地址：苏州市工业园区星湖街 218 号生物医药产业园 C18

网址：https://www.vdobiotech.com.cn

电话：0512-80905220

小鼠配对抗体筛选试剂盒

性能验证

【所需材料及仪器】

名称	来源	货号
抗原 M	为度	/
抗体 M1	为度	/
抗体 M2	为度	/
通用缓冲液 4	为度	SHB07
发光八联孔	为度	SHP0801
微孔板板架	为度	SHPS01
绿光灯	为度	SHL01
HiLA100 均相发光仪	为度	SHI100

【样本及试剂配制】

- 使用通用缓冲液 4，将抗体 M1、抗体 M2 稀释至 0.2μg/mL，然后分别与 A 试剂、B 试剂等体积混合后 37°C预反应 30min；
- 使用抗原稀释液将抗原 M 配置成 0μg/mL、1μg/mL 两个浓度水平，然后分别与 D 试剂等体积混合后备用（注意避光）；
- 下表四种配对抗体组合，按照说明书检测流程加样后在 HiLA 均相发光仪上孵育 30min 后读数。

配对抗体组合	A 试剂预反应液	B 试剂预反应液
组合 1	A 试剂+抗体 M1	B 试剂+抗体 M1
组合 2	A 试剂+抗体 M2	B 试剂+抗体 M2
组合 3	A 试剂+抗体 M1	B 试剂+抗体 M2
组合 4	A 试剂+抗体 M2	B 试剂+抗体 M1

【性能验证】

检测结果需满足以下标准：

配对抗体组合	1μg/mL 与 0μg/mL 信号比值要求
组合 1	≤1.1
组合 2	≤1.1
组合 3	≥3.0
组合 4	≥3.0