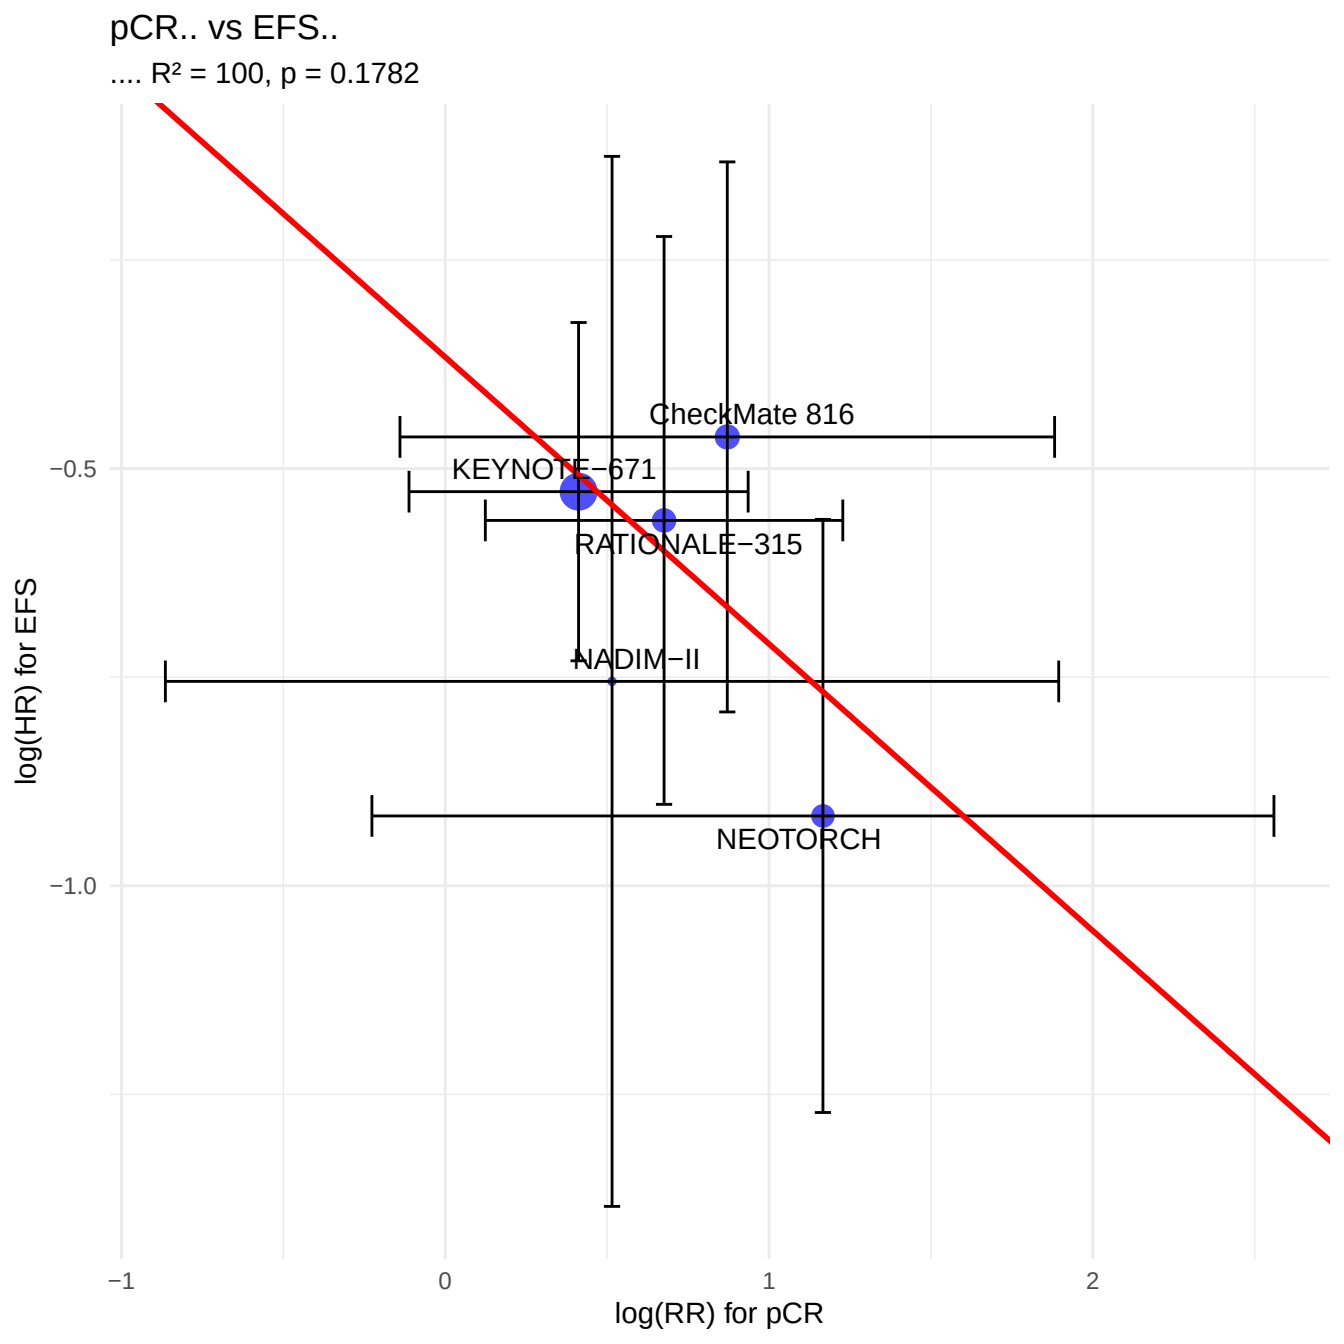
pCR.. vs EFS..
.... R² = 100, p = 0.1782
CheckMate 816
KEYNOTE−671
RATIONALE−315
NADIM−II
NEOTORCH
−0.5
−1.0
log(HR) for EFS
−1
0
1
2
log(RR) for pCR

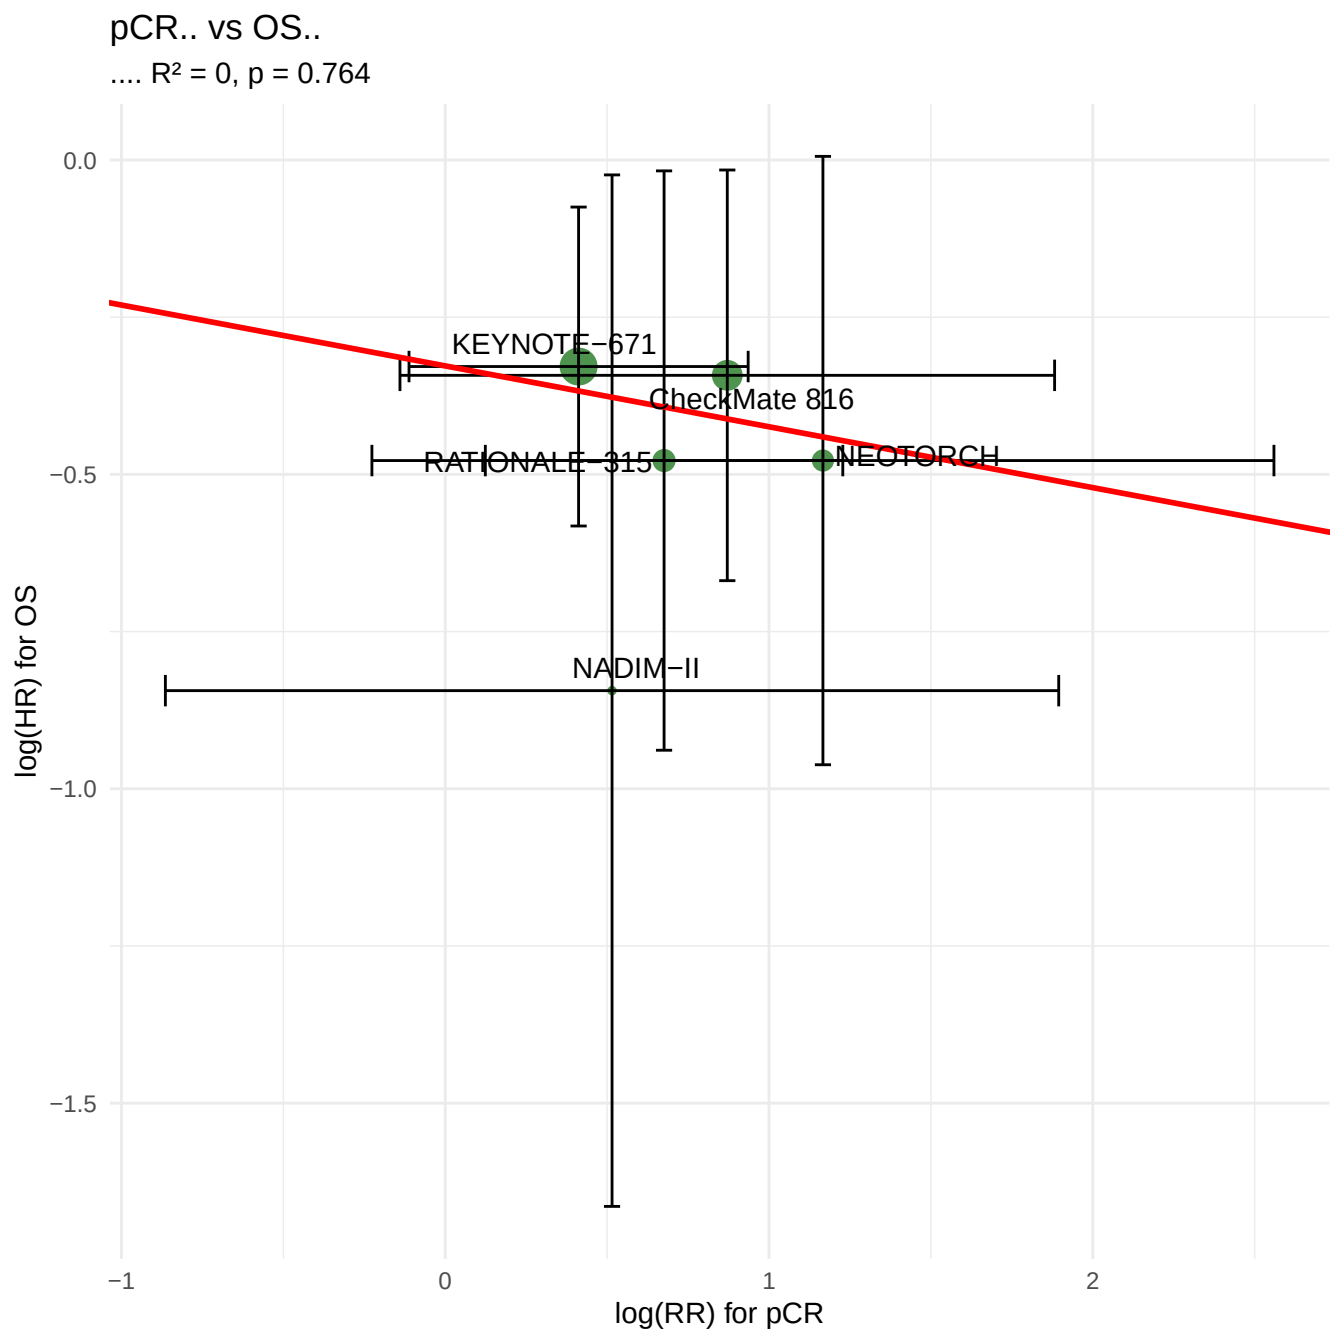
pCR.. vs OS..
.... R² = 0, p = 0.764
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
log(HR) for OS
KEYNOTE−671
CheckMate 816
RATIONALE−315
NEOTORCH
NADIM−II
−1
0
1
2
log(RR) for pCR

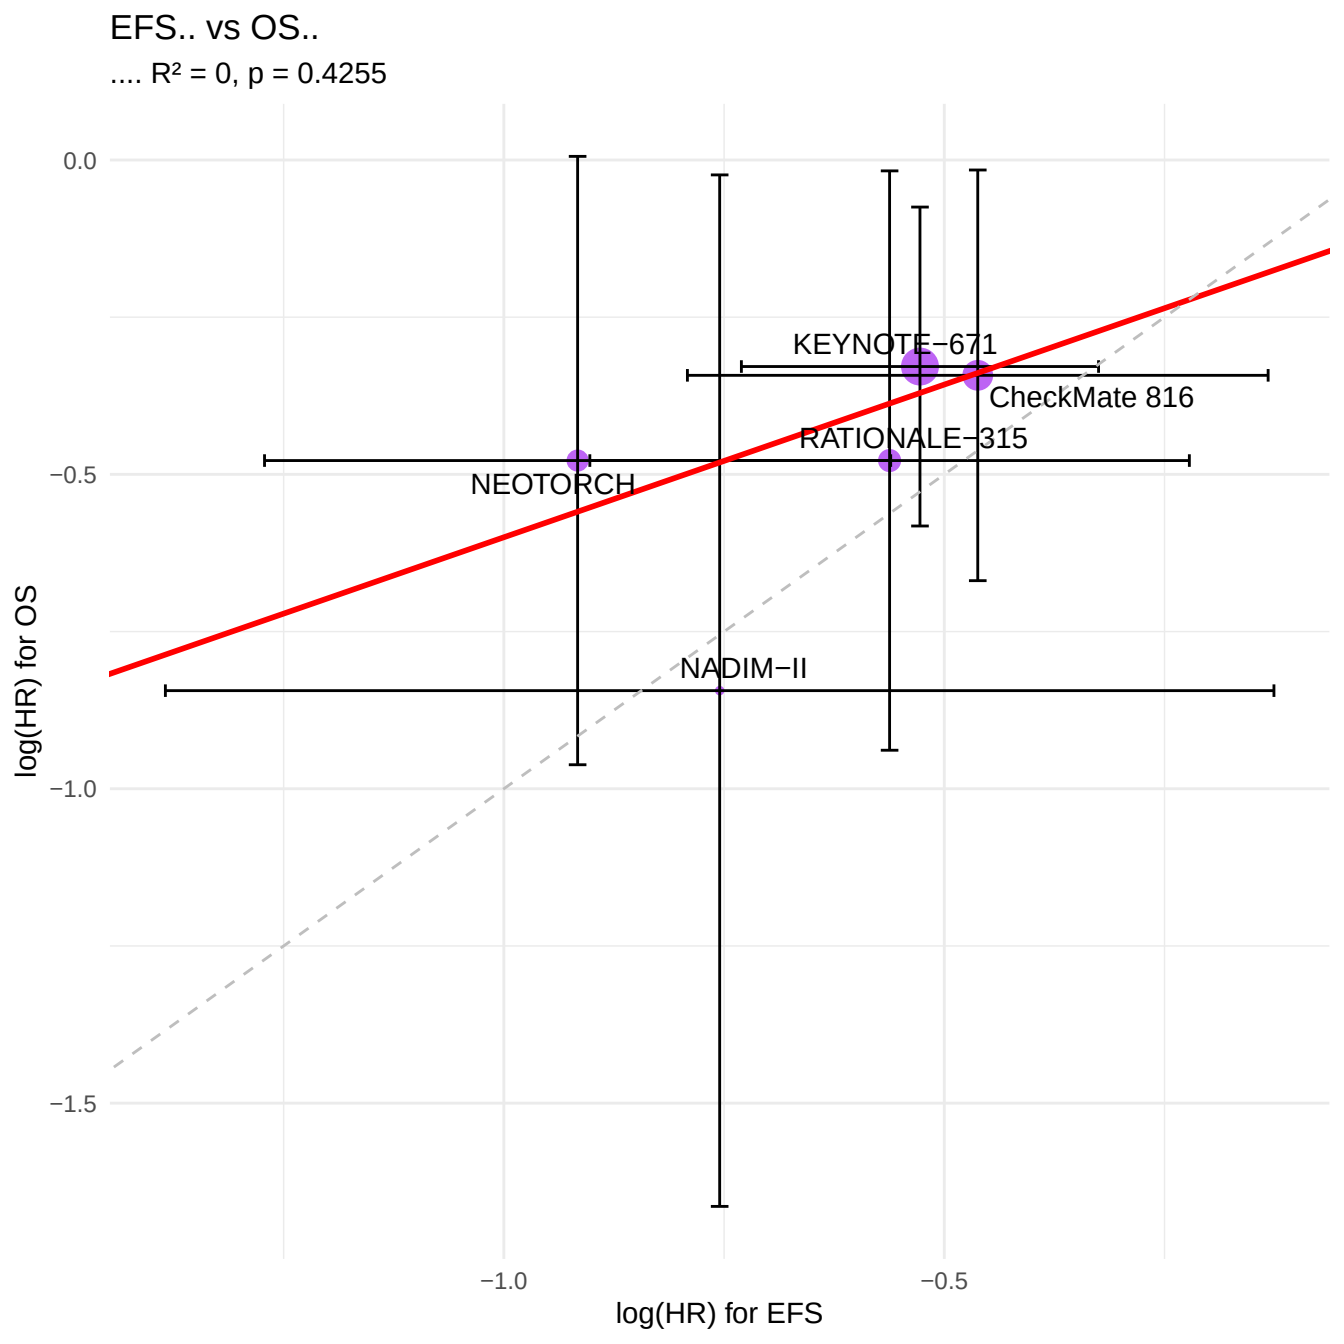
EFS.. vs OS..
.... R² = 0, p = 0.4255
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
log(HR) for OS
−1.0
−0.5
log(HR) for EFS
KEYNOTE−671
CheckMate 816
RATIONALE−315
NEOTORCH
NADIM−II